



PAXgene®

Blood DNA Tube

Code	Language	Page	Code	Language	Page
EN	English	1 – 6	KO	한국어	111 – 116
BG	Български	7 – 13	LT	Lietuvių k.	117 – 123
CS	čeština	14 – 20	LV	Latviski	124 – 130
DA	Dansk	21 – 27	NL	Nederlands	131 – 137
DE	Deutsch	28 – 34	NO	Norsk	138 – 144
EL	Ελληνικά	35 – 41	PL	Polski	145 – 151
ES	Español	42 – 48	PT	Português	152 – 158
ET	Eesti	49 – 55	RO	Română	159 – 165
FI	Suomi	56 – 62	RU	Русский	166 – 172
FR	Français	63 – 69	SK	Slovenský (jazyk)	173 – 179
HR	Hrvatski	70 – 76	SL	Slovenski (jezik)	180 – 186
HU	Magyar	77 – 83	SV	Svenska	187 – 193
IS	Íslenska	84 – 90	TR	Türkçe	194 – 200
IT	Italiano	91 – 97	UK	Українська	201 – 207
JA	日本語	98 – 103	ZH	中文	208 – 213
KK	Қазақша	104 – 110		Symbol and Mark Key	214

Blood DNA Tube

EN – English

I. Intended Use

The PAXgene Blood DNA Tube is intended to collect, anticoagulate, stabilize, transport and store a venous whole blood sample for preparation of high quality DNA for use with molecular diagnostic test methods that require DNA.

The performance characteristics of this device have not been established for molecular diagnostic assays in general. Users must validate use of product for their specific molecular diagnostic assay.

Product Features

PAXgene Blood DNA Tube • 2.5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA additive
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 tubes/shelf carton • 1,000 tubes/case

II. Summary and Explanation

The PAXgene Blood DNA Tube provides a means for the collection of whole blood for the isolation of genomic DNA in a closed, evacuated system. Blood is collected under a standard phlebotomy protocol into an evacuated tube that contains K₂EDTA additive. Complete isolation of DNA is carried out using manual or automated methods such as salting out precipitation, magnetic beads, or silica membrane-based technologies.

III. Warnings

Contents of this tube are irritating to skin.


- After inhalation, move the exposed person to fresh air.
- After skin contact, immediately flush skin with plenty of soap and water for at least 15 minutes.
- After eye contact, immediately flush with plenty of water for at least 15 minutes.
- After swallowing, immediately give large amounts of water. Get medical attention.

IV. Specimen Collection and Preparation for Analysis

A. Required Blood Collection Accessories (Not included with the PAXgene Blood DNA Tube)

1. Blood collection needle such as the BD Vacutainer® Eclipse™ Blood Collection Needle or the BD Vacutainer Eclipse Signal™ Blood Collection Needle. See Ordering Information.
2. A BD Vacutainer Needle Holder must be used to ensure proper function. See Ordering Information.
3. Labels for positive donor identification of samples, if required
4. Alcohol swab for cleansing site
5. Dry sterile gauze
6. Tourniquet
7. Needle disposal container for used needle or needle/holder combination

B. Procedure for Specimen Collection



General Instructions

WEAR GLOVES DURING VENIPUNCTURE AND WHEN HANDLING BLOOD COLLECTION TUBES TO MINIMIZE EXPOSURE HAZARD.

1. Assemble needle in holder. Be sure needle is firmly seated to ensure needle does not unthread during use.
2. Place tube into holder. Note: Do not puncture stopper.
3. Select site for venipuncture.
4. **Apply tourniquet. Prepare venipuncture site with an appropriate antiseptic. DO NOT PALPATE VENIPUNCTURE AREA AFTER CLEANSING.**
5. Place patient's arm in a downward position.
6. Remove needle shield. Perform venipuncture WITH ARM DOWNWARD AND TUBE STOPPER UPPER-MOST.
7. Center tubes in holder when penetrating the stopper to prevent sidewall penetration and resultant premature vacuum loss. Push tube onto needle, puncturing stopper diaphragm.
8. REMOVE TOURNIQUET AS SOON AS BLOOD APPEARS IN TUBE. DO NOT ALLOW CONTENTS OF TUBE TO CONTACT THE STOPPER OR END OF THE NEEDLE DURING PROCEDURE.

Note: Blood may occasionally leak from the needle sleeve. Practice Universal Precautions to minimize exposure hazard. If no blood flows into tube or if blood ceases to flow before an adequate specimen is collected, the following steps are suggested to complete satisfactory collection:

- a. Push tube forward until tube stopper has been penetrated. If necessary, hold in place to ensure complete vacuum draw.
- b. Confirm correct position of needle in vein.
9. When tube has filled to its stated volume and blood flow ceases, remove it from holder.
10. Invert 8 times.
11. Remove needle from vein, applying pressure to puncture site with dry sterile swab until bleeding stops.
12. Once clotting has occurred, apply bandage if desired.
13. After venipuncture, the top of the stopper may contain residual blood. Take proper precautions when handling tubes to avoid contact with this blood.
14. Dispose of needle and holder per your facility's policy and guidelines.
15. Store the filled PAXgene Blood DNA Tube at room temperature (18-25°C). See Performance Characteristics for DNA stability in blood samples at room temperature (18-25°C), 2-8°C, or -20°C.

See Procedure for Freezing and Thawing Specimens in the PAXgene Blood DNA Tubes for details if storage temperature of -70°C / -80°C is desired.

The following techniques shall be used to prevent possible backflow:

- a. Place donor's arm in a downward position.
- b. Hold tube with the stopper uppermost.
- c. Release tourniquet as soon as blood starts to flow into tube.
- d. Make sure tube additives do not touch stopper or end of the needle during venipuncture.

C. Procedure for Freezing and Thawing Specimens Collected in the PAXgene Blood DNA Tubes

1. Stand the PAXgene Blood DNA Tube upright in a wire rack. **Do not freeze tubes upright in a Styrofoam™ tray as this may cause the tubes to crack.**
2. The PAXgene Blood DNA Tubes can be stored at -20°C and below. If tubes are to be kept at temperatures below -20°C, freeze them first at -20°C for 24 hours, then transfer them to -70°C or -80°C.

(Continued)

3. Thaw the PAXgene Blood DNA Tubes in a wire rack at ambient temperature (18-25°C) for approximately two hours. **Do not thaw the PAXgene Blood DNA Tubes at temperatures above 25°C.**
4. Carefully invert the thawed PAXgene Blood DNA Tubes 10 times.

Note: The frozen PAXgene Blood DNA Tubes are subject to breakage upon impact. To reduce the risk of breakage during shipment, frozen tubes should be treated in the same manner as glass tubes. Users must validate their own freezing and shipping protocol for the PAXgene Blood DNA Tubes.

D. Procedure for Specimen Preparation for Analysis

Blood samples should be processed in accordance with the instructions provided with DNA sample preparation kit. For examples, see Ordering Information.

V. Performance Characteristics

After blood is introduced into the tube, the DNA remains stable for 14 days at 18 to 25°C (Figure 1). Based on DNA stability studies, blood can be stored in the tube for 14 days at 18 to 25°C, 28 days at 2°C to 8°C, 3 days at 35°C, or for a minimum of 6 months at -20°C with DNA concentration ≥ 12.5 ng/ μ l and DNA purity (A_{260}/A_{280}) of 1.7-1.9.

For the most recent data on the stability of frozen specimens, go to www.PreAnalytiX.com.

DNA Stability in Blood Samples at 18-25°C

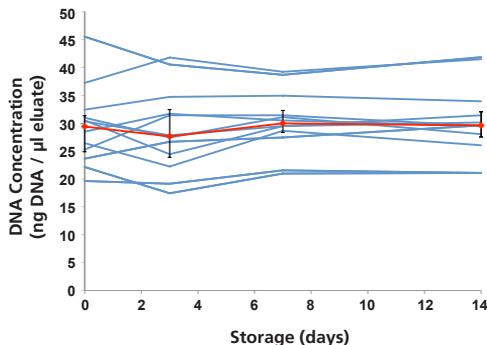


Figure 1

Blood was drawn from 12 consented adult donors and stored at 18-25°C for the indicated number of days followed by total DNA purification. Blood was collected and stored in PAXgene Blood DNA Tubes, and total DNA was purified using the QIAGEN® QIAasymphony® DSP DNA Mini Kit on the QIAGEN QIAasymphony automated instrument.

VI. Limitations

1. The quantity of blood drawn should be 2.5 ml per PAXgene Blood DNA Tube, but this volume may vary with altitude, ambient temperature, barometric pressure, tube age, venous pressure, and filling technique.

VII. Precautions


1. Practice universal precautions. Use gloves, gowns, eye protection, other personal protective equipment, and engineering controls to protect from blood splatter, blood leakage, and potential exposure to bloodborne pathogens.

- Handle all biologic samples and blood collection “sharps” according to the policies and procedures of your facility. Obtain appropriate medical attention in the event of any exposure to biologic samples (for example, through a puncture injury), since they may transmit viral hepatitis, HIV (AIDS), or other infectious diseases.
Utilize any built-in needle protector, if the blood collection set provides one. PreAnalytiX does not recommend resheilding used needles. However, the policies and procedures of your facility may differ and must always be followed.
- Discard all blood collection tubes in biohazard containers approved for their disposal.
- Do not re-use the PAXgene Blood DNA Tubes.
- Do not use the PAXgene Blood DNA Tubes after the expiration date printed on the tube label.
- Excessive centrifugation speed (over 10,000 RCF) may cause PAXgene Blood DNA Tube breakage, exposure to blood and possible injury.
- Do not transfer a sample from a syringe to a tube.

VIII. Storage


- Store the unused PAXgene Blood DNA Tubes at 18 to 25°C. Limited excursion temperatures up to 40°C are permitted. Do not use tubes after their expiration date.

IX. Instructions for Removal of BD Hemogard Closure



- Grasp the PAXgene Blood DNA Tube with one hand, placing the thumb under the BD Hemogard Closure. (For added stability, place arm on solid surface). With the other hand, twist the BD Hemogard Closure while simultaneously pushing up with the thumb of the other hand **ONLY UNTIL THE TUBE STOPPER IS LOOSENED**.
- Move thumb away before lifting closure. **DO NOT** use thumb to push closure off tube. If the tube contains blood, an exposure hazard exists. To help prevent injury during closure removal, it is important that the thumb used to push upward on the closure be removed from contact with the tube as soon as the BD Hemogard Closure is loosened.
- Lift closure off tube. In the unlikely event of the plastic shield separating from the rubber stopper, **DO NOT REASSEMBLE CLOSURE**. Carefully remove rubber stopper from tube.

X. Instructions for Reinsertion of BD Hemogard Closure



- Replace closure over tube.
- Twist and push down firmly until stopper is fully resealed. Complete reinsertion of the stopper is necessary for the closure to remain securely on the tube during handling.

Technical Assistance

If you have any questions regarding the PAXgene Blood DNA Tube, contact one of the BD Technical Services Departments listed in the BD - Customer Service section.

Ordering Information

PAXgene Products

PAXgene Blood DNA Tube / 761165

Content: 1,000 blood collection tubes

BD Products*

BD Vacutainer Eclipse Blood Collection Needle / 368609 CE

Content: 21G 1¼" inch needle, 0.8 mm x 32 mm, 48/box, 480/case

BD Vacutainer Eclipse Blood Collection Needle with Pre-Attached Holder / 368650

Content: 21G 1¼" inch needle, 0.8 mm x 32 mm, 100/case

BD Vacutainer Eclipse Signal Blood Collection Needle / 368835 CE

Content: 21G 1¼" inch needle, 0.8 mm x 32 mm, 50/box, 400/case

BD Vacutainer One Use Holder / 364815

Content: Case only for 13 mm and 16 mm diameter 1000/case

** These catalog numbers represent typical products that can be used with the PAXgene Blood DNA Tube.*

To order BD Blood Collection Accessories:

Go to: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Select country • Scroll down for BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Dial number

QIAGEN Products*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Content: Reagent cartridge, enzyme rack, piercing lid, buffer ATE, reuse seal set

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Content: QIAamp Mini spin columns, collection tubes, buffer AL, buffer ATL, buffer AW1, buffer AW2, buffer AE, QIAGEN protease, protease solvent

QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Content: RBC lysis solution, cell lysis solution, protein precipitation solution, DNA hydration solution, RNase A solution

** These catalog numbers represent typical DNA preparation kits that can be used with the PAXgene Blood DNA Tube.*

To order QIAGEN DNA Preparation Kits:

Go to: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

BD – Customer Service

Argentina, Uruguay and Paraguay

Orders: 011.4551.7100
E-mail: crc_argentina@bd.com

Australia

Orders: 1.800.656.100
Fax: 1.800.656.110
E-mail: bd_anz@bd.com

Austria

Orders: 43.1.7063660
Fax: 43.1.7063660-11

Belgium

Orders: 32.53.720.556
Fax: 32.53.720.549

Brazil

Orders: 0800.055.5654
E-mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Canada

Orders: 800.268.5430
Fax: 800.565.0897
E-mail: custsvccan@bd.com

Denmark

Orders: 45.43.43.45.66
Fax: 45.43.96.56.76
E-mail: bdcs_dk@europe.bd.com

East Europe

Orders: 48.22.651.75.88
Fax: 48.22.651.75.89

Finland

Orders: 358.9.88.70.780
Fax : 358.9.88.70.7816
E-mail: bdorder_finland@europe.bd.com

France

Orders: 33.476.689496
Fax: 33.476.683693
E-mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Germany

Orders: 49.6221305553
Fax: 49.6221305379

Italy

Orders: 39.02.48.240.500
Fax: 39.02.48.240.344
Technical: 39.02.48.240.264
E-mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Middle East & Africa (EMA)

Orders: 971.4.3379525
Fax: 971.4.03379551
E-mail: EMA_PAS@bd.com

The Netherlands

Orders: 31.20.6545.716
Fax: 31.20.5829.421
E-mail:
vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

New Zealand

Orders: 0800.572.468
Fax: 0800.572.469
E-mail: bd_anz@bd.com

Norway

Orders: 47.73.59.12.00
Fax: 47.73.59.12.01

Spain

Orders: 34.902.27.17.27
Fax: 34.91.848.81.04
E-mail: servicio_de_clientes@bd.com

Sweden

Orders: 46.8.775.51.60
Fax 46: 8.775.51.95
E-mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Switzerland

Orders: 41.61.4852222
Fax: 41.61.4852200

UK

Orders: 44.1.865.781.666
Fax: 44.1.865.717.313
E-mail:
bduk_customerservice@europe.bd.com

USA

Orders: 888.237.2762
Fax: 800.847.2220
Technical: 800.631.0174
E-mail:
www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Customer Service

Australia

Orders: 03.9840.9800
Fax: 03.9840.9888
Technical: 1.800.243.066

Austria

Orders: 0800/28.10.10
Fax: 0800/28.10.19
Technical: 0800/28.10.11

Belgium

Orders: 0800.79612
Fax: 0800.79611
Technical: 0800.79556

Canada

Orders: 800.572.9613
Fax: 800.713.5951
Technical: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

China

Orders: 0086.21.3865.3865
Fax: 0086.21.3865.3965
Technical: 800.988.0325 / 800.988.0327

Denmark

Orders: 80.885945
Fax: 80.885944
Technical: 80.885942

Finland

Orders: 0800.914416
Fax: 0800.914415
Technical: 0800.914413

France

Orders: 01.60.920.926
Fax: 01.60.920.925
Technical: 01.60.920.930
Offers: 01.60.920.928

Germany

Orders: 02103.29.12000
Fax: 02103.29.22000
Technical: 02103.29.12400

Hong Kong

Orders: 800.933.965
Fax: 800.930.439
Technical: 800.930.425

Ireland

Orders: 1800.555.049
Fax: 1800.555.048
Technical: 1800.555.061

Italy

Orders: 02.33430411
Fax: 02.33430426
Technical: 800.787980

Japan

Telephone: 03.5547.0811
Fax: 03.5547.0818
Technical: 03.5547.0811

Korea (South)

Orders: 1544.7145
Fax: 1544.7146
Technical: 1544.7145

Luxembourg

Orders: 8002.2076
Fax: 8002.2073
Technical: 8002.2067

The Netherlands

Orders: 0800.0229592
Fax: 0800.0229593
Technical: 0800.0229602

Norway

Orders: 800.18859
Fax: 800.18817
Technical: 800.18712

Singapore

Orders: 65.67775366
Fax: 65.67785177
Technical: 65.67775366

Spain

Orders: 91.630.7050
Fax: 91.630.5145
Technical: 91.630.7050

Sweden

Orders: 020.790282
Fax: 020.790582
Technical: 020.798328

Switzerland

Orders: 055.254.22.11
Fax: 055.254.22.13
Technical: 055.254.22.12

UK

Orders: 01293.422.911
Fax: 01293.422.922
Technical: 01293.422.999

USA

Orders: 800.426.8157
Fax: 800.718.2056
Technical: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Епруветка за кръв за изолиране на ДНК

BG – Български

I. Предназначение

Епруветката за кръв за изолиране на ДНК PAXgene е предназначена за вземане, антикоагулиране, стабилизиране, пренасане и съхранение на проби от венозна цяла кръв за подготовка на висококачествена ДНК за използване при тестови методи за молекулярна диагностика, които изискват ДНК.

Работните характеристики на тази епруветка като цяло не са установени за молекулярни диагностични анализи. Потребителите трябва да валидират употребата на този продукт за своите специфични молекулярни анализи.

Характеристики на продукта

Епруветка за кръв за изолиране на ДНК PAXgene • 2,5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA адитив
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 епруветки/картонена кутия • 1,000 епруветки/опаковка

II. Общо описание и обяснение

Епруветката за кръв за изолиране на ДНК PAXgene осигурява средство за вземане на цяла кръв за изолиране на геномна ДНК в затворена, вакуумна система. Кръвта се взема съгласно стандартния протокол за флеботомия във вакуумна епруветка, която съдържа K₂EDTA адитив. Пълното изолиране на ДНК се извършва чрез помощта на ръчни или автоматизирани методи като утаяване на белтъци, магнитни частици или технологии на базата на мембрана от силициев двуокис.

III. Предупреждения

Съдържанието в тази епруветка дразни кожата.


- В случай на вдишване лицето да се изведе на свеж въздух.
- След контакт с кожата незабавно измийте с много сапун и вода за поне 15 минути.
- След контакт с очите незабавно да се изплакнат обилно с вода за поне 15 минути.
- При поглъщане незабавно да се поеме голямо количество вода. Потърсете медицинска помощ.

IV. Вземане на проби и подготовка за анализ

A. Необходими принадлежности за вземане на кръв (Не са включени с епруветката за кръв за изолиране на ДНК PAXgene)

1. Игла за вземане на кръв като BD Vacutainer® Eclipse™ или BD Vacutainer Eclipse Signal™. Вижте информацията за поръчка.
2. Трябва да се използва държач за игла BD Vacutainer, за да се гарантира правилна работа. Вижте информацията за поръчка.
3. Етикети за положително идентифициране на пробите на отделните донори, ако е необходимо
4. Тампон със спирт за почистване на мястото
5. Суха стерилна марля
6. Турникет
7. Контейнер за изхвърляне на игли за използваните игли или за комбинацията игла/държач

Б. Процедура за вземане на проби



(Продължение)

Общи инструкции

НОСЕТЕ РЪКАВИЦИ ПО ВРЕМЕ НА ВЕНЕПУНКЦИЯТА И ПРИ РАБОТА С ЕПРУВЕТКИТЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ, ЗА ДА СВЕДЕТЕ ДО МИНИМУМ ОПАСНОСТТА ОТ ИЗЛАГАНЕ.

1. Сглобете иглата в държача. Уверете се, че иглата е здраво застопорена, за да се гарантира, че тя няма да се изниже по време на употреба.
2. Поставете епруветката в държача. Забележка: Не пробивайте тапата.
3. Изберете място за венепункция.
4. **Поставете турникета. Подгответе мястото за венепункция с подходящ антисептик. НЕ ПАЛПИРАЙТЕ ОБЛАСТТА НА ВЕНЕПУНКЦИЯ СЛЕД ПОЧИСТВАНЕ.**
5. Поставете ръката на пациента в позиция надолу.
6. Отстранете предпазителя на иглата. Извършете венепункцията, КАТО РЪКАТА Е В ПОЗИЦИЯ НАДОЛУ, А ТАПАТА НА ЕПРУВЕТКАТА Е НАЙ-ОТГОРЕ.
7. Центрирайте епруветките в държача, когато проникват в тапата, за да предотвратите навлизане в страничната стена и възникващата като резултат преждевременна загуба на вакуум. Тласнете епруветката върху иглата, пробивайки диафрагмата на тапата.
8. **ОТСТРАНЕТЕ ТУРНИКЕТА, КОГАТО КРЪВТА СЕ ПОЯВИ В ЕПРУВЕТКАТА. НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕПРУВЕТКАТА ДА ВЛИЗА В КОНТАКТ С ТАПАТА ИЛИ С КРАЯ НА ИГЛАТА ПО ВРЕМЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.**

Забележка: Понякога кръвта може да изтече от кожата на иглата. Вземете универсални предпазни мерки, за да сведете до минимум излагането на опасност. Ако в епруветката не изтича кръв или ако кръвта спре да тече, преди да е взета подходяща проба, Ви предлагаме да предприемете следните стъпки, за да завършите успешно вземането на пробата:

- a. Тласнете епруветката напред, докато проникнете в тапата ѝ. Ако е необходимо, задръжте на място, за да осигурите пълно вакуумно изтегляне.
 - b. Проверете правилната позиция на иглата във вената.
9. Когато епруветката се напълни до посочения обем и кръвният поток спре, я отстранете от държача.
 10. Обърнете 8 пъти.
 11. Отстранете иглата от вената, като прилагате натиск към мястото на убождане със сух стерилен тампон, докато кървенето спре.
 12. След като се появи съсирване, ако желаете, поставете превръзка.
 13. След венепункцията в горната част на тапата може да има остатъчна кръв. Вземете подходящи предпазни мерки, когато боравите с епруветките, за да избегнете контакт с тази кръв.
 14. Изхвърлете иглата и държача според политиката и насоките на Вашето здравно заведение.
 15. Съхранявайте пълната епруветка за кръв за изолиране на ДНК PAXgene при стайна температура (18–25°C). Вижте работни характеристики за стабилност на ДНК в кръвните проби при стайна температура (18–25°C), 2–8°C, или –20°C.

Вижте процедурата за замразяване и размразяване на проби в инструкциите на епруветката за кръв за изолиране на ДНК PAXgene за подробности, ако е необходима температура на съхранение в диапазона –70°C / –80°C.

Трябва да използвате следните техники, за да предотвратите вероятен обратен поток:

- a. Поставете ръката на донора в позиция надолу.
- b. Хванете епруветката така, че тапата да бъде най-отгоре.
- v. Освободете турникета, когато кръвта започне да се влива в епруветката.
- г. Уверете се, че адитивите на епруветката не докосват тапата или края на иглата по време на венепункцията.

В. Процедура за замразяване и размразяване на проби, взети с епруветки за кръв за изолиране на ДНК PAXgene

1. Поставете епруветката за кръв за изолиране на ДНК PAXgene в изправено положение в телена стойка. **Не замразявайте епруветките в изправена позиция в тавичка от стиропор Styrofoam™, тъй като това може да доведе до напукването им.**
2. Епруветките за кръв за изолиране на ДНК PAXgene могат да се съхраняват на температура –20°C и по-малко. Ако епруветките се съхраняват на температура под –20°C, замразете ги първо на –20°C за 24 часа, а след това на –70°C или –80°C.

(Продължение)

- Размразете епруветките за кръв за изолиране на ДНК PAXgene в телена стойка на стайна температура (18–25°C) за около два часа. **Не размразявайте епруветките за кръв за изолиране на ДНК PAXgene на температура над 25°C.**
- Внимателно обърнете размразените епруветки за кръв за изолиране на ДНК PAXgene 10 пъти.

Забележка: Замразените епруветки за кръв за изолиране на ДНК PAXgene могат да се счупят при удар. За да се намали рискът от счупване по време на транспортиране, замразените епруветки трябва да се третират по същия начин, както стъклените. Потребителите трябва да валидират протокола за замразяване и пренасяне за епруветки за кръв за изолиране на ДНК PAXgene.

Г. Процедура за подготовка на проби за анализ


Кръвните проби трябва да са в съответствие с инструкциите, описани в комплекта за подготовка за вземане на ДНК проба. За примери вижте информацията за поръчка.

В. Работни характеристики

След като кръвта е въведена в епруветката, ДНК остава стабилна за 14 дни при 18°C до 25°C (Фигура 1). Според изследвания за стабилността на ДНК, кръвта може да се съхранява в епруветка за 14 дни при 18°C до 25°C, 28 дни при 2°C до 8°C, 3 дни при 35°C, или за минимум 6 месеца при -20°C с ДНК концентрация $\geq 12,5$ pg/ μ l и чистота на ДНК (A₂₆₀/A₂₈₀) от 1,7–1,9.

За най-актуална информация относно стабилността на замразените проби посетете www.PreAnalytiX.com.

Стабилност на ДНК в кръвни проби при 18–25°C

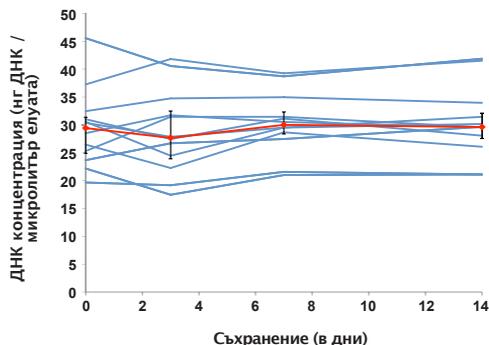

Фигура 1

Взета е кръв от 12 възрастни донори, изразили съгласие, която се съхранява при 18–25°C за определен брой дни, след което се извършва пречистване на тотална ДНК. Кръвта се взема и съхранява в епруветки за кръв за изолиране на ДНК PAXgene, като тоталната ДНК се пречиства с помощта на мини комплект QIAGEN® QIA Symphony® DSP DNA на автоматичния инструмент QIAGEN QIA Symphony®.

VI. Ограничения

- Количеството изтеглена кръв трябва да е 2,5 ml на една епруветка за кръв за изолиране на ДНК PAXgene, но този обем може да варира според надморската височина, температурата на околната среда, барометричното налягане, възрастта на епруветката, венозното налягане и техниката на пълнене.

VII. Предпазни мерки


1. Вземайте универсални предпазни мерки. Използвайте ръкавици, облекла, средства за защита на очите, друго оборудване за лична защита и технически мерки за защита от пръски кръв, изтичания на кръв и потенциално излагане на патогени, пренасяни по кръвен път.
2. Третирайте всички биологични проби и кръвни продукти като "опасни" съгласно политиката и процедурите на вашето здравно заведение. Трябва да получите съответната медицинска помощ в случай на излагане на въздействието на биологични проби (например при убождаване), тъй като пробите могат да пренесат вирусен хепатит, HIV (СПИН) или други инфекциозни заболявания.

Използвайте вградения предпазител на иглите, ако изделието за вземане на кръвни проби има такъв. PreAnalytiX не препоръчва върху използваните игли отново да се поставя предпазител. Въпреки това, Вие трябва винаги да следвате политиката и процедурите на Вашето здравно заведение, които могат да бъдат различни.
3. Изхвърляйте всички епруветки за вземане на кръв в одобрени за тази цел контейнери за биологично опасни материали.
4. Не използвайте повторно епруветките за кръв за изолиране на ДНК PAXgene.
5. Не използвайте епруветките за кръв за изолиране на ДНК PAXgene след изтичане на срока на годност, отпечатан върху техния етикет.
6. Прекалено високата скорост на центрофугиране на епруветките за кръв за изолиране на ДНК PAXgene (над 10 000 RCF) може да доведе до счупване на епруветката, излагане на кръв и евентуално нараняване.
7. Не прехвърляйте проба от спринцовка в епруетка.

VIII. Съхранение


1. Съхранявайте неизползваните епруветки за кръв за изолиране на ДНК PAXgene между 18°C и 25°C. Допустими са ограничени температурни отклонения до 40°C. Не използвайте епруветките след изтичане на срока на годност.

IX. Инструкции за отстраняване на BD NemoGuard запушалката



1. Хванете епруветката за кръв за изолиране на ДНК PAXgene с една ръка, като поставите палеца под BD NemoGuard запушалката. (За по-голяма стабилност поставете ръката си върху твърда повърхност). С другата ръка завъртете BD NemoGuard запушалката, като едновременно я избутвате нагоре с палеца на другата ръка, САМО ДОКАТО ТАПАТА НА ЕПРУВЕТКАТА СЕ РАЗХЛАБИ.
2. Махнете палеца, преди да извадите запушалката. НЕ използвайте палеца, за да избутате запушалката навън от епруветката. Ако епруветката съдържа кръв, съществува риск от излагане. За да се избегне нараняване при отстраняване на запушалката, важно е палецът, който се използва за избутването ѝ нагоре, да не се допира до епруветката, след като BD NemoGuard запушалката се разхлаби.
3. Извадете запушалката от епруветката. При малко вероятния случай на отделяне на пластмасовия предпазител от гумената тапа, НЕ СГЛОБЯВАЙТЕ ЗАПУШАЛКАТА ОТНОВО. Внимателно извадете гумената тапа от епруветката.

X. Инструкции за повторно поставяне на BD NemoGuard запушалката



1. Поставете отново запушалката върху епруветката.
2. Завъртете и натиснете силно надолу, докато тапата отново застане на мястото си плтно. Цялостното повторно въвеждане на тапата е необходимо, за да остане запушалката застопорена върху епруветката по време на работа.

Техническа помощ

Ако имате някакви въпроси относно епруветката за кръв за изолиране на ДНК PAXgene, се обърнете към Отдела за техническа поддръжка на BD – Раздел "Обслужване на клиенти".

Информация за поръчка

Продукти PAXgene

Епруветка за кръв за изолиране на ДНК PAXgene / 761165

Съдържание: 1000 епруветки за вземане на кръв.

BD Продукти*

Игла за вземане на кръв BD Vacutainer Eclipse / 368609 CE

Съдържание: Игла 21G 1¼" инча, 0,8 mm x 32 mm, 48/кутия, 480/опаковка

Игла за вземане на кръв BD Vacutainer Eclipse с предварително прикрепен държач / 368650

Съдържание: Игла 21G 1¼" инча, 0,8 mm x 32 mm, 100/опаковка

Игла за вземане на кръв BD Vacutainer Eclipse Signal / 368835 с CE

Съдържание: Игла 21G 1¼" инча, 0,8 mm x 32 mm, 50/кутия, 400/опаковка

Държач за еднократна употреба BD Vacutainer / 364815

Съдържание: Опаковка само за 13 mm и 16 mm диаметър 1000/опаковка

* Тези каталожни номера съответстват на типични продукти, които могат да се използват с епруветката за кръв за изолиране на ДНК PAXgene .

За да поръчате принадлежности за вземане на кръв от BD:

Посетете: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Изберете държава • Скролирайте за BD Diagnostics – Preanalytical Systems • Наберете номер

QIAGEN Продукти*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Съдържание: Пълнител за реагент, стойка за ензими, капаче за пробождане, буфер АТЕ, комплект за повторна употреба

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Съдържание: QIAamp Mini въртящи се колони, епруветки за вземане на кръв, буфер AL, буфер ATL, буфер AW1, буфер AW2, буфер АЕ, QIAGEN протеаза, разтворител за протеаза

QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Съдържание: RBC разтвор за лизис, разтвор за клетъчен лизис, разтвор за утаяване на белтъци, разтвор за ДНК хидратиране, разтвор RNase A

* Тези каталожни номера съответстват на типични комплекти за подготовка за ДНК, които могат да се използват с епруветката за кръв за изолиране на ДНК PAXgene .

За да поръчате комплекти за подготовка на ДНК QIAGEN:

Посетете: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

Епруветката за кръв за изолиране на PAXgene е произведена в Обединеното кралство от BD за PreAnalytiX GmbH. PAXgene и PreAnalytiX са търговски марки на PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene са търговски марки на QIAGEN NV; Styrofoam е търговска марка на Dow Chemical Company; всички други търговски марки са собственост на Vector, Dickinson and Company.

(Продължение)

BD – Отдел "Обслужване на клиенти"

Аржентина, Уругвай и Парагвай

Поръчки: 011.4551.7100
Имейл: crc_argentina@bd.com

Австралия

Поръчки: 1.800.656.100
Факс: 1.800.656.110
Имейл: bd_anz@bd.com

Австрия

Поръчки: 43.1.7063660
Факс: 43.1.7063660-11

Белгия

Поръчки: 32.53.720.556
Факс: 32.53.720.549

Бразилия

Поръчки: 0800.055.5654
Имейл: consultoria_vacutainer@bd.com

Канада

Поръчки: 800.268.5430
Факс: 800.565.0897
Имейл: custsvccan@bd.com

Дания

Поръчки: 45.43.43.45.66
Факс: 45.43.96.56.76
Имейл: bdcs_dk@europe.bd.com

Източна Европа

Поръчки: 48.22.651.75.88
Факс: 48.22.651.75.89

Финландия

Поръчки: 358.9.88.70.780
Факс: 358.9.88.70.7816
Имейл: bdorder_finland@europe.bd.com

Франция

Поръчки: 33.476.689496
Факс: 33.476.683693
Имейл: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Германия

Поръчки: 49.6221305553
Факс: 49.6221305379

Италия

Поръчки: 39.02.48.240.500
Факс: 39.02.48.240.344
Техническо обслужване: 39.02.48.240.264
Имейл: ordini_medicale@europe.bd.com

Близкия Изток и Африка (ЕМА)

Поръчки: 971.4.3379525
Факс: 971.4.03379551
Имейл: EMA_PAS@bd.com

Нидерландия

Поръчки: 31.20.6545.716
Факс: 31.20.5829.421
Имейл: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Нова Зеландия

Поръчки: 0800.572.468
Факс: 0800.572.469
Имейл: bd_anz@bd.com

Норвегия:

Поръчки: 47.73.59.12.00
Факс: 47.73.59.12.01

Испания

Поръчки: 34.902.27.17.27
Факс: 34.91.848.81.04
Имейл: servicio_de_clientes@bd.com

Швеция

Поръчки: 46.8.775.51.60
Факс 46: 8.775.51.95
Имейл: bdorder_sweden@europe.bd.com

Швейцария

Поръчки: 41.61.4852222
Поръчки: 41.61.4852200

Обединено кралство

Поръчки: 44.1.865.781.666
Факс: 44.1.865.717.313
Имейл: bduk_customerservice@europe.bd.com

САЩ

Поръчки: 888.237.2762
Факс: 800.847.2220
Техническо обслужване: 800.631.0174
Имейл: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Отдел "Обслужване на клиенти"

Австралия

Поръчки: 03.9840.9800

Факс: 03.9840.9888

Техническо обслужване: 1.800.243.066

Австрия

Поръчки: 0800/28.10.10

Факс: 0800/28.10.19

Техническо обслужване: 0800/28.10.11

Белгия

Поръчки: 0800.79612

Факс: 0800.79611

Техническо обслужване: 0800.79556

Канада

Поръчки: 800.572.9613

Факс: 800.713.5951

Техническо обслужване: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Китай

Поръчки: 0086.21.3865.3865

Факс: 0086.21.3865.3965

Техническо обслужване: 800.988.0325 / 800.988.0327

Дания

Поръчки: 80.885945

Факс: 80.885944

Техническо обслужване: 80.885942

Финландия

Поръчки: 0800.914416

Факс: 0800.914415

Техническо обслужване: 0800.914413

Франция

Поръчки: 01.60.920.926

Факс: 01.60.920.925

Техническо обслужване: 01.60.920.930

Оферти: 01.60.920.928

Германия

Поръчки: 02103.29.12000

Факс: 02103.29.22000

Техническо обслужване: 02103.29.12400

Хонг Конг

Поръчки: 800.933.965

Факс: 800.930.439

Техническо обслужване: 800.930.425

Ирландия

Поръчки: 1800.555.049

Факс: 1800.555.048

Техническо обслужване: 1800.555.061

Италия

Поръчки: 02.33430411

Факс: 02.33430426

Техническо обслужване: 800.787980

Япония

Телефон: 03.5547.0811

Факс: 03.5547.0818

Техническо обслужване: 03.5547.0811

Корея (Южна)

Поръчки: 1544.7145

Факс: 1544.7146

Техническо обслужване: 1544.7145

Люксембург

Поръчки: 8002.2076

Факс: 8002.2073

Техническо обслужване: 8002.2067

Нидерландия

Поръчки: 0800.0229592

Факс: 0800.0229593

Техническо обслужване: 0800.0229602

Норвегия

Поръчки: 800.18859

Факс: 800.18817

Техническо обслужване: 800.18712

Сингапур

Поръчки: 65.67775366

Факс: 65.67785177

Техническо обслужване: 65.67775366

Испания

Поръчки: 91.630.7050

Факс: 91.630.5145

Техническо обслужване: 91.630.7050

Швеция

Поръчки: 020.790282

Факс: 020.790582

Техническо обслужване: 020.798328

Швейцария

Поръчки: 055.254.22.11

Факс: 055.254.22.13

Техническо обслужване: 055.254.22.12

Обединено кралство

Поръчки: 01293.422.911

Факс: 01293.422.922

Техническо обслужване: 01293.422.999

САЩ

Поръчки: 800.426.8157

Факс: 800.718.2056

Техническо обслужване: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Zkumavka s krevní DNA

CS – čeština

I. Účel použití

Zkumavka PAXgene Blood DNA slouží ke shromažďování, antikoagulaci, stabilizaci, přepravě a skladování vzorku plně žilní krve pro přípravu kvalitní DNA k použití u molekulárních diagnostických vyšetření, která vyžadují použití DNA.

Vlastnosti výkonu tohoto zařízení nebyly stanoveny pro vzorky molekulární diagnostiky obecně. Uživatelé musí ověřit použití produktu pro konkrétní molekulární diagnostické stanovení.

Funkce produktu

Zkumavka PAXgene Blood DNA • 2,5 ml • 13 x 75 mm • přísada K₂EDTA
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 zkumavek / karton • 1000 zkumavek / kazeta

II. Shrnutí a vysvětlení

Zkumavka PAXgene Blood DNA Tube představuje prostředek k odběru plně krve k izolaci genomové DNA v uzavřeném vakuovém systému. Krev se odebírá v souladu se standardním protokolem flebotomie do vakuové zkumavky, která obsahuje přísadu K₂EDTA. Kompletní izolace DNA se provádí pomocí ručních nebo automatizovaných metod, jako je srážení pomocí roztoku soli, magnetické korálky nebo technologie založené na křemičité membráně.

III. Varování

Obsah této zkumavky způsobuje podráždění pokožky.


- V případě vdechnutí přemístěte osobu, která obsah vdechla, na čerstvý vzduch.
- Při zasažení pokožky místo okamžitě omyjte vodou s velkým množstvím mýdla a důkladně oplachujte nejméně 15 minut.
- Jsou-li zasaženy oči, začněte otevřené oko ihned vyplachovat proudem vody a vyplachujte je nejméně 15 minut.
- V případě polknutí se ihned napijte velkého množství vody. Vyhledejte lékařskou pomoc.

IV. Odběr vzorku a jeho příprava na analýzu

A. Příslušenství nezbytné k odběru krve (nedodává se se zkumavkou PAXgene Blood DNA)

1. Jehla pro odběr krve, například BD Vacutainer® Eclipse™ Blood Collection Needle nebo BD Vacutainer Eclipse Signal™ Blood Collection Needle. Viz Informace o objednávání.
2. Je nutné použít držák jehly BD Vacutainer, aby se zajistilo správné fungování. Viz Informace o objednávání.
3. Štítky pro pozitivní identifikaci vzorků dárce, pokud je třeba
4. Tampón nasycený lihem k očištění místa vpichu
5. Suchá sterilní gáza
6. Škrtdlo
7. Nádobna na použitou jehlu nebo jehlu kombinovanou s držákem

B. Postup při odběru vzorků



Obecné pokyny

KVŮLI MINIMALIZACI RIZIKA EXPOZICE POUŽÍVEJTE PŘI PROVÁDĚNÍ VENEPUNKCE A PŘI MANIPULACI SE ZKUMAVKAMI NA ODBĚR KRVE RUKAVICE.

1. Vložte jehlu do držáku. Ujistěte se, že je jehla pevně připojena, aby nedošlo k jejímu uvolnění během použití.
2. Vložte zkumavku do držáku. Poznámka: Nepropichujte zátku.
3. Zvolte místo pro provedení venepunkce.
4. **Nasadte manžetu. Připravte místo venepunkce vhodným antiseptickým přípravkem. PO VYČIŠTĚNÍ SE MÍSTA VENEPUNKCE NEDOTÝKEJTE.**
5. Skloňte pacientovu paži směrem dolů.
6. Sejměte kryt jehly. Provedte venepunkci S PAŽÍ SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ A ZÁTKOU ZKUMAVKY SMĚŘUJÍCÍ NAHORU.
7. Při propíchování zátky umístěte zkumavku doprostřed držáku, aby nedošlo k propíchnutí bočních stěn a výsledné předčasné ztrátě vakua. Zatlačte zkumavku na jehlu a propíchněte blánu zátky.
8. **JAKMILE SE VE ZKUMAVCE OBJEVÍ KREV, SEJMĚTE MANŽETU. NEDOVOLTE, ABY OBSAH ZKUMAVKY BĚHEM ODBĚRU PŘÍŠEL DO STYKU SE ZÁTKOU NEBO S KONCEM JEHLY.**

Poznámka: Může se stát, že krev prosakuje z pouzdra jehly. Aby bylo minimalizováno riziko expozice, dodržujte obecné zásady bezpečnosti. Pokud do zkumavky neproudí krev nebo pokud před odebráním dostatečně velkého vzorku přestane krev proudit, doporučujeme k dokončení úspěšného odběru postupovat takto:

- a. Zatlačte zkumavku vpřed, až dojde k propíchnutí zátky. Pokud je to nutné, držte ji na místě, aby došlo k úplnému vakuovému odběru.
 - b. Ujistěte se, že je poloha jehly v žíle správná.
9. Pokud se první zkumavka naplnila na svůj nominální objem a krev přestane proudit, vyjměte ji z držáku.
 10. Osmkrát převraťte.
 11. Vytáhněte jehlu ze žíly a vyvíjejte tlak na místo vpichu suchým sterilním tamponem, dokud se krvácení nezastaví.
 12. Jakmile dojde ke srážení krve, nalepte podle potřeby náplast.
 13. Po napíchnutí žíly mohou na horní části zátky ulpět stopy krve. Při manipulaci se zkumavkami dbejte na náležitá bezpečnostní opatření, aby nedošlo ke kontaktu s krví.
 14. Jehlu a držák zlikvidujte podle vnitřních postupů pracoviště.
 15. Naplněnou zkumavku PAXgene Blood DNA uchovávejte při pokojové teplotě (18–25°C). Viz vlastnostní výkonu pro stabilitu DNA v krevních vzorcích při pokojové teplotě (18–25°C), 2–8°C nebo -20°C.

V části Postup pro zmrazování a rozmrazování vzorků odebraných do zkumavek PAXgene Blood DNA najdete podrobnosti pro případ, že je třeba použít teplotu skladování -70°C / -80°C.

Abyste nedošlo ke zpětnému toku, je třeba dodržet tyto postupy:

- a. Paži dárce umístěte tak, aby směřovala dolů.
- b. Držte zkumavku zátkou nahoru.
- c. Uvolněte manžetu ihned poté, co se ve zkumavce objeví krev.
- d. Zajistěte, aby se přísady během venepunkce nedotýkaly zátky nebo konce jehly.

C. Postup pro zmrazování a rozmrazování vzorků odebraných do zkumavek PAXgene Blood DNA

1. Postavte zkumavku PAXgene Blood DNA na výšku do drátěného roštu. Zkumavky nezmrazujte přímo v tácku styrofoam Styrofoam™, protože by se mohla rozbít.
2. Zkumavky PAXgene Blood DNA lze skladovat při teplotách -20°C a nižších. Jestliže se zkumavky mají skladovat při teplotě nižší než -20°C, zmrazte je nejprve při teplotě -20°C po dobu 24 hodin, a pak je přeneste do teploty -70°C nebo -80°C.

3. Zkumavky PAXgene Blood DNA rozmrazujte v drátěném roštu při pokojové teplotě (18–25°C) po dobu asi dvou hodin. **Zkumavky PAXgene Blood DNA nerozmrazujte při teplotách nad 25°C.**
4. Rozmrazené zkumavky PAXgene Blood DNA opatrně 10krát převratte.

Poznámka: Zmrazené zkumavky PAXgene Blood DNA se při nárazu rozbijí. Aby bylo sníženo riziko rozbití během přepravy, je se zmraženými zkumavkami zapotřebí manipulovat stejně jako se zkumavkami skleněnými. Uživatelé si musí pro zkumavky PAXgene Blood DNA zavést vlastní protokol zmrazování a přepravy.

D. Postup přípravy vzorku k rozboru


Vzorky krve by se měly zpracovávat v souladu s pokyny dodanými se sadou na přípravu vzorku DNA. Příklady najdete v Informacích o objednávání.

V. Užité vlastnosti

Po nasátí krve do zkumavky zůstává DNA stabilní po dobu 14 dní při 18 až 25°C (Obrázek 1). Podle studií stability DNA je možné krev ve zkumavce uchovávat 14 dní při 18 až 25°C, 28 dní při 2 až 8°C, 3 dny při 35°C nebo minimálně 6 měsíce při -20°C s koncentrací DNA $\geq 12,5$ ng/ μ l a čistotě DNA DNA (A_{260}/A_{280}) 1,7–1,9.

Nejnovější údaje o stabilitě zmrazených vzorků najdete na stránkách www.PreAnalytiX.com.

Stabilita DNA v krevních vzorcích při 18–25°C

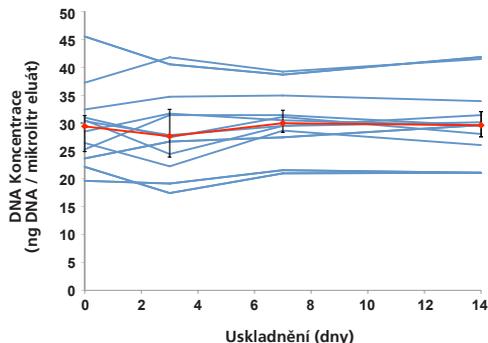

Obrázek 1

Krev byla odebrána 12 dospělým dárcům (s jejich svolením) a skladována při 18–25°C po uvedený počet dní, po nichž následovalo čištění celkové DNA. Byla odebrána a shromážděna ve zkumavkách PAXgene Blood DNA a celková DNA byla vyčištěna pomocí sady QIAGEN® QIAasympphony® DSP DNA Mini Kit v automatickém nástroji QIAGEN QIAasympphony.

VI. Omezení

1. Objem získané krve by měl být 2,5 ml na zkumavku PAXgene Blood DNA, ale může se lišit podle nadmořské výšky, okolní teploty, barometrického tlaku, stáří zkumavky, žilního tlaku a způsobu plnění.

VII. Bezpečnostní opatření

1. Dodržujte obecné zásady bezpečnosti. Používejte rukavice, pláště, ochranu očí, další pomůcky osobní ochrany a konstrukční prvky k ochraně před vystříknutou krví, prosakující krví a případnou expozicí patogenům přenášeným krví.

2. Se všemi biologickými vzorky a ostrými pomůckami k odběru krve zacházejte v souladu s předpisy a postupy platnými na vašem pracovišti. V případě jakékoli expozice biologickým vzorkům (např. při poranění pokožky) vyhledejte adekvátní lékařskou pomoc – vzorky mohou přenášet virovou hepatitidu, HIV (AIDS) či jiné infekční choroby.


Používejte integrovaný chránič jehly, pokud je jím odběrová sada vybavena. Společnost PreAnalytiX nedoporučuje zakrývání použitých jehel krytem. Pokud však zásady a postupy vašeho zařízení ukládají jinak, dodržujte je.

3. Všechny ostré předměty po použití odhodte do nádoby určené pro biologický nebezpečný odpad.
4. Zkumavky PAXgene Blood DNA nepoužívejte opakovaně.
5. Nepoužívejte zkumavky PAXgene Blood DNA po vypršení data expirace vytištěného na štítku zkumavky.
6. Nepřiměřená rychlost odstředování (více než 10 000 RCF) může způsobit rozbití zkumavky PAXgene Blood DNA, expozici krvi a možná zranění.
7. Přenášení vzorku ze stříkačky do zkumavky se nedoporučuje.

VIII. Přechovávání

1. Nepoužité zkumavky PAXgene Blood DNA skladujte při teplotě 18 až 25°C. Je povoleno krátkodobé vystavení teplotám do 40°C. Zkumavky nepoužívejte po uplynutí data expirace.


IX. Pokyny k sejmutí uzávěru BD Hemogard



1. Uchopte zkumavku PAXgene Blood DNA jednou rukou a palec vložte pod uzávěr BD Hemogard. (Kvůli větší stabilitě položte ruku na pevný povrch). Druhou rukou otočte uzávěr BD Hemogard a zároveň tlačte palcem druhé ruky nahoru, DOKUD SE UZÁVĚR ZKUMAVKY NEUVOLNÍ.

2. Před zvednutím uzávěru palec odtáhněte. Palcem NETLAČTE uzávěr ze zkumavky. Pokud zkumavka obsahuje krev, hrozí riziko expozice. Aby nedošlo k poranění při snímání uzávěru, je důležité palec použitý k zatlačení uzávěru nahoru odtáhnout od kontaktu se zkumavkou, jakmile se uzávěr BD Hemogard uvolní.
3. Zvedněte uzávěr ze zkumavky. Pokud dojde k oddělení plastového krytu od gumové zátky, což není pravděpodobné, NEPOKOUŠEJTE SE ZÁVĚR OPĚT SESTAVIT. Opatrně zvedněte gumovou zátku ze zkumavky.

X. Pokyny k opětovnému vložení uzávěru BD Hemogard



1. Vraťte uzávěr na zkumavku.
2. Otočte a pevně zatlačte dolů, dokud zátka zcela nezapadne na své místo. Aby uzávěr zůstal při manipulaci bezpečně na zkumavce, je nutné zátku zcela vrátit zpět.

Technická podpora

Pokud máte nějaké otázky týkající se zkumavky PAXgene Blood DNA, obraťte se na některé z oddělení technických služeb společnosti BD v oddílu BD – služby zákazníkům.

Informace o objednávání

Produkty PAXgene

Zkumavka PAXgene Blood DNA / 761165

Obsah: 1000 zkumavek na odběr krve.

Produkty BD*

Jehla na odběr krve BD Vacutainer Eclipse / 368609 CE

Obsah: Jehla 21G 1¼ palců, 0,8 mm x 32 mm, krabice á 48, kazeta á 480

Jehla na odběr krve BD Vacutainer Eclipse s předem nasazeným držákem / 368650

Obsah: Jehla 21G 1¼ palců, 0,8 mm x 32 mm, kazeta á 100 ks

Jehla na odběr krve BD Vacutainer Eclipse Signal / 368835 CE

Obsah: Jehla 21G 1¼ palců, 0,8 mm x 32 mm, krabice á 50, kazeta á 400

Držák na jedno použití BD Vacutainer / 364815

Obsah: Kazeta pouze na průměr 13 mm a 16 mm 1000 / kazeta

* Tato objednáací čísla představují typické výrobky, které lze použít se zkumavkou PAXgene Blood DNA.

Jak objednávat příslušenství značky BD k odběrům krve:

Přejděte na stránky: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Vyberte zemi • Přejděte na položku BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Zavolejte na uvedené číslo

Produkty QIAGEN*

Sada QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Obsah: Kazeta s reagentií, enzymatický držák, víčko s děrováním, ATE pufru, sada těsnění na opakované použití

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Obsah: Rotační sloupky QIAamp Mini, zkumavky na odběr, pufr AL, pufr ATL, pufr AW1, pufr AW2, pufr AE, proteáza QIAGEN, rozpouštědlo proteázy

Sada QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Obsah: Lyzační roztok RBC, buněčný lyzační roztok, roztok na srážení proteinů, hydratační roztok DNA, roztok A RNázy

* Tato objednáací čísla představují typické sady na přípravu DNA, které lze použít se zkumavkou PAXgene Blood DNA.

Objednávání sad pro přípravu QIAGEN DNA:

Přejděte na stránky: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

Zkumavky PAXgene Blood DNA vyrábí ve Velké Británii společnost BD pro PreAnalytiX GmbH. PAXgene a PreAnalytiX jsou ochranné známky společnosti PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene jsou ochranné známky společnosti QIAGEN NV; Styrofoam je ochranná známka společnosti The Dow Chemical Company. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem společnosti Becton, Dickinson and Company.

(Pokračování)

BD – Středisko služeb zákazníkům

Argentina, Uruguay a Paraguay

Objednávky: 011.4551.7100
E-mail: crc_argentina@bd.com

Austrálie

Objednávky: 1.800.656. 100
Fax: 1.800.656.110
E-mail: bd_anz@bd.com

Rakousko

Objednávky: 43.1.7063660
Fax: 43.1.7063660-11

Belgie

Objednávky: 32.53.720.556
Fax: 32.53.720.549

Brazílie

Objednávky: 0800.055.5654
E-mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Objednávky: 800.268.5430
Fax: 800.565.0897
E-mail: custsvccan@bd.com

Dánsko

Objednávky: 45.43.43.45.66
Fax: 45.43.96.56.76
E-mail: bdcs_dk@europe.bd.com

Východní Evropa

Objednávky: 48.22.651.75.88
Fax: 48.22.651.75.89

Finsko

Objednávky: 358.9.88.70.780
Fax: 358.9.88.70.7816
E-mail: bdorder_finland@europe.bd.com

Francie

Objednávky: 33.476.689496
Fax: 33.476.683693
E-mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Německo

Objednávky: 49.6221305553
Fax: 49.6221305379

Itálie

Objednávky: 39.02.48.240.500
Fax: 39.02.48.240.344
Tech. dotazy: 39.02.48.240.264
E-mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Střední východ a Afrika (EMA)

Objednávky: 971.4.3379525
Fax: 971.4.03379551
E-mail: EMA_PAS@bd.com

Nizozemsko

Objednávky: 31.20.6545.716
Fax: 31.20.5829.421
E-mail: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Nový Zéland

Objednávky: 0800.572.468
Fax: 0800.572.469
E-mail: bd_anz@bd.com

Norsko:

Objednávky: 47.73.59.12.00
Fax: 47.73.59.12.01

Španělsko

Objednávky: 34.902.27.17.27
Fax: 34.91.848.81.04
E-mail: servicio_de_clientes@bd.com

Švédsko

Objednávky: 46.8.775.51.60
Fax 46: 8.775.51.95
E-mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Švýcarsko

Objednávky: 41.61.4852222
Objednávky: 41.61.4852200

Velká Británie

Objednávky: 44.1.865.781.666
Fax: 44.1.865.717.313
E-mail: bduk_customerservice@europe.bd.com

USA

Objednávky: 888.237.2762
Fax: 800.847.2220
Tech. dotazy: 800.631.0174
E-mail: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Středisko služeb zákazníkům

Austrálie

Objednávky: 03.9840.9800
Fax: 03.9840.9888
Tech. dotazy: 1.800.243.066

Rakousko

Objednávky: 0800/28.10.10
Fax: 0800/28.10.19
Tech. dotazy: 0800/28.10.11

Belgie

Objednávky: 0800.79612
Fax: 0800.79611
Tech. dotazy: 0800.79556

Kanada

Objednávky: 800.572.9613
Fax: 800.713.5951
Tech. dotazy: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Čína

Objednávky: 0086.21.3865.3865
Fax: 0086.21.3865.3965
Tech. dotazy: 800.988.0325 / 800.988.0327

Dánsko

Objednávky: 80.885945
Fax: 80.885944
Tech. dotazy: 80.885942

Finsko

Objednávky: 0800.914416
Fax: 0800.914415
Tech. dotazy: 0800.914413

Francie

Objednávky: 01.60.920.926
Fax: 01.60.920.925
Tech. dotazy: 01.60.920.930
Nabídky: 01.60.920.928

Německo

Objednávky: 02103.29.12000
Fax: 02103.29.22000
Tech. dotazy: 02103.29.12400

Hongkong

Objednávky: 800.933.965
Fax: 800.930.439
Tech. dotazy: 800.930.425

Irsko

Objednávky: 1800.555.049
Fax: 1800.555.048
Tech. dotazy: 1800.555.061

Itálie

Objednávky: 02.33430411
Fax: 02.33430426
Tech. dotazy: 800.787980

Japonsko

Telefon: 03.5547.0811
Fax: 03.5547.0818
Tech. dotazy: 03.5547.0811

Korea (Jižní)

Objednávky: 1544.7145
Fax: 1544.7146
Tech. dotazy: 1544.7145

Lucembursko

Objednávky: 8002.2076
Fax: 8002.2073
Tech. dotazy: 8002.2067

Nizozemsko

Objednávky: 0800.0229592
Fax: 0800.0229593
Tech. dotazy: 0800.0229602

Norsko

Objednávky: 800.18859
Fax: 800.18817
Tech. dotazy: 800.18712

Singapur

Objednávky: 65.67775366
Fax: 65.67785177
Tech. dotazy: 65.67775366

Španělsko

Objednávky: 91.630.7050
Fax: 91.630.5145
Tech. dotazy: 91.630.7050

Švédsko

Objednávky: 020.790282
Fax: 020.790582
Tech. dotazy: 020.798328

Švýcarsko

Objednávky: 055.254.22.11
Fax: 055.254.22.13
Tech. dotazy: 055.254.22.12

Velká Británie

Objednávky: 01293.422.911
Fax: 01293.422.922
Tech. dotazy: 01293.422.999

USA

Objednávky: 800.426.8157
Fax: 800.718.2056
Tech. dotazy: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

DNA - blodprøveglass

DA – Dansk

I. Tilsigtet brug

PAXgene DNA-blodprøveglass er beregnet til opsamling, antikoagulation, stabilisering, transport og opbevaring af en venefuldblodsprøve til forberedelse af DNA i høj kvalitet til brug ved molekulærdiagnostiske testmetoder, som kræver DNA.

Udstyrets ydelseskarakteristika er endnu ikke blevet defineret for molekulærdiagnostiske analyser som helhed. Brugere skal derfor validere brugen af produktet til deres specifikke molekulærdiagnostiske analyser.

Produktegenskaber

PAXgene DNA-blodprøveglass • 2,5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA-tilsætningsstof
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 glas/karton • 1.000 glas/kasse

II. Resumé og forklaring

PAXgene DNA-blodprøveglass giver mulighed for opsamling af fuldblod til isolering af genomt DNA i et lukket, evakueret system. Blodet opsamles via en almindelig flebotomiprocedure ind i et evakueret glas, der indeholder K₂EDTA-tilsætningsstof. En komplet DNA-isolering foretages ved hjælp af manuelle eller automatiske metoder som f.eks. bundfældning med salt, anvendelse af magnetiske beads eller silica-membran-baserede teknologier.

III. Advarsler

Glassets indhold irriterer huden.


- Hvis indholdet inhaleres, skal personen ud i den friske luft.
- I tilfælde af hudkontakt skal huden straks vaskes af med rigeligt med vand og sæbe i mindst 15 minutter.
- I tilfælde af øjenkontakt skal øjet straks skylles med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter.
- Hvis indholdet sluges, skal personen straks drikke rigelige mængder vand. Søg læge.

IV. Præparatopsamling og analyseklargøring

A. Påkrævede hjælpemidler til blodopsamling (leveres ikke sammen med PAXgene DNA-blodprøveglass)

1. Blodtapningsnål, f.eks. BD Vacutainer® Eclipse™ blodtapningsnål eller BD Vacutainer Eclipse Signal™ blodtapningsnål. Se "Bestillingsinformation".
2. En BD Vacutainer nåleholder skal anvendes for at sikre en korrekt funktion. Se "Bestillingsinformation".
3. Mærkater til positiv donoridentifikation af prøver, hvis det er påkrævet
4. Alkoholvædet serviet til at rense stedet
5. Tør, steril gaze
6. Årepresse
7. Beholder til bortskaffelse af brugt nål eller nål/holder-kombination

B. Procedure til præparatopsamling



(fortsat)

Generelle anvisninger

BÆR HANDSKER UNDER VENEPUNKTUR, SAMT NÅR BLODTAPNINGSPRØVEGLASSENE HÅNDBETTERES, FOR AT MINDSKE EKSPONERINGSFARE.

1. Fastgør nålen i holderen. Sørg for, at nålen sidder fast, for at sikre, at den ikke frigøres under brug.
2. Sæt prøveglasset i holderen. Bemærk: Proppen må ikke punkteres.
3. Vælg venepunkturstedet.
4. **Anlæg årepresse. Klargør venepunkturstedet med et passende antiseptisk middel. PALPÉR IKKE VENEPUNKTUROMRÅDET EFTER RENSNING.**
5. Placér patientens arm i en nedadgående retning.
6. Fjern nålehætten. Udfør venepunktur MED ARMEN NEDAD OG PRØVEGLASPROPPEN ØVERST.
7. Centrér prøveglassene i holderen, når proppen perforeres, for at undgå perforering af sidevæggen og resulterende vakuumtab. Skub prøveglasset på nålen, så proppens membran punkteres.
8. **FJERN ÅREPRESSEN, SÅ SNART BLODET KOMMER TIL SYNE I PRØVEGLASSET. TILLAD IKKE, AT PRØVEGLASSETS INDHOLD KOMMER I KONTAKT MED PROPPEN ELLER NÅLEENDEN UNDER PROCEDUREN.**

Bemærk: Blod kan lejlighedsvist lække fra nålemanchetten. Overhold universelle forholdsregler for at mindske eksponeringsfare. Hvis der ikke løber blod ind i prøveglasset, eller hvis blodet holder op med at løbe, for en passende prøve er tappet, anbefales de følgende trin for udførelse af tilstrækkelig tapning:

- a. Skub prøveglasset fremad, indtil prøveglasproppen er perforeret. Hold det om nødvendigt på plads for at sikre fuldstændig vakuumtapning.
 - b. Bekræft korrekt placering af nålen i venen.
 9. Når prøveglasset er fyldt til dets angivne volumen, og blodstrømmen stopper, fjernes det fra holderen.
 10. Vend glasset 8 gange.
 11. Fjern nålen fra venen og tryk på punkturstedet med en tør, steril serviet, indtil blodstrømmen stopper.
 12. Når blodet er koaguleret, sættes plaster på, hvis det ønskes.
 13. Efter venepunktur kan toppen af proppen indeholde blodrester. Tag korrekte forholdsregler, når prøveglassene håndteres, for at undgå kontakt med dette blod.
 14. Bortskaf nål og holder i henhold til hospitalets politik og retningslinjer.
 15. Opbevar det fyldte PAXgene DNA-blodprøveglas ved stuetemperatur (18-25 °C). Se "Ydelseskaraktistika" for DNA-stabilitet i blodprøver ved stuetemperatur (18-25 °C), 2-8 °C eller -20 °C.
- Se "Procedure til frysning og optøning af præparater opsamlet i PAXgene DNA-blodprøveglas" for yderligere oplysninger, hvis en opbevaringstemperatur på -70 °C / -80 °C ønskes.

Følgende teknikker skal anvendes for at forhindre muligt tilbageløb:

- a. Placér donorens arm i en nedadgående retning.
6. Hold prøveglasset med proppen øverst.
- c. Løsn årepresen, så snart blod begynder at løbe ind i prøveglasset.
- d. Sørg for, at prøveglassets tilsætningsstoffer ikke berører proppen eller enden af nålen under venepunktur.

C. Procedure til frysning og optøning af præparater opsamlet i PAXgene DNA-blodprøveglas

1. Stil PAXgene DNA-blodprøveglasset lodret i et trådstativ. **Frys ikke prøveglas lodret i Styrofoam™-bakker, da det kan forårsage, at prøveglassene revner.**
2. PAXgene DNA-blodprøveglas kan opbevares ved temperaturer på -20 °C og lavere. Hvis prøveglassene skal opbevares ved temperaturer under -20 °C, skal de først fryses ved -20 °C i 24 timer, hvorefter temperaturen ændres til -70 °C eller -80 °C.
3. Optø PAXgene DNA-blodprøveglas i et trådstativ ved stuetemperatur (18-25 °C) i ca. to timer. **PAXgene DNA-blodprøveglas må ikke optøes ved temperaturer over 25° C.**
4. Vend det optøede PAXgene DNA-blodprøveglas forsigtigt 10 gange.

(fortsat)

Bemærk: Frosne PAXgene DNA-blodprøveglas kan gå itu, hvis de udsættes for stød. For at reducere risikoen for beskadigelse under forsendelse skal frosne prøveglas behandles på samme måde som prøveglas af glas. Brugere skal validere deres egne frysnings- og forsendelsesprocedurer for PAXgene DNA-blodprøveglas.

D. Procedure for præparatklargøring forud for analyse


Blodprøver skal bearbejdes i henhold til de instrukser, der leveres sammen med klargøringssettet til DNA-prøver. Se eksempler under "Bestillingsinformation".

V. Ydelseskarakteristika

Når blodet er løbet ned i prøveglasset, er DNA'en stabil i 14 dage ved 18 °C til 25 °C (fig. 1). Baseret på DNA-stabilitetsundersøgelser kan blod opbevares i prøveglasset i 14 dage ved 18 °C til 25 °C, 28 dage ved 2 °C til 8 °C, 3 dage ved 35 °C eller mindst 6 måneder ved -20 °C med DNA-koncentration $\geq 12,5$ ng/ μ l og en DNA-renhed (A_{260}/A_{280}) på 1,7-1,9.

Der er yderligere data om stabiliteten hos frosne præparater her: www.PreAnalytiX.com.

DNA-stabilitet i blodprøver ved 18-25 °C

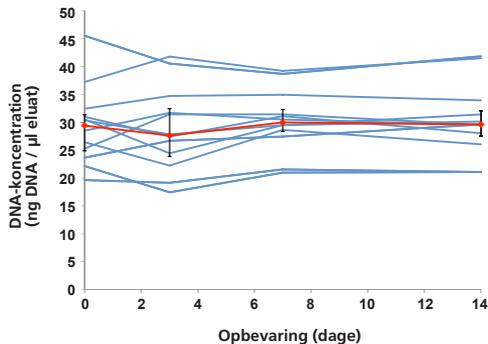

Figur 1

Der blev tappet blod fra 12 samtykkende, voksne donorer, og blodet blev opbevaret ved 18-25 °C i det viste antal dage, efterfulgt af en komplet DNA-oprensning. Der blev opsamlet blod, som blev opbevaret i PAXgene DNA-blodprøveglas, og det komplette DNA blev oprenset ved hjælp af QIAGEN® QIASymphony® DSP DNA-minisæt på det automatiske instrument QIAGEN QIASymphony.

VI. Begrænsninger

1. Der bør derfor opsamles en blodmængde på 2,5 ml pr. PAXgene DNA-blodprøveglas, hvorved denne mængde dog kan variere i forhold til højde, omgivende temperatur, barometertryk, prøveglasalder, venetryk og påfyldningsteknik.

VII. Forholdsregler


1. Overhold universelle forholdsregler. Brug handsker, operationskitler, øjenbeskyttelse, andet personligt beskyttelsesudstyr og tekniske kontroller for at beskytte mod blodstænk, blodlækage og mulig eksponering for blodbårne patogener.

- Alle biologiske prøver og blodtapningsæt skal håndteres i overensstemmelse med hospitalets regler og procedurer. Søg relevant lægehjælp i tilfælde af eventuel eksponering for biologiske prøver (for eksempel gennem en stikskade), da prøverne kan overføre viral hepatitis, HIV (AIDS) eller andre smitsomme sygdomme. Benyt den indbyggede nålehætte, hvis en sådan forefindes i blodtapningssettet. PreAnalytIX anbefaler ikke placering af hætter på brugte kanyler. Hospitalets regler og procedurer kan dog afvige fra dette og skal altid overholdes.
- Bortskaf alle blodopsamlingsglas i beholdere til biologisk farligt affald, som er godkendt til bortskaffelse af disse.
- Undlad at genbruge PAXgene DNA-blodprøveglassene.
- Anvend ikke PAXgene DNA-blodprøveglas efter udløbsdatoen, som er trykt på glassets mærkat.
- Overdreven centrifugeringshastighed (over 10.000 RCF) kan medføre brud på PAXgene DNA-blodprøveglasset, eksponering for blod samt mulig personskaade.
- Overfør ikke en prøve fra en kanyle til et prøveglas.

VIII. Opbevaring

- Opbevar ubrugte PAXgene DNA-blodprøveglas ved 18-25 °C. Begrænsede rejsetemperaturer op til 40 °C er acceptable. Prøveglassene må ikke anvendes efter udløbsdatoen.


IX. Vejledning til fjernelse af BD Hemogard-forsegling



- Tag fat om PAXgene DNA-blodprøveglasset med den ene hånd og placér tommelfingeren under BD Hemogard-forseglingen. (placér armen på en solid overflade for at få ekstra stabilitet). Med den anden hånd vrides BD Hemogard-forseglingen, mens der samtidig skubbes op med tommelfingeren på den anden hånd, KUN INDTIL PRØVEGLASPROPPEN ER LØSNET.

- Fjern tommelfingeren, før forseglingen løftes. BRUG IKKE tommelfingeren til at skubbe forseglingen af prøveglasset. Hvis prøveglasset indeholder blod, er der risiko for eksponering. For at forebygge skader under fjernelse af forseglingen er det vigtigt, at tommelfingeren, der anvendes til at skubbe opad på forseglingen, fjernes fra prøveglasset, så snart BD Hemogard-forseglingen er løsnet.
- Løft forseglingen af prøveglasset. I det usandsynlige tilfælde at plastbeskyttelsen skiller sig fra gummiproppen, MÅ FORSEGLINGEN IKKE SAMLES IGEN. Fjern forsigtigt gummiproppen fra prøveglasset.

X. Vejledning til genindsættelse af BD Hemogard-forseglingen



- Sæt forseglingen på prøveglasset igen.
- Vrid og skub fast ned, indtil proppen er fuldstændigt sat i igen. Fuldstændig isætning af proppen igen er nødvendig, således at forseglingen sidder sikkert på prøveglasset under håndtering.

Teknisk assistance

Hvis du har spørgsmål angående PAXgene DNA-blodprøveglasset, kan du kontakte en af vores BD Teknisk Assistance-afdelinger, som er opført under BD-kundeservice.

Bestillingsinformation

PAXgene-produkter

PAXgene DNA-blodprøveglas / 761165

Indhold: 1.000 blodtapningsprøveglas.

BD-produkter*

BD Vacutainer Eclipse blodtapningsnål / 368609 CE

Indhold: 21G 1¼" nål, 0,8 mm x 32 mm, 48/boks, 480/kasse

BD Vacutainer Eclipse blodtapningsnål med påsat holder / 368650

Indhold: 21G 1¼" nål, 0,8 mm x 32 mm, 100/kasse

BD Vacutainer Eclipse Signal blodtapningsnål / 368835 CE

Indhold: 21G 1¼" nål, 0,8 mm x 32 mm, 50/boks, 400/kasse

BD Vacutainer engangsholder / 364815

Indhold: Kasse kun til 13 mm og 16 mm diameter, 1.000/kasse

* Disse katalognumre repræsenterer typiske produkter, der kan anvendes sammen med PAXgene DNA-blodprøveglas.

Bestilling af BD hjælpemidler til blodopsamling:

Klik på: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Vælg land • Rul ned til BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Ring nummeret op

QIAGEN-produkter*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Indhold: Reagensmagasin, enzymstativ, stikkelåg, ATE-buffer, sæt til forseglingsgenbrug

QIAGEN QIAamp® DSP DNA-blods minikit / 61104 (50)

Indhold: QIAamp Mini udskillelseskolonne, opsamlingsglas, AL-buffer, ATL-buffer, AW1-buffer, AW2-buffer, AE-buffer, QIAGEN-protease, proteasesolvans

QIAGEN Gentra® Puregene® blodprøvesæt / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1.000 ml)

Indhold: RBC-lyseringsopløsning, cellelyseringsopløsning, proteinudfældningsopløsning, DNA-hydreringsopløsning, RNase A-opløsning

* Disse katalognumre repræsenterer typiske DNA-klargøringsæt, der kan anvendes sammen med PAXgene DNA-blodprøveglas.

Bestilling af QIAGEN DNA-klargøringsæt:

Klik på: <http://www.qiagen.com/contact/qiagenworldwide.aspx>

BD-kundeservice

Argentina, Uruguay og Paraguay

Bestillinger: 011.4551.7100
E-mail: crc_argentina@bd.com

Australien

Bestillinger: 1.800.656. 100
Fax: 1.800.656.110
E-mail: bd_anz@bd.com

Østrig

Bestillinger: 43.1.7063660
Fax: 43.1.7063660-11

Belgien

Bestillinger: 32.53.720.556
Fax: 32.53.720.549

Brasilien

Bestillinger: 0800.055.5654
E-mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Canada

Bestillinger: 800.268.5430
Fax: 800.565.0897
E-mail: custsvccan@bd.com

Danmark

Bestillinger: 4343 4566
Fax: 4396 5676
E-mail: bdcs_dk@europe.bd.com

Østeuropa

Bestillinger: 48.22.651.75.88
Fax: 48.22.651.75.89

Finland

Bestillinger: 358.9.88.70.780
Fax: 358.9.88.70.7816
E-mail: bdorder_finland@europe.bd.com

Frankrig

Bestillinger: 33.476.689496
Fax: 33.476.683693
E-mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Tyskland

Bestillinger: 49.6221305553
Fax: 49.6221305379

Italien

Bestillinger: 39.02.48.240.500
Fax: 39.02.48.240.344
Teknisk assistance: 39.02.48.240.264
E-mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Mellemøsten & Afrika (EMA)

Bestillinger: 971.4.3379525
Fax: 971.4.03379551
E-mail: EMA_PAS@bd.com

Holland

Bestillinger: 31.20.6545.716
Fax: 31.20.5829.421
E-mail: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

New Zealand

Bestillinger: 0800.572.468
Fax: 0800.572.469
E-mail: bd_anz@bd.com

Norge

Bestillinger: 47.73.59.12.00
Fax: 47.73.59.12.01

Spanien

Bestillinger: 34.902.27.17.27
Fax: 34.91.848.81.04
E-mail: servicio_de_clientes@bd.com

Sverige

Bestillinger: 46.8.775.51.60
Fax 46: 8.775.51.95
E-mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Schweiz

Bestillinger: 41.61.4852222
Bestillinger: 41.61.4852200

UK

Bestillinger: 44.1.865.781.666
Fax: 44.1.865.717.313
E-mail: bduk_customerservice@europe.bd.com

USA

Bestillinger: 888.237.2762
Fax: 800.847.2220
Teknisk assistance: 800.631.0174
E-mail: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN-kundeservice

Australien

Bestillinger: 03.9840.9800
Fax: 03.9840.9888
Teknisk assistance: 1.800.243.066

Østrig

Bestillinger: 0800/28.10.10
Fax: 0800/28.10.19
Teknisk assistance: 0800/28.10.11

Belgien

Bestillinger: 0800.79612
Fax: 0800.79611
Teknisk assistance: 0800.79556

Canada

Bestillinger: 800.572.9613
Fax: 800.713.5951
Teknisk assistance: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Kina

Bestillinger: 0086.21.3865.3865
Fax: 0086.21.3865.3965
Teknisk assistance: 800.988.0325 / 800.988.0327

Danmark

Bestillinger: 8088 5945
Fax: 8088 5944
Teknisk assistance: 8088 5942

Finland

Bestillinger: 0800.914416
Fax: 0800.914415
Teknisk assistance: 0800.914413

Frankrig

Bestillinger: 01.60.920.926
Fax: 01.60.920.925
Teknisk assistance: 01.60.920.930
Tilbud: 01.60.920.928

Tyskland

Bestillinger: 02103.29.12000
Fax: 02103.29.22000
Teknisk assistance: 02103.29.12400

Hong Kong

Bestillinger: 800.933.965
Fax: 800.930.439
Teknisk assistance: 800.930.425

Irland

Bestillinger: 1800.555.049
Fax: 1800.555.048
Teknisk assistance: 1800.555.061

Italien

Bestillinger: 02.33430411
Fax: 02.33430426
Teknisk assistance: 800.787980

Japan

Telefon: 03.5547.0811
Fax: 03.5547.0818
Teknisk assistance: 03.5547.0811

Sydkorea

Bestillinger: 1544.7145
Fax: 1544.7146
Teknisk assistance: 1544.7145

Luxembourg

Bestillinger: 8002.2076
Fax: 8002.2073
Teknisk assistance: 8002.2067

Holland

Bestillinger: 0800.0229592
Fax: 0800.0229593
Teknisk assistance: 0800.0229602

Norge

Bestillinger: 800.18859
Fax: 800.18817
Teknisk assistance: 800.18712

Singapore

Bestillinger: 65.67775366
Fax: 65.67785177
Teknisk assistance: 65.67775366

Spanien

Bestillinger: 91.630.7050
Fax: 91.630.5145
Teknisk assistance: 91.630.7050

Sverige

Bestillinger: 020.790282
Fax: 020.790582
Teknisk assistance: 020.798328

Schweiz

Bestillinger: 055.254.22.11
Fax: 055.254.22.13
Teknisk assistance: 055.254.22.12

UK

Bestillinger: 01293.422.911
Fax: 01293.422.922
Teknisk assistance: 01293.422.999

USA

Bestillinger: 800.426.8157
Fax: 800.718.2056
Teknisk assistance: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Blood DNA-Röhrchen

DE – Deutsch

I. Verwendungszweck

Das PAXgene Blood DNA-Röhrchen dient zur Entnahme, Gerinnungshemmung, Stabilisierung, zum Transport und zur Aufbewahrung von Venenblutproben zur Präparation qualitativ hochwertiger DNA für die Verwendung mit molekular diagnostischen Testmethoden, für die DNA benötigt wird.

Die Leistungsmerkmale dieses Produkts wurden nicht für molekular diagnostische Tests im Allgemeinen bestätigt. Die Anwender müssen das Produkt für ihren jeweiligen molekular diagnostischen Test validieren.

Produkteigenschaften

PAXgene Blood DNA-Röhrchen • 2,5 mL • 13 x 75 mm • K₂EDTA-Zusatzstoff
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 Röhrchen/Aufbewahrungskarton • 1.000 Röhrchen/Karton

II. Zusammenfassung und Erklärung

Das PAXgene Blood DNA-Röhrchen ermöglicht die Entnahme von Vollblut zur Isolierung von genomischer DNA in einem geschlossenen Vakuumsystem. Das Blut wird unter Beachtung des standardmäßigen Protokolls zur Blutentnahme in einem Vakuum-Röhrchen mit K₂EDTA-Zusatzstoff gesammelt. Die vollständige Isolierung der DNA geschieht mit manuellen oder automatischen Methoden, wie Aussalzungs fällung, magnetischen Partikeln oder auf Siliziumdioxidmembranen basierenden Technologien.

III. Warnhinweise

Der Inhalt des Röhrchens ist hautreizend.


- Nach Inhalation die betroffene Person an die frische Luft bringen.
- Nach Kontakt mit der Haut diese sofort mit ausreichend Seife und Wasser mindestens 15 Minuten lang waschen.
- Nach Augenkontakt sofort für mindestens 15 Minuten mit ausreichend Wasser spülen.
- Bei Verschlucken sofort große Mengen Wasser zu trinken geben. Einen Arzt aufsuchen.

IV. Entnahme und Vorbereitung der Proben zur Analyse

A. Benötigtes Blutentnahmezubehör (Nicht mit dem PAXgene Blood DNA-Röhrchen mitgeliefert)

1. Blutentnahmekanüle wie z. B. die BD Vacutainer® Eclipse™ Blutentnahmekanüle oder die BD Vacutainer Eclipse Signal™ Blutentnahmekanüle. Siehe Bestellinformation.
2. Volle Funktionsfähigkeit kann nur mit dem BD Vacutainer Kanülenhalter gewährleistet werden. Siehe Bestellinformation.
3. Etiketten zur eindeutigen Kennzeichnung der Proben falls erforderlich
4. Alkoholtupfer zur Reinigung der Einstichstelle
5. Trockene, sterile Tupfer
6. Stauschlauch
7. Behälter zur Entsorgung gebrauchter Kanülen oder Kanülen/Halter-Kombinationen

B. Methode zur Probenentnahme



Allgemeine Anweisungen

WEGEN DES EXPOSITIONSRISIKOS SIND WÄHREND DER VENENPUNKTION UND BEIM UMGANG MIT BLUTENTNAHMERÖHRCHEN HANDSCHUHE ZU TRAGEN.

1. Kanüle im Halter montieren. Die Kanüle muss fest sitzen, damit sie sich während der Verwendung nicht lösen kann.
2. Röhrchen in den Halter setzen. Hinweis: Stopfen nicht durchstechen.
3. Stelle für die Venenpunktion auswählen.
4. **Stauschlauch anbringen. Die Venenpunktionsstelle mit einem geeigneten Antiseptikum behandeln. DEN VENENPUNKTIONSBEREICH NACH DER REINIGUNG NICHT BERÜHREN.**
5. Den Arm des Patienten nach unten richten.
6. Kanülenschutz abnehmen. Venenpunktion MIT DEM ARM NACH UNTEN UND DEM RÖHRCHENSTOPFEN NACH OBEN vornehmen.
7. Die Röhrchen im Halter zentrieren, wenn der Stopfen durchstochen wird, damit die Seitenwände nicht beschädigt werden, wodurch es zu vorzeitigem Vakuumverlust käme. Röhrchen auf die Kanüle schieben und dabei die Stopfenmembrane durchstechen.
8. **STAU SCHLAUCH ENTFERNEN, SOBALD BLUT IM RÖHRCHEN ERSCHEINT. DER INHALT DES RÖHRCHENS DARF WÄHRENDEDESSEN KEINEN KONTAKT MIT DEM STOPFEN ODER DEM KANÜLELENDE HABEN.**

Hinweis: Gelegentlich tritt Blut aus der Kanülenhülle aus. Allgemeingültige Vorsichtsmaßnahmen befolgen, um das Expositionsrisiko gering zu halten. Wenn kein Blut in das Röhrchen strömt, oder wenn der Blutfluss stoppt, bevor eine ausreichende Probenmenge entnommen wurde, wie folgt vorgehen, um die Blutentnahme erfolgreich abzuschließen:

- a. Das Röhrchen vorwärts schieben, bis der Stopfen durchstochen ist. Ggf. festhalten, um eine vollständige Vakuumentnahme sicherzustellen.
- b. Die richtige Position der Kanülenhülle in der Vene überprüfen.
9. Wenn das erste Röhrchen bis zum angegebenen Volumen gefüllt ist und der Blutfluss stoppt, Röhrchen vom Halter nehmen.
10. 8 mal invertieren.
11. Die Kanüle aus der Vene ziehen. Dabei mit einem trockenen, sterilen Tupfer Druck auf die Punktionsstelle ausüben, bis der Blutfluss stoppt.
12. Sobald die Blutgerinnung erfolgt ist, kann bei Bedarf eine Bandage angelegt werden.
13. Nach der Venenpunktion kann das Oberteil des Stopfens Restblut enthalten. Beim Umgang mit Röhrchen Vorsicht walten lassen, um den Kontakt mit diesem Blut zu vermeiden.
14. Die Kanüle und der Halter sind gemäß den in Ihrer Einrichtung geltenden Richtlinien zu entsorgen.
15. Das gefüllte PAXgene Blood DNA-Röhrchen bei Raumtemperatur (18-25 °C) lagern. Siehe Leistungsmerkmale für DNA-Stabilität in Blutproben bei Raumtemperatur (18-25 °C), 2-8 °C, oder -20 °C.

Einzelheiten zur Lagerung bei Temperaturen von -70 °C / -80 °C siehe Vorgehensweisen für das Einfrieren und Auftauen von Proben in PAXgene Blood DNA-Röhrchen.

Bitte folgendes Verfahren zur Vermeidung eines möglichen Rückflusses anwenden:

- a. Arm des Spenders weist nach unten.
- b. Röhrchen mit dem Stopfen nach oben halten.
- c. Stauschlauch lösen, sobald Blut in das Röhrchen fließt.
- d. Sicherstellen, dass während der Venenpunktion weder Stopfen noch Kanülenspitze mit Zusatzstoffen in Berührung kommen.

C. Vorgehensweise für das Einfrieren und Auftauen von in den PAXgene Blood DNA-Röhrchen entnommenen Proben

1. Das PAXgene Blood DNA-Röhrchen aufrecht in einen Röhrchenständer aus Draht stellen. Röhrchen niemals aufrecht in einem Styropor-Ständer einfrieren, da dies zum Zerschneiden der Röhrchen führen kann.
2. Die PAXgene Blood DNA-Röhrchen können bei -20 °C und darunter gelagert werden. Sollen die Röhrchen bei Temperaturen unter -20 °C aufbewahrt werden, diese zunächst für 24 Stunden bei -20 °C einfrieren und anschließend nach -70 °C oder -80 °C überführen.
3. Die PAXgene Blood DNA-Röhrchen in einem Röhrchenständer aus Draht für ca. zwei Stunden bei Raumtemperatur (18-25 °C) auftauen lassen. **Die PAXgene Blood DNA-Röhrchen nicht bei Temperaturen über 25 °C auftauen lassen.**
4. Die aufgetauten PAXgene Blood DNA-Röhrchen 10 mal vorsichtig invertieren.

Hinweis: Die eingefrorenen PAXgene Blood DNA-Röhrchen können bei Stößen zerbrechen. Um das Risiko des Zerschneidens während des Transports zu verringern, sollten gefrorene Röhrchen ebenso vorsichtig gehandhabt werden wie Glasröhrchen. Die Anwender sollten ihr eigenes Gefrier- und Versandprotokoll für die PAXgene Blood DNA-Röhrchen validieren.

D. Vorgehensweise zur Probenvorbereitung für die Analyse

Blutproben müssen entsprechend der mit dem DNA-Probenvorbereitungs-Kit mitgelieferten Anweisung verarbeitet werden. Beispiele siehe Bestellinformationen.

V. Leistungseigenschaften

Nach der Befüllung des Röhrchens mit Blut bleibt die DNA 14 Tage lang bei 18-25 °C stabil (Abbildung 1). Gemäß DNA-Stabilitätsstudien kann das Blut 14 Tage bei 18-25 °C, 28 Tage bei 2-8 °C, 3 Tage bei 35 °C und mindestens 6 Monate bei -20 °C im Röhrchen gelagert werden, wobei die DNA-Konzentration $\geq 12,5$ ng/ μ l und die DNA-Reinheit (A_{260}/A_{280}) 1,7-1,9 beträgt.

Die neuesten Daten zur Stabilität für gefrorene Proben sind unter www.PreAnalytiX.com aufgeführt.

Stabilität der DNA in Blutproben bei 18-25°C

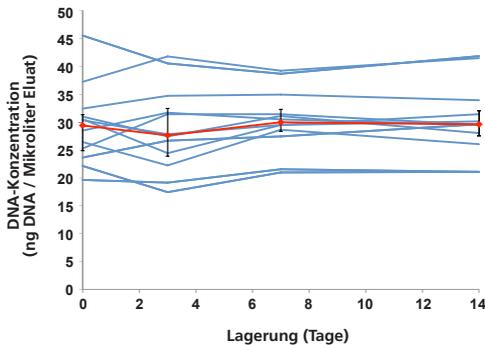


Abbildung 1

Mit ihrem Einverständnis wurde 12 erwachsenen Spendern Blut entnommen, bei 18-25 °C für die angegebene Anzahl von Tagen gelagert und die Gesamt-DNA gereinigt. Das Blut wurde in PAXgene Blood DNA-Röhrchen entnommen und gelagert, die Reinigung der DNA erfolgte mithilfe des QIAGEN® QIASymphony® DSP DNA Mini Kit und dem automatisierten Gerät QIAGEN QIASymphony.

(Fortsetzung)

VI. Einschränkungen

1. Die Menge des entnommenen Bluts sollte 2,5 mL pro PAXgene Blood DNA-Röhrchen betragen. Dieses Volumen kann allerdings je nach Höhenlage, Raumtemperatur, Luftdruck, Alter des Röhrchens, Venendruck und Fülltechnik variieren.

VII. Vorsichtsmaßnahmen

1. Es sind allgemeingültige Vorsichtsmaßnahmen anzuwenden. Handschuhe, Kittel, Augenschutz und sonstige persönliche Schutzausrüstungen sowie technische Kontrollen zum Schutz vor Blutspritzern, auslaufendem Blut und zum Schutz vor durch Blut übertragenen Pathogenen verwenden.
2. Alle biologischen Proben und Blutentnahmesets (spitze und scharfe Gegenstände) gemäß den Grundsätzen und Verfahrensweisen des jeweiligen Labors handhaben. Im Fall eines Kontakts mit biologischen Proben (z. B. Stichverletzung durch Kanüle) entsprechend ärztlichen Rat einholen, da diese Proben potenzielle Überträger von Virushepatitis, HIV (AIDS) oder anderen Infektionskrankheiten sind.


Der integrierte Kanülenschutz ist zu verwenden, sofern das Blutentnahmesystem damit ausgestattet ist. PreAnalytix rät von einem Wiederaufsetzen der Schutzkappe auf gebrauchte Kanülen ab. Die Richtlinien und Vorschriften der jeweiligen Einrichtung können jedoch davon abweichen und müssen stets eingehalten werden.

3. Alle Blutentnahmeröhrchen in die dafür vorgesehenen Behälter für infektiösen Abfall entsorgen.
4. PAXgene Blood DNA-Röhrchen nicht wieder verwenden.
5. PAXgene Blood DNA-Röhrchen nicht nach dem auf dem Röhrchen aufgedruckten Verfallsdatum verwenden.
6. Bei überhöhten Zentrifugiergeschwindigkeiten (über 10.000 RZB) kann das PAXgene Blood DNA-Röhrchen brechen, Blut freigesetzt werden und Verletzungsgefahr bestehen.
7. Proben nicht aus einer Spritze in ein Röhrchen übertragen.

VIII. Aufbewahrung

1. Unbenutzte PAXgene Blood DNA-Röhrchen bei 18-25 °C lagern. Temperaturen bis zu 40 °C sind für einen begrenzten Zeitraum erlaubt. Röhrchen nach dem Verfallsdatum nicht mehr verwenden.


IX. Anweisungen für das Entfernen des BD Hemogard-Verschlusses



1. Das PAXgene Blood DNA-Röhrchen mit einer Hand festhalten und den Daumen unter den BD Hemogard-Verschluss legen. (Um die Stabilität zu erhöhen, den Arm auf eine stabile Oberfläche legen.) Mit der anderen Hand den BD Hemogard-Verschluss drehen und gleichzeitig mit dem Daumen der anderen Hand nach oben schieben, NUR SOLANGE, BIS SICH DER RÖHRCHENVERSCHLUSS LÖST.

2. Den Daumen vor dem Anheben des Verschlusses wegziehen. Den Verschluss NICHT mit dem Daumen vom Röhrchen schieben. Wenn das Röhrchen Blut enthält, besteht Expositionsgefahr. Um Verletzungen beim Entfernen des Verschlusses zu vermeiden, ist es wichtig, dass der Daumen, der den Verschluss nach oben schiebt, keinen Kontakt mehr mit dem Röhrchen hat, sobald sich der BD Hemogard-Verschluss löst.
3. Den Verschluss vom Röhrchen abnehmen. Sollte sich die Kunststoffbeschichtung einmal vom Gummistopfen lösen, was unwahrscheinlich ist, DEN VERSCHLUSS NICHT WIEDER ZUSAMMENSETZEN. Den Gummistopfen sehr vorsichtig vom Röhrchen entfernen.

X. Anweisungen für das Wiederaufsetzen des BD Hemogard-Verschlusses



1. Den Verschluss wieder auf das Röhrchen setzen.
2. Mit einer Drehbewegung fest nach unten schieben, bis der Stopfen vollkommen einrastet. Der Stopfen muss vollständig eingeführt werden, damit der Verschluss während der Handhabung sicher auf dem Röhrchen sitzt.

(Fortsetzung)

Technischer Kundendienst

Sollten Sie Fragen zum PAXgene Blood DNA-Röhrchen haben, wenden Sie sich bitte an eine der Abteilungen für technischen Kundendienst von BD, die im Abschnitt BD – Kundendienst aufgelistet sind.

Bestellinformationen

PAXgene Produkte

PAXgene Blood DNA-Röhrchen / 761165

Inhalt: 1.000 Blutentnahmeröhrchen.

BD Produkte*

BD Vacutainer Eclipse Blutentnahmekanüle / 368609 CE

Inhalt: 21 G 1¼" Zoll Kanüle, 0,8 mm x 32 mm, 48/Packung, 480/Karton

BD Vacutainer Eclipse Blutentnahmekanüle mit vorinstalliertem Halter / 368650

Inhalt: 21 G 1¼" Zoll Kanüle, 0,8 mm x 32 mm, 100/Karton

BD Vacutainer Eclipse Signal Blutentnahmekanüle / 368835 CE

Inhalt: 21 G 1¼" Zoll Kanüle, 0,8 mm x 32 mm, 50/Packung, 400/Karton

BD Vacutainer Einweg-Halter / 364815

Inhalt: Karton nur für 13 mm und 16 mm Durchmesser 1000/Karton

* Diese Bestellnummern stehen für typische Produkte, die mit dem PAXgene Blood DNA-Röhrchen verwendet werden können.

Um BD Blutentnahme-Zubehör zu bestellen:

Besuchen Sie: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Land auswählen • Hinunterscrollen zu BD Diagnostic - Preanalytical Systems • Nummer anrufen

QIAGEN Produkte*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Inhalt: Reagenzpatrone, Enzymständer, Deckel zum Durchstechen, Puffer ATE, Versiegelungskit zur Wiederverwendung

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Inhalt: QIAamp Mini-Spinsäulen, Entnahmeröhrchen, Puffer AL, Puffer AW1, Puffer AW2, Puffer AW, QIAGEN Protease, Proteaselösungsmittel

QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit / 158422 (3 mL) / 158445 (30 mL) / 158467 (120 mL) / 158389 (1000 mL)

Inhalt: RBC-Lyse-Lösung, Zell-Lyse-Lösung, Protein-Niederschlags-Lösung, DNA-Hydrierungs-Lösung, RNase A-Lösung

* Diese Bestellnummern stehen für typische DNA-Vorbereitungs-Kits, die mit dem PAXgene Blood DNA-Röhrchen verwendet werden können.

Um QIAGEN DNA-Vorbereitungs-Kits zu bestellen:

Besuchen Sie: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

Das PAXgene Blood DNA-Röhrchen wird im Vereinigten Königreich von BD für PreAnalytiX GmbH hergestellt. PAXgene und PreAnalytiX sind Marken der PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene sind Marken der QIAGEN NV; Styrofoam ist eine Marke der The Dow Chemical Company; alle anderen Marken sind Eigentum von Becton, Dickinson and Company.

(Fortsetzung)

BD – Kundendienst

Argentinien, Uruguay und Paraguay

Bestellungen: 011.4551.7100
E-Mail: crc_argentina@bd.com

Australien

Bestellungen: 1.800.656.100
Fax: 1.800.656.110
E-Mail: bd_anz@bd.com

Österreich

Bestellungen: 43.1.7063660
Fax: 43.1.7063660-11

Belgien

Bestellungen: 32.53.720.556
Fax: 32.53.720.549

Brasilien

Bestellungen: 0800.055.5654
E-Mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Bestellungen: 800.268.5430
Fax: 800.565.0897
E-Mail: custsvccan@bd.com

Dänemark

Bestellungen: 45.43.43.45.66
Fax: 45.43.96.56.76
E-Mail: bdcg_dk@europe.bd.com

Osteuropa

Bestellungen: 48.22.651.75.88
Fax: 48.22.651.75.89

Finnland

Bestellungen: 358.9.88.70.780
Fax: 358.9.88.70.7816
E-Mail: bdorder_finland@europe.bd.com

Frankreich

Bestellungen: 33.476.689496
Fax: 33.476.683693
E-Mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Deutschland

Bestellungen: 49.6221.305553
Fax: 49.6221.305379

Italien

Bestellungen: 39.02.48.240.500
Fax: 39.02.48.240.344
Technischer Kundendienst: 39.02.48.240.264
E-Mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Naher Osten & Afrika (EMA)

Bestellungen: 971.4.3379525
Fax: 971.4.03379551
E-Mail: EMA_PAS@bd.com

Niederlande

Bestellungen: 31.20.6545,716
Fax: 31.20.5829,421
E-Mail: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Neuseeland

Bestellungen: 0800.572.468
Fax: 0800.572.469
E-Mail: bd_anz@bd.com

Norwegen:

Bestellungen: 47.73.59.12.00
Fax: 47.73.59.12.01

Spanien

Bestellungen: 34.902.27.17.27
Fax: 34.91.848.81.04
E-Mail: servicio_de_clientes@bd.com

Schweden

Bestellungen: 46.8.775.51.60
Fax: 46.8.775.51,95
E-Mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Schweiz

Bestellungen: 41.61.4852222
Bestellungen: 41.61.4852200

GB

Bestellungen: 44.1.865.781.666
Fax: 44.1.865.717.313
E-Mail: bduk_customerservice@europe.bd.com

USA

Bestellungen: 888.237.2762
Fax: 800.847.2220
Technischer Kundendienst: 800.631.0174
E-Mail: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Kundendienst

Australien

Bestellungen: 03.9840.9800
Fax: 03.9840.9888
Technischer Kundendienst: 1.800.243.066

Österreich

Bestellungen: 0800/28.10.10
Fax: 0800/28.10.19
Technischer Kundendienst: 0800/28.10.11

Belgien

Bestellungen: 0800,79612
Fax: 0800,79611
Technischer Kundendienst: 0800,79556

Kanada

Bestellungen: 800.572.9613
Fax: 800.713.5951
Technischer Kundendienst: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

China

Bestellungen: 0086.21.3865,3865
Fax: 0086.21.3865,3965
Technischer Kundendienst: 800.988.0325 / 800.988.0327

Dänemark

Bestellungen: 80,885945
Fax: 80,885944
Technischer Kundendienst: 80,885942

Finnland

Bestellungen: 0800,914416
Fax: 0800,914415
Technischer Kundendienst: 0800,914413

Frankreich

Bestellungen: 01.60.920,926
Fax: 01.60.920,925
Technischer Kundendienst: 01.60.920,930
Angebote: 01.60.920,928

Deutschland

Bestellungen: 02103.29.12000
Fax: 02103.29.22000
Technischer Kundendienst: 02103.29.12400

Hongkong

Bestellungen: 800.933.965
Fax: 800.930.439
Technischer Kundendienst: 800.930.425

Irland

Bestellungen: 1800.555.049
Fax: 1800.555.048
Technischer Kundendienst: 1800.555.061

Italien

Bestellungen: 02.33430411
Fax: 02.33430426
Technischer Kundendienst: 800.787980

Japan

Telefon: 03.5547.0811
Fax: 03.5547.0818
Technischer Kundendienst: 03.5547.0811

Korea (Süd)

Bestellungen: 1544.7145
Fax: 1544.7146
Technischer Kundendienst: 1544.7145

Luxemburg

Bestellungen: 8002.2076
Fax: 8002.2073
Technischer Kundendienst: 8002.2067

Niederlande

Bestellungen: 0800.0229592
Fax: 0800.0229593
Technischer Kundendienst: 0800.0229602

Norwegen

Bestellungen: 800.18859
Fax: 800.18817
Technischer Kundendienst: 800.18712

Singapur

Bestellungen: 65.67775366
Fax: 65.67785177
Technischer Kundendienst: 65.67775366

Spanien

Bestellungen: 91.630.7050
Fax: 91.630.5145
Technischer Kundendienst: 91.630.7050

Schweden

Bestellungen: 020.790282
Fax: 020.790582
Technischer Kundendienst: 020.798328

Schweiz

Bestellungen: 055.254.22,11
Fax: 055.254.22,13
Technischer Kundendienst: 055.254.22,12

GB

Bestellungen: 01293.422.911
Fax: 01293.422.922
Technischer Kundendienst: 01293.422.999

USA

Bestellungen: 800.426.8157
Fax: 800.718.2056
Technischer Kundendienst: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

EL - Ελληνικά

I. Χρήση για την οποία προορίζεται

Το PAXgene Blood DNA Tube προορίζεται για τη λήψη, παρεμπόδιση της πήξης, σταθεροποίηση, μεταφορά και φύλαξη δείγματος φλεβικού ολικού αίματος για προετοιμασία DNA υψηλής ποιότητας για χρήση με μοριακές μεθόδους διαγνωστικής εξέτασης που απαιτούν DNA.

Τα χαρακτηριστικά απόδοσης αυτής της συσκευής δεν έχουν επιβεβαιωθεί για μοριακές διαγνωστικές αναλύσεις γενικά. Οι χρήστες πρέπει να επικυρώνουν τη χρήση του προϊόντος για τη δική τους ειδική μοριακή διαγνωστική ανάλυση.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Σωληνάριο PAXgene Blood DNA Tube • 2,5 mL • 13 x 75 mm • Πρόσθετο K₂EDTA
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 σωληνάρια/χαρτονένιο κουτί • 1.000 σωληνάρια/κιβώτιο

II. Περίληψη και εξήγηση

Το σωληνάριο PAXgene Blood DNA Tube παρέχει ένα μέσο συλλογής ολικού αίματος για την απομόνωση γονιδιωματικού DNA σε κλειστό σύστημα κενού. Το αίμα συλλέγεται σύμφωνα με ένα τυπικό πρωτόκολλο φλεβοτομίας σε ένα σωληνάριο κενού που περιέχει πρόσθετο K₂EDTA. Η πλήρης απομόνωση του DNA πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μη αυτόματες ή αυτόματες μεθόδους, όπως καθίζηση εξάλατωσης, μαγνητικά σφαιρίδια, ή τεχνολογίες με βάση μεμβράνη πυριτίας.

III. Προειδοποιήσεις

Τα περιεχόμενα του σωληναρίου ερεθίζουν το δέρμα.


- Μετά από εισπνοή, να παρέχεται καθαρός αέρας.
- Μετά από επαφή με το δέρμα, πλύνετε άμεσα το δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 15 λεπτά.
- Μετά από επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε άμεσα με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά.
- Σε περίπτωση κατάποσης, χορηγήστε αμέσως μεγάλη ποσότητα νερού. Ζητήστε ιατρική βοήθεια.

IV. Συλλογή δείγματος και ετοιμασία για ανάλυση

A. Απαιτούμενα παρελκόμενα συλλογής αίματος (Δεν παρέχονται μαζί με το PAXgene Blood DNA Tube)

1. Βελόνα συλλογής αίματος, όπως η βελόνα BD Vacutainer® Eclipse™ Blood Collection Needle ή η βελόνα BD Vacutainer Eclipse Signal™ Blood Collection Needle. Συμβουλευτείτε τις Πληροφορίες Παραγγελιών.
2. Για να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία πρέπει να χρησιμοποιείται συγκρατητής BD Vacutainer Needle Holder. Συμβουλευτείτε τις Πληροφορίες Παραγγελιών.
3. Ετικέτες για τη σαφή ταυτοποίηση του δότη των δειγμάτων, εάν απαιτείται.
4. Μάκτρο εμποτισμένο με οινόπνευμα για τον καθαρισμό του σημείου αιμοληψίας.
5. Στεγνή αποστειρωμένη γάζα.
6. Αιμοστατικός επίδεσμος.
7. Δοχείο απόρριψης βελόνων για τις μεταχειρισμένες βελόνες ή για το συνδυασμό βελόνας/συγκρατητή.

B. Διαδικασία συλλογής δείγματος



(Συνέχεια)

Γενικές οδηγίες

ΦΟΡΑΤΕ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ.

1. Συναρμολογήστε τη βελόνα με τη βάση. Βεβαιωθείτε ότι η βελόνα εδράζεται σταθερά ώστε να διασφαλιστεί ότι η βελόνα δεν θα χαλαρώσει κατά τη χρήση.
2. Τοποθετήστε το σωληνάριο μέσα στη βάση. Σημείωση: Μην τρυπάτε το πώμα.
3. Επιλέξτε σημείο για παρακέντηση.
4. **Εφαρμόστε τον πιεστικό αιμοστατικό επίδεσμο. Ετοιμάστε το σημείο φλεβοπαρακέντησης με κατάλληλο αντισηπτικό. ΜΗΝ ΨΗΛΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΕΒΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ.**
5. Τοποθετήστε το βραχίονα του ασθενή σε κατωφερή θέση.
6. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας. Εκτελέστε τη φλεβοπαρακέντηση ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΜΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ.
7. Τοποθετήστε τα σωληνάρια στο κέντρο της βάσης κατά τη διάρκεια του πώματος για να αποφευχθεί η διάτρηση του πλευρικού τοιχώματος και η επακόλουθη πρόωμη απώλεια κενού. Ωθήστε το σωληνάριο πάνω στη βελόνα, τρυπώντας το διάφραγμα του πώματος.
8. ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟΝ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΕΣΜΟ ΜΟΛΙΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΙΜΑ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ. ΜΗΝ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΩΜΑ Ή ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.

Σημείωση: Περιστασιακά ενδέχεται να διαρρέυσει αίμα από το περίβλημα της βελόνας. Τηρείτε τις γενικές προφυλάξεις για να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος έκθεσης. Αν δεν εισρεύσει αίμα στο σωληνάριο ή αν σταματήσει να εισρέει αίμα στο σωληνάριο πριν γίνει συλλογή επαρκούς δείγματος, προτείνονται τα παρακάτω βήματα για την ολοκλήρωση ικανοποιητικής συλλογής:

- α. Ωθήστε το σωληνάριο εμπρός έως ότου το πώμα του σωληναρίου να διατρηθεί. Αν χρειαστεί, κρατήστε το στη θέση του μέχρι να βεβαιωθείτε για πλήρη αναρρόφηση κενού.
 - β. Επιβεβαιώστε τη σωστή θέση της βελόνας στη φλέβα.
9. Όταν το σωληνάριο γεμίσει μέχρι το δηλωμένο όγκο και σταματήσει η ροή αίματος, αφαιρέστε το από τη βάση.
 10. Αναστρέψτε 8 φορές.
 11. Αφαιρέστε τη βελόνα από τη φλέβα, ασκώντας πίεση στο σημείο παρακέντησης με στεγνό, στείρο ταμπόν μέχρι να σταματήσει η αιμορραγία.
 12. Μόλις εμφανιστεί πήξη, εφαρμόστε επίδεσμο αν θέλετε.
 13. Μετά τη φλεβοπαρακέντηση, το πάνω μέρος του πώματος ενδέχεται να περιέχει κατάλοιπα αίματος. Λάβετε τις δέουσες προφυλάξεις κατά το χειρισμό των σωληναρίων ώστε να αποφύγετε την επαφή με το αίμα αυτό.
 14. Απορρίψτε τη βελόνα και τη βάση σύμφωνα με την πολιτική και τις οδηγίες του οικείου ιδρύματος.
 15. Φυλάξτε το γεμάτο σωληνάριο PAXgene Blood DNA Tube σε θερμοκρασία δωματίου (18-25°C). Βλ. Χαρακτηριστικά απόδοσης για τη σταθερότητα του DNA σε δείγματα αίματος σε θερμοκρασία δωματίου (18-25°C), 2-8°C, ή -20°C.

Εάν η επιθυμητή θερμοκρασία αποθήκευσης κυμαίνεται μεταξύ -70°C / -80°C, ανατρέξτε στη Διαδικασία Ψύξης και Απόψυξης Δειγμάτων στα PAXgene Blood DNA Tubes.

Για την πρόληψη τυχόν αναστροφής ροής αίματος, προβλέπονται οι εξής τεχνικές:

- α. Τοποθετήστε το βραχίονα του δότη σε κατωφερή θέση.
- β. Κρατήστε το σωληνάριο με το πώμα προς τα πάνω.
- γ. Απελευθερώστε τον πιεστικό αιμοστατικό επίδεσμο μόλις αρχίσει να ρέει το αίμα μέσα στο σωληνάριο.
- δ. Βεβαιωθείτε ότι τα πρόσθετα του σωληναρίου δεν αγγίζουν το πώμα ή το άκρο της βελόνας κατά τη φλεβοπαρακέντηση.

Γ. Διαδικασία ψύξης και απόψυξης δειγμάτων που συλλέχθηκαν στα PAXgene Blood DNA Tubes

1. Τοποθετήστε το σωληνάριο PAXgene Blood DNA Tube σε όρθια θέση σε συρμάντιν βάση. **Μην καταψύχετε τα σωληνάρια σε όρθια θέση σε δίσκο πολυστυρενίου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη θραύση τους.**

(Συνέχεια)

2. Τα PAXgene Blood DNA Tubes μπορούν να φυλάσσονται σε θερμοκρασία -20°C ή χαμηλότερη. Αν τα σωληνάρια πρόκειται να αποθηκευτούν σε θερμοκρασίες κάτω των -20°C , θα πρέπει να καταψυχθούν αρχικά στους -20°C για 24 ώρες και στη συνέχεια στους -70°C ή -80°C .
3. Αποψύξτε τα PAXgene Blood DNA Tubes σε συμπίετη βάση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (18°C - 25°C) για περίπου δύο ώρες. **Μην αποψύχετε τα PAXgene Blood DNA Tubes σε θερμοκρασίες άνω των 25°C .**
4. Αναστρέψτε προσεκτικά 10 φορές τα PAXgene Blood DNA Tubes που έχουν υποστεί απόψυξη.

Σημείωση: Τα PAXgene Blood DNA Tubes που έχουν υποστεί ψύξη σπάζουν εύκολα σε περίπτωση κρούσης. Για να μειωθεί ο κίνδυνος θραύσης κατά τη μεταφορά, τα κατεψυγμένα σωληνάρια θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τα γυάλινα σωληνάρια. Οι χρήστες πρέπει να επικυρώσουν το δικό τους πρωτόκολλο ψύξεως και μεταφοράς για τα PAXgene Blood DNA Tubes.

Δ. Διαδικασία προετοιμασίας δειγμάτων για ανάλυση


Η επεξεργασία των δειγμάτων αίματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο κιτ προετοιμασίας δείγματος DNA. Για παραδείγματα, συμβουλευτείτε τις Πληροφορίες Παραγγελιών.

V. Χαρακτηριστικά απόδοσης

Αφού εισαχθεί αίμα στο σωληνάριο, το DNA παραμένει σταθερό για 14 ημέρες στους 18°C έως 25°C (Σχήμα 1). Με βάση μελέτες σταθερότητας DNA, το αίμα μπορεί να φυλαχθεί στο σωληνάριο για 14 ημέρες στους 18°C έως 25°C , 28 ημέρες στους 2°C έως 8°C , 3 ημέρες στους 35°C , ή για τουλάχιστον 6 μήνες στους -20°C με συγκέντρωση DNA $\geq 12,5$ ng/μl και καθαρότητα DNA (A_{260}/A_{280}) 1,7-1,9.

Για τα πιο πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τη σταθερότητα των κατεψυγμένων δειγμάτων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.PreAnalytiX.com.

Σταθερότητα του DNA σε δείγματα αίματος στους 18 - 25°C

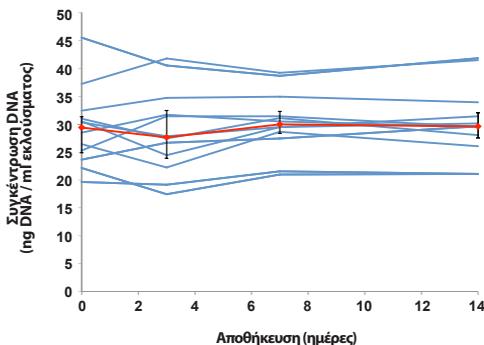

Σχήμα 1

Πραγματοποιήθηκε αιμοληψία από 12 ενήλικες δότες μετά από συναίνεσή τους και τα δείγματα αποθηκεύτηκαν στους 18°C - 25°C για τον υποδεικνυόμενο αριθμό ημερών και εν συνεχεία πραγματοποιήθηκε απομόνωση ολικού DNA. Το αίμα συλλέχθηκε και αποθηκεύτηκε στα σωληνάρια PAXgene Blood DNA Tubes, ενώ για την απομόνωση του ολικού DNA χρησιμοποιήθηκε το κιτ QIAGEN® QIAasymphony® DSP DNA Mini Kit στο αυτοματοποιημένο όργανο QIAGEN QIAasymphony.

VI. Περιορισμοί

1. Η ποσότητα του λαμβανομένου αίματος πρέπει να είναι 2,5 mL ανά PAXgene Blood DNA Tube, πλην όμως μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το υψόμετρο, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη βαρομετρική πίεση, την παλαιότητα του σωληναρίου, τη φλεβική πίεση και την τεχνική λήψης.


VII. Προφυλάξεις

1. Να τηρείτε τις γενικές προφυλάξεις. Χρησιμοποιείτε γάντια, ποδιές, γυαλιά προστασίας, λοιπό εξοπλισμό ατομικής προστασίας και μηχανικούς ελέγχους για την προστασία από πιτσιλισμα με αίμα, διαρροές αίματος και ενδεχόμενη έκθεση σε παθογόνα του αίματος.
2. Να χειρίζεστε όλα τα βιολογικά δείγματα και τα σετ συλλογής αίματος ως "αιχμηρά" αντικείμενα, σύμφωνα με τις πρακτικές και διαδικασίες του οικείου ιδρύματος. Σε κάθε περίπτωση έκθεσης σε βιολογικά δείγματα (για παράδειγμα, εάν τρυπηθείτε), αναζητήστε την κατάλληλη ιατρική βοήθεια, καθώς υπάρχει κίνδυνος προσβολής από ιογενή ηπατίτιδα, HIV (AIDS) ή άλλες μολυσματικές ασθένειες.
Χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο προστατευτικό κάλυμμα βελόνας, αν περιλαμβάνεται στο σετ συλλογής αίματος. Η PreAnalytiX δεν συνιστά την επανατοποθέτηση του προστατευτικού καλύμματος σε χρησιμοποιημένες βελόνες. Ωστόσο, οι πρακτικές και οι διαδικασίες του οικείου ιδρύματος ενδέχεται να διαφέρουν και πρέπει πάντα να τηρούνται πιστά.
3. Απορρίψτε όλα τα σωληνάρια συλλογής αίματος στα ειδικά δοχεία απόρριψης βιολογικά επικίνδυνων υλικών.
4. Μην επαναχρησιμοποιείτε τα PAXgene Blood DNA Tubes.
5. Μην χρησιμοποιείτε τα PAXgene Blood DNA Tubes μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα του σωληναρίου.
6. Η υπερβολική ταχύτητα φυγοκέντρησης (άνω των 10.000 RCF) μπορεί να προκαλέσει θραύση του PAXgene Blood DNA Tube, έκθεση στο αίμα και ενδεχόμενο τραυματισμό.
7. Μην μεταφέρετε δείγμα από σύριγγα σε σωληνάριο.

VIII. Φύλαξη


1. Αποθηκεύστε τα μη χρησιμοποιημένα PAXgene Blood DNA Tubes σε θερμοκρασία 18°C έως 25°C. Κατά τη μεταφορά, επιτρέπεται σύντομη έκθεση σε θερμοκρασίες έως 40°C. Μην χρησιμοποιείτε τα σωληνάρια μετά την ημερομηνία λήξης τους.

IX. Οδηγίες για την αφαίρεση του καπακιού BD Hemogard



1. Πιάστε το σωληνάριο PAXgene Blood DNA Tube με το ένα χέρι, τοποθετώντας τον αντίχειρα κάτω από το καπάκι BD Hemogard. (Για πρόσθετη σταθερότητα, τοποθετήστε το βραχίονα σε στερεή επιφάνεια). Με το άλλο χέρι, περιστρέψτε το καπάκι BD Hemogard ενώ ταυτόχρονα ωθείτε προς τα πάνω με τον αντίχειρα του άλλου χεριού ΜΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΧΑΛΛΑΡΩΣΕΙ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ.
2. Απομακρύνετε τον αντίχειρα πριν ανασηκώσετε το καπάκι. ΜΗ χρησιμοποιείτε τον αντίχειρα για να ωθήσετε και να βγάλετε το καπάκι από το σωληνάριο. Αν το σωληνάριο περιέχει αίμα, υφίσταται κίνδυνος έκθεσης. Για να αποφύγετε τον τραυματισμό κατά την αφαίρεση του καπακιού, είναι σημαντικό ο αντίχειρας που χρησιμοποιείται για την ώθηση προς τα πάνω του καπακιού να απομακρύνεται από το σωληνάριο μόλις χαλαρώσει το καπάκι BD Hemogard.
3. Ανασηκώστε το καπάκι και απομακρύνετέ το από το σωληνάριο. Στην απίθανη περίπτωση διαχωρισμού του πλαστικού προστατευτικού από το ελαστικό πώμα, ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ. Αφαιρέστε προσεκτικά το ελαστικό πώμα από το σωληνάριο.

Χ. Οδηγίες για την επανατοποθέτηση του καπακιού BD Hemogard



1. Επανατοποθετήστε το πώμα πάνω από το σωληνάριο.
2. Περιστρέψτε και ωθήστε προς τα κάτω σταθερά μέχρι το πώμα να εδράζεται και πάλι πλήρως. Η πλήρης επανατοποθέτηση του πώματος είναι απαραίτητη για να παραμείνει το καπάκι με ασφάλεια στο σωληνάριο κατά τη διάρκεια του χειρισμού.

Τεχνική υπηρεσία

Εάν έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το σωληνάριο PAXgene Blood DNA Tube, επικοινωνήστε με ένα από τα Τμήματα Τεχνικών Υπηρεσιών της BD που παρατίθενται στην ενότητα BD – Εξυπηρέτηση πελατών.

Πληροφορίες παραγγελίας

Προϊόντα PAXgene

PAXgene Blood DNA Tube / 761165

Περιεχόμενα: 1.000 σωληνάρια συλλογής αίματος.

Προϊόντα της BD*

BD Vacutainer Eclipse Blood Collection Needle / 368609 CE

Περιεχόμενα: Βελόνα 21G 1¼ ιντσών, 0,8 mm x 32 mm, 48/κουτί, 480/κιβώτιο

BD Vacutainer Eclipse Blood Collection Needle with Pre-Attached Holder / 368650

Περιεχόμενα: Βελόνα 21G 1¼ ιντσών, 0,8 mm x 32 mm, 100/κιβώτιο

BD Vacutainer Eclipse Signal Blood Collection Needle / 368835 CE

Περιεχόμενα: Βελόνα 21G 1¼ ιντσών, 0,8 mm x 32 mm, 50/κουτί, 400/κιβώτιο

BD Vacutainer One Use Holder / 364815

Περιεχόμενα: Συσκευασία αποκλειστικά για διάμετρο 13 mm και 16 mm, 1000/κιβώτιο

* Αυτοί οι αριθμοί καταλόγου αντιπροσωπεύουν τυπικά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το PAXgene Blood DNA Tube.

Για να παραγγείλετε Παρελκόμενα Συλλογής Αίματος της BD:

Πληκτρολογήστε: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

- Επιλέξτε χώρα • Μετακινηθείτε προς τα κάτω στην οθόνη για να εντοπίσετε το πεδίο BD Diagnostics - Preanalytical Systems
- Καλέστε τον αριθμό

Προϊόντα QIAGEN*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Περιεχόμενα: Φύσιγγα αντιδραστηρίου, βάση ενζύμων, καπάκι διάτρησης, ρυθμιστικό διάλυμα ATE, επαναχρησιμοποιούμενο σετ στεγανοποίησης

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Περιεχόμενα: Στήλες QIAamp Mini spin, σωληνάρια συλλογής, ρυθμιστικό διάλυμα AL, ρυθμιστικό διάλυμα ATL, ρυθμιστικό διάλυμα AW1, ρυθμιστικό διάλυμα AW2, ρυθμιστικό διάλυμα AE, πρωτεάση QIAGEN, διαλύτης πρωτεάσης

QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Περιεχόμενα: Διάλυμα λύσης RBC, διάλυμα κυτταρόλυσης, διάλυμα καθίζησης πρωτεϊνών, διάλυμα ενυδάτωσης DNA, διάλυμα RNase A

* Αυτοί οι αριθμοί καταλόγου αντιπροσωπεύουν τυπικά κιτ προετοιμασίας DNA που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το PAXgene Blood DNA Tube.

Για παραγγείλετε κιτ προετοιμασίας DNA της QIAGEN:

Πληκτρολογήστε: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

Το PAXgene Blood DNA Tube κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την BD για την PreAnalytiX GmbH. Τα PAXgene και PreAnalytiX είναι εμπορικά σήματα της PreAnalytiX GmbH. Τα QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene είναι εμπορικά σήματα της QIAGEN NV. Styrofoam είναι εμπορικό σήμα της The Dow Chemical Company. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της Becton, Dickinson and Company.

BD - Εξυπηρέτηση πελατών

Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη

Παραγγελίες: 011.4551.7100
E-mail: crc_argentina@bd.com

Αυστραλία

Παραγγελίες: 1.800.656.100
Φαξ: 1.800.656.110
E-mail: bd_anz@bd.com

Αυστρία

Παραγγελίες: 43.1.7063660
Φαξ: 43.1.7063660-11

Βέλγιο

Παραγγελίες: 32.53.720.556
Φαξ: 32.53.720.549

Βραζιλία

Παραγγελίες: 0800.055.5654
E-mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Καναδάς

Παραγγελίες: 800.268.5430
Φαξ: 800.565.0897
E-mail: custsvccan@bd.com

Δανία

Παραγγελίες: 45.43.43.45.66
Φαξ: 45.43.96.56.76
E-mail: bdcs_dk@europe.bd.com

Ανατολική Ευρώπη

Παραγγελίες: 48.22.651.75.88
Φαξ: 48.22.651.75.89

Φινλανδία

Παραγγελίες: 358.9.88.70.780
Φαξ: 358.9.88.70.7816
E-mail: bdorder_finland@europe.bd.com

Γαλλία

Παραγγελίες: 33.476.689496
Φαξ: 33.476.683693
E-mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Γερμανία

Παραγγελίες: 49.6221305553
Φαξ: 49.6221305379

Ιταλία

Παραγγελίες: 39.02.48.240.500
Φαξ: 39.02.48.240.344
Τεχνική υποστήριξη: 39.02.48.240.264
E-mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Μέση Ανατολή & Αφρική (EMA)

Παραγγελίες: 971.4.3379525
Φαξ: 971.4.03379551
E-mail: EMA_PAS@bd.com

Ολλανδία

Παραγγελίες: 31.20.6545.716
Φαξ: 31.20.5829.421
E-mail: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Νέα Ζηλανδία

Παραγγελίες: 0800.572.468
Φαξ: 0800.572.469
E-mail: bd_anz@bd.com

Νορβηγία:

Παραγγελίες: 47.73.59.12.00
Φαξ: 47.73.59.12.01

Ισπανία

Παραγγελίες: 34.902.27.17.27
Φαξ: 34.91.848.81.04
E-mail: servicio_de_clientes@bd.com

Σουηδία

Παραγγελίες: 46.8.775.51.60
Φαξ 46: 8.775.51.95
E-mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Ελβετία

Παραγγελίες: 41.61.4852222
Παραγγελίες: 41.61.4852200

Ηνωμένο Βασίλειο

Παραγγελίες: 44.1.865.781.666
Φαξ: 44.1.865.717.313
E-mail: bduk_customerservice@europe.bd.com

ΗΠΑ

Παραγγελίες: 888.237.2762
Φαξ: 800.847.2220
Τεχνική υποστήριξη: 800.631.0174
E-mail: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Εξυπηρέτηση πελατών

Αυστραλία

Παραγγελίες: 03.9840.9800

Φαξ: 03.9840.9888

Τεχνική υποστήριξη: 1.800.243.066

Αυστρία

Παραγγελίες: 0800/28.10.10

Φαξ: 0800/28.10.19

Τεχνική υποστήριξη: 0800/28.10.11

Βέλγιο

Παραγγελίες: 0800.79612

Φαξ: 0800.79611

Τεχνική υποστήριξη: 0800.79556

Καναδάς

Παραγγελίες: 800.572.9613

Φαξ: 800.713.5951

Τεχνική υποστήριξη: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Κίνα

Παραγγελίες: 0086.21.3865.3865

Φαξ: 0086.21.3865.3965

Τεχνική υποστήριξη: 800.988.0325 / 800.988.0327

Δανία

Παραγγελίες: 80.885945

Φαξ: 80.885944

Τεχνική υποστήριξη: 80.885942

Φινλανδία

Παραγγελίες: 0800.914416

Φαξ: 0800.914415

Τεχνική υποστήριξη: 0800.914413

Γαλλία

Παραγγελίες: 01.60.920.926

Φαξ: 01.60.920.925

Τεχνική υποστήριξη: 01.60.920.930

Προσφορές: 01.60.920.928

Γερμανία

Παραγγελίες: 02103.29.12000

Φαξ: 02103.29.22000

Τεχνική υποστήριξη: 02103.29.12400

Χονγκ Κονγκ

Παραγγελίες: 800.933.965

Φαξ: 800.930.439

Τεχνική υποστήριξη: 800.930.425

Ιρλανδία

Παραγγελίες: 1800.555.049

Φαξ: 1800.555.048

Τεχνική υποστήριξη: 1800.555.061

Ιταλία

Παραγγελίες: 02.33430411

Φαξ: 02.33430426

Τεχνική υποστήριξη: 800.787980

Ιαπωνία

Τηλέφωνο: 03.5547.0811

Φαξ: 03.5547.0818

Τεχνική υποστήριξη: 03.5547.0811

Κορέα (Νότια)

Παραγγελίες: 1544.7145

Φαξ: 1544.7146

Τεχνική υποστήριξη: 1544.7145

Λουξεμβούργο

Παραγγελίες: 8002.2076

Φαξ: 8002.2073

Τεχνική υποστήριξη: 8002.2067

Ολλανδία

Παραγγελίες: 0800.0229592

Φαξ: 0800.0229593

Τεχνική υποστήριξη: 0800.0229602

Νορβηγία

Παραγγελίες: 800.18859

Φαξ: 800.18817

Τεχνική υποστήριξη: 800.18712

Σιγκαπούρη

Παραγγελίες: 65.67775366

Φαξ: 65.67785177

Τεχνική υποστήριξη: 65.67775366

Ισπανία

Παραγγελίες: 91.630.7050

Φαξ: 91.630.5145

Τεχνική υποστήριξη: 91.630.7050

Σουηδία

Παραγγελίες: 020.790282

Φαξ: 020.790582

Τεχνική υποστήριξη: 020.798328

Ελβετία

Παραγγελίες: 055.254.22.11

Φαξ: 055.254.22.13

Τεχνική υποστήριξη: 055.254.22.12

Ηνωμένο Βασίλειο

Παραγγελίες: 01293.422.911

Φαξ: 01293.422.922

Τεχνική υποστήριξη: 01293.422.999

ΗΠΑ

Παραγγελίες: 800.426.8157

Φαξ: 800.718.2056

Τεχνική υποστήριξη: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Tubo de ADN sanguíneo

ES – Español

I. Uso previsto

El tubo de ADN sanguíneo PAXgene está diseñado para la extracción, anticoagulación, estabilización, transporte y conservación de una muestra de sangre entera venosa para la preparación de ADN de gran calidad y posterior uso en pruebas diagnósticas moleculares que requieren ADN.

Las características de rendimiento de este dispositivo no se han establecido para pruebas diagnósticas moleculares en general. Los usuarios deben validar el uso del producto para su prueba diagnóstica molecular específica.

Características del producto

Tubo de ADN sanguíneo PAXgene • 2,5 ml • 13 x 75 mm • Aditivo K₂EDTA
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 tubos/caja expositoria • 1.000 tubos/caja

II. Resumen y explicación

El tubo de ADN sanguíneo PAXgene proporciona un medio para la extracción de sangre entera con el fin de aislar el ADN genómico en un sistema cerrado de extracción al vacío. La sangre se extrae mediante un protocolo de flebotomía estándar a un tubo de extracción al vacío que contiene K₂EDTA de aditivo. El aislamiento completo del ADN se lleva a cabo con métodos manuales o automáticos, tales como precipitación salina, microesferas magnéticas o tecnologías de membranas de sílice.

III. Advertencias

El contenido de este tubo es irritante para la piel.


- Tras su inhalación, trasladar a la persona expuesta al aire fresco.
- Tras un contacto cutáneo, lavar inmediatamente la piel con agua y jabón, y enjuagar abundantemente durante al menos 15 minutos.
- Tras un contacto ocular, enjuagar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos.
- Si se traga, dar de beber inmediatamente gran cantidad de agua. Llamar inmediatamente a un médico.

IV. Toma de muestras y preparación para el análisis

A. Accesorios de extracción de sangre necesarios (No incluidos con el tubo de ADN sanguíneo PAXgene)

1. Aguja de extracción de sangre, como la aguja de extracción de sangre BD Vacutainer® Eclipse™ o la -BD Vacutainer Eclipse Signal™. Véase la información de pedidos.
2. Hay que utilizar un portaagujas BD Vacutainer para garantizar un funcionamiento adecuado. Véase la información de pedidos.
3. Etiquetas para una identificación positiva de los donantes de las muestras, si fuera necesario
4. Torunda de alcohol para limpiar la zona
5. Gasa estéril seca
6. Torniquete
7. Recipiente para desechar agujas, para la aguja o combinación aguja/soporte usados

B. Procedimiento para la obtención de muestras



(continuación)

Instrucciones generales

LLEVE PUESTOS GUANTES DURANTE LA VENOPUNCIÓN Y CUANDO MANIPULE TUBOS DE EXTRACCIÓN PARA MINIMIZAR EL PELIGRO DE EXPOSICIÓN.

1. Monte la aguja en el soporte. Asegúrese de que la aguja esté firmemente asentada para que no se suelte durante el uso.
2. Coloque el tubo en el soporte. Nota: No perforo el tapón.
3. Seleccione el lugar de la venopunción.
4. **Realice el torniquete. Prepare el lugar de la venopunción con un antiséptico adecuado. NO PALPE LA ZONA DE VENOPUNCIÓN DESPUÉS DE HABERLA LIMPIADO.**
5. Coloque el brazo del paciente en posición descendente.
6. Retire el protector de la aguja. Realice la venopunción CON EL BRAZO EN POSICIÓN DESCENDENTE Y EL TAPÓN DEL TUBO ORIENTADO HACIA ARRIBA.
7. Centre los tubos en el soporte cuando penetre el tapón para evitar la penetración por la pared lateral y la resultante pérdida prematura de vacío. Presione el tubo sobre la aguja hasta que atraviese el diafragma del tapón.
8. **RETIRE EL TORNIQUETE EN CUANTO APAREZCA SANGRE EN EL TUBO. NO PERMITA QUE EL CONTENIDO DEL TUBO ENTRE EN CONTACTO CON EL TAPÓN O EL EXTREMO DE LA AGUJA DURANTE EL PROCEDIMIENTO.**

Nota: Es posible que se produzca una fuga de sangre desde el manguito de la aguja. Siga las prácticas generales de precaución para reducir al mínimo el peligro de exposición. Si la sangre no fluye al tubo o deja de fluir antes de recoger la cantidad de muestra necesaria, se sugiere realizar los siguientes pasos para completar una extracción satisfactoria:

- a. Presione el tubo hacia delante hasta perforar el tapón. Si fuera necesario, sujételo para asegurar una extracción completa al vacío.
- b. Confirme la posición correcta de la aguja en la vena.
9. Cuando el tubo se haya llenado hasta el volumen adecuado y el flujo de sangre cese, retírelo del soporte.
10. Inviértalo 8 veces.
11. Retire la aguja de la vena, aplicando presión sobre el punto de punción con una torunda estéril seca hasta que cese la hemorragia.
12. Cuando se haya producido la coagulación, aplique un apósito si se desea.
13. Después de la venopunción, la parte superior del tapón puede contener sangre residual. Tome las precauciones necesarias a la hora de manipular los tubos para evitar el contacto con esta sangre.
14. Deseche la aguja y el soporte de acuerdo con las directrices y la política del centro.
15. Conserve el tubo de ADN sanguíneo PAXgene lleno a temperatura ambiente (18-25 °C). Vea Características de rendimiento para la estabilidad del ADN en muestras de sangre a temperatura ambiente (18-25 °C), 2-8 °C, o -20 °C.

Veáse el Procedimiento para congelar y descongelar muestras extraídas con los tubos de ADN sanguíneo PAXgene para obtener más información si se desea que la temperatura de conservación sea -70 °C / -80 °C.

Se deben emplear las técnicas siguientes para evitar posibles reflujos:

- a. Coloque el brazo del donante en posición descendente.
- b. Sujete el tubo con el tapón hacia arriba.
- c. Suelte el torniquete en cuanto la sangre comience a fluir al tubo.
- d. Asegúrese de que los aditivos no toquen el tapón o el extremo de la aguja durante la venopunción.

(continuación)

C. Procedimiento para congelar y descongelar muestras extraídas con los tubos de ADN sanguíneo PAXgene

1. Colocar el tubo de ADN sanguíneo PAXgene vertical en un portatubos de rejilla. **No congelar los tubos en posición vertical en una bandeja de espuma de poliestireno, ya que esto puede causar el agrietamiento de los tubos.**
2. Los tubos de ADN sanguíneo PAXgene pueden conservarse a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ y a temperaturas inferiores. Si los tubos se han de conservar a temperaturas inferiores a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, hay congelarlos primero a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 24 horas y después transferirlos a -70 o $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$.
3. Descongelar los tubos de ADN sanguíneo PAXgene en un portatubos de rejilla a temperatura ambiente ($18-25\text{ }^{\circ}\text{C}$) durante unas dos horas. **No descongelar los tubos de ADN sanguíneo PAXgene a temperaturas superiores a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$.**
4. Invertir con cuidado los tubos de ADN sanguíneo PAXgene descongelados 10 veces.

Nota: los tubos de ADN sanguíneo PAXgene congelados se pueden romper por impacto. Para reducir el riesgo de rotura durante el transporte, los tubos congelados se deben tratar de la misma forma que los tubos de vidrio. Los usuarios deben validar su propio protocolo de congelación y transporte para los tubos de ADN sanguíneo PAXgene.

D. Procedimiento para la preparación de muestras para su análisis

Las muestras de sangre deben procesarse según las instrucciones proporcionadas con el kit de preparación de muestras de ADN. Para ver ejemplos, véase la información de pedidos.

V. Características de comportamiento

Tras introducir la sangre en el tubo, el ADN se mantiene estable durante 14 días a una temperatura de 18 a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ (Figura 1). De acuerdo con estudios de estabilidad del ADN, la sangre se puede almacenar en el tubo 14 días a una temperatura de 18 a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, 28 días a una temperatura entre 2 y $8\text{ }^{\circ}\text{C}$, 3 días a $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ o durante un mínimo de 6 meses a una temperatura de $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ con una concentración de ADN $\geq 12,5\text{ ng}/\mu\text{l}$ y una pureza de ADN (A_{260}/A_{280}) de $1,7-1,9$. Para consultar los datos más recientes sobre la estabilidad de muestras congeladas, visite www.PreAnalytiX.com.

Estabilidad del ADN en muestras de sangre a $18-25\text{ }^{\circ}\text{C}$

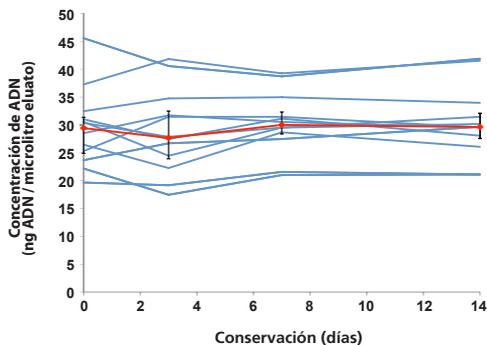


Figura 1

Se extrajo sangre de 12 donantes adultos que habían dado su consentimiento y se conservó a $18-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante el número de días indicado, seguido de una purificación del ADN total. La sangre se extrajo y conservó en tubos de ADN sanguíneo PAXgene y el ADN total se purificó mediante el minikit kit de ADN QIAGEN® QIASymphony® DSP en el equipo automático QIAGEN QIASymphony.

(continuación)

VI. Limitaciones

1. La cantidad de sangre extraída debe ser de 2,5 ml por tubo de ADN sanguíneo PAXgene, pero este volumen puede variar con la altitud, la temperatura ambiente, la presión barométrica, la edad del tubo, la presión venosa y la técnica de llenado.

VII. Precauciones

1. Siga las prácticas generales de precaución. Utilice guantes, batas, protección ocular y otros equipos de protección personal, así como controles mecánicos para protegerse de las salpicaduras, las fugas de sangre y la posible exposición a patógenos de transmisión hemática.
2. Manipule todas las muestras biológicas y los elementos punzantes de los equipos de extracción de sangre según las normas y procedimientos de su centro. Obtenga la atención médica adecuada en el caso de que quede expuesto a alguna muestra biológica (por ejemplo, tras un pinchazo), ya que pueden transmitir hepatitis vírica, infección por VIH (SIDA) u otras enfermedades infecciosas.


Utilice cualquier protector de agujas incorporado que proporcione el dispositivo para extracción de sangre. PreAnalytiX- no recomienda volver a cubrir las agujas usadas. No obstante, las normas y procedimiento de su centro pueden ser diferentes y deben seguirse siempre.

3. Deseche todos los tubos de extracción de sangre en recipientes para materiales de riesgo biológico que hayan sido aprobados para su eliminación.
4. No reutilice los tubos de ADN sanguíneo PAXgene.
5. No utilice los tubos de ADN sanguíneo PAXgene después de la fecha de caducidad impresa en la etiqueta del tubo.
6. Una velocidad de centrifugación excesiva (superior a 10.000 RCF) puede provocar la rotura del tubo de ADN sanguíneo PAXgene, con el consiguiente peligro de exposición a la sangre y posibles lesiones.
7. No transfiera la muestra desde una jeringuilla a un tubo.

VIII. Conservación


1. Conserve los tubos de ADN sanguíneo PAXgene sin utilizar a una temperatura entre 18 °C y 25 °C. Se permiten variaciones limitadas de la temperatura de hasta 40 °C. No utilice los tubos después de su fecha de caducidad.

IX. Instrucciones para retirar el cierre BD Hemogard



1. Sujete el tubo de ADN sanguíneo PAXgene con una mano y coloque el pulgar debajo del cierre BD Hemogard. (Para una mayor estabilidad, coloque el brazo sobre una superficie sólida). Con la otra mano gire el cierre BD Hemogard mientras lo empuja simultáneamente hacia arriba con el pulgar de la otra mano **SOLAMENTE HASTA QUE EL TAPÓN DEL TUBO SE SUELTE.**
2. Quite el pulgar antes de levantar el cierre. **NO** use el pulgar para empujar el cierre y sacarlo del tubo. Si el tubo contiene sangre existe el peligro de exposición a la misma. Para evitar las lesiones mientras se retira el cierre es importante que el pulgar que se utilice para empujarlo hacia arriba deje de estar en contacto con el tubo en cuanto el cierre BD Hemogard se suelte.
3. Levante el cierre del tubo. En el caso improbable de que el protector de plástico se separe del tapón de goma, **NO VUELVA A MONTAR EL CIERRE.** Retire el tapón de goma con cuidado del tubo.

X. Instrucciones para volver a introducir el cierre BD Hemogard



1. Vuelva a colocar el cierre sobre el tubo.
2. Gire y presione el tapón con firmeza hasta que esté totalmente introducido. Es necesario volver a introducir completamente el tapón para que el cierre permanezca fijo en el tubo durante la manipulación.

(continuación)

Asistencia técnica

Si tiene alguna pregunta acerca del tubo de ADN sanguíneo PAXgene, póngase en contacto con los departamentos de servicios técnicos de BD enumerados en la sección BD de Servicio de atención al cliente.

Información de pedidos

Productos PAXgene®

Tubo de ADN sanguíneo PAXgene/761165

Contenido: 1.000 tubos de extracción de sangre.

Productos BD*

Aguja de extracción de sangre BD Vacutainer Eclipse / 368609 CE

Contenido: Aguja de cal. 21, 1¼ pulgadas, 0,8 mm x 32 mm, 48/caja, 480/embalaje

Aguja de extracción de sangre BD Vacutainer Eclipse con soporte preconectado / 368650

Contenido: Aguja de calibre 21, 1¼ pulgadas, 0,8 mm x 32 mm, 100/embalaje

Aguja de extracción de sangre BD Vacutainer Eclipse Signal / 368835. CE

Contenido: Aguja de cal. 21, 1¼ pulgadas, 0,8 mm x 32 mm, 50/caja, 400/embalaje

Soporte de un solo uso BD Vacutainer / 364815

Contenido: Embalaje solamente para 13 mm y 16 mm de diámetro. 1000/embalaje

* Estos números de catálogo representan los productos habituales que pueden utilizarse con el tubo de ADN sanguíneo PAXgene.

Para efectuar un pedido de accesorios de extracción de sangre BD:

Diríjase a: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

• Seleccione el país • Desplácese hacia abajo hasta BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Marque el número

Productos QIAGEN*

Kit QIAGEN QIASymphony DSP DNA/ 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Contenido: cartucho de reactivos, gradilla de enzimas, tapa de perforación, tampón ATE, juego de sellado para reutilización

Kit QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini / 61104 (50)

Contenido: columnas de rotación QIAamp Mini, tubos de extracción, tampón AL, tampón ATL, tampón AW1, tampón AW2, tampón AE, proteasa QIAGEN, disolvente de proteasas

Kit sanguíneo QIAGEN Gentra® Puregene®/ 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Contenido: solución de eritrocitolisis, solución de lisis celular, solución de precipitación de proteínas, solución de hidratación del ADN, solución de RNAsa A

* Estos números de catálogo representan los kits de preparación de ADN habituales que pueden utilizarse con el tubo de ADN sanguíneo PAXgene.

Para efectuar un pedido de kits de preparación de ADN QIAGEN:

Diríjase a: <http://www.qiagen.com/contact/qiagenworldwide.aspx>

El tubo de ADN sanguíneo PAXgene está fabricado en el Reino Unido por BD para PreAnalytiX GmbH. PAXgene y PreAnalytiX son marcas comerciales de PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene son marcas comerciales de QIAGEN NV; Styrofoam es una marca comercial de The Dow Chemical Company; todas las demás marcas comerciales son propiedad de Becton, Dickinson y Company.

(continuación)

BD: Servicio de atención a cliente

Argentina, Uruguay y Paraguay

Pedidos: 011.4551.7100

Correo electrónico: crc_argentina@bd.com

Australia

Pedidos: 1.800.656. 100

Fax: 1.800.656.110

Correo electrónico: bd_anz@bd.com

Austria

Pedidos: 43.1.7063660

Fax: 43.1.7063660-11

Bélgica

Pedidos: 32.53.720.556

Fax: 32.53.720.549

Brasil

Pedidos: 0800.055.5654

Correo electrónico: consultoria_vacutainer@bd.com

Canadá

Pedidos: 800.268.5430

Fax: 800.565.0897

Correo electrónico: custsvccan@bd.com

Dinamarca

Pedidos: 45.43.43.45.66

Fax: 45.43.96.56.76

Correo electrónico: bdcs_dk@europe.bd.com

Europa del Este

Pedidos: 48.22.651.75.88

Fax: 48.22.651.75.89

Finlandia

Pedidos: 358.9.88.70.780

Fax: 358.9.88.70.7816

Correo electrónico: bdorder_finland@europe.bd.com

Francia

Pedidos: 33.476.689496

Fax: 33.476.683693

Correo electrónico:

BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Alemania

Pedidos: 49.6221305553

Fax: 49.6221305379

Italia

Pedidos: 39.02.48.240.500

Fax: 39.02.48.240.344

Servicio técnico: 39.02.48.240.264

Correo electrónico: ordini_medicale@europe.bd.com

Oriente Medio y África (EMA)

Pedidos: 971.4.3379525

Fax: 971.4.03379551

Correo electrónico: EMA_PAS@bd.com

Países Bajos

Pedidos: 31.20.6545.716

Fax: 31.20.5829.421

Correo electrónico:

vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Nueva Zelanda

Pedidos: 0800.572.468

Fax: 0800.572.469

Correo electrónico: bd_anz@bd.com

Noruega:

Pedidos: 47.73.59.12.00

Fax: 47.73.59.12.01

España

Pedidos: 34.902.27.17.27

Fax: 34.91.848.81.04

Correo electrónico: servicio_de_clientes@bd.com

Suecia

Pedidos: 46.8.775.51.60

Fax 46: 8.775.51.95

Correo electrónico: bdorder_sweden@europe.bd.com

Suiza

Pedidos: 41.61.4852222

Pedidos: 41.61.4852200

Reino Unido

Pedidos: 44.1.865.781.666

Fax: 44.1.865.717.313

Correo electrónico:

bduk_customerservice@europe.bd.com

EE. UU.

Pedidos: 888.237.2762

Fax: 800.847.2220

Servicio técnico: 800.631.0174

Correo electrónico: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN: Servicio de atención a cliente

Australia

Pedidos: 03.9840.9800
Fax: 03.9840.9888
Servicio técnico: 1.800.243.066

Austria

Pedidos: 0800/28.10.10
Fax: 0800/28.10.19
Servicio técnico: 0800/28.10.11

Bélgica

Pedidos: 0800.79612
Fax: 0800.79611
Servicio técnico: 0800.79556

Canadá

Pedidos: 800.572.9613
Fax: 800.713.5951
Servicio técnico: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

China

Pedidos: 0086.21.3865.3865
Fax: 0086.21.3865.3965
Servicio técnico: 800.988.0325 / 800.988.0327

Dinamarca

Pedidos: 80.885945
Fax: 80.885944
Servicio técnico: 80.885942

Finlandia

Pedidos: 0800.914416
Fax: 0800.914415
Servicio técnico: 0800.914413

Francia

Pedidos: 01.60.920.926
Fax: 01.60.920.925
Servicio técnico: 01.60.920.930
Ofertas: 01.60.920.928

Alemania

Pedidos: 02103.29.12000
Fax: 02103.29.22000
Servicio técnico: 02103.29.12400

Hong Kong

Pedidos: 800.933.965
Fax: 800.930.439
Servicio técnico: 800.930.425

Irlanda

Pedidos: 1800.555.049
Fax: 1800.555.048
Servicio técnico: 1800.555.061

Italia

Pedidos: 02.33430411
Fax: 02.33430426
Servicio técnico: 800.787980

Japón

Teléfono: 03.5547.0811
Fax: 03.5547.0818
Servicio técnico: 03.5547.0811

Corea (Sur)

Pedidos: 1544.7145
Fax: 1544.7146
Servicio técnico: 1544.7145

Luxemburgo

Pedidos: 8002.2076
Fax: 8002.2073
Servicio técnico: 8002.2067

Países Bajos

Pedidos: 0800.0229592
Fax: 0800.0229593
Servicio técnico: 0800.0229602

Noruega

Pedidos: 800.18859
Fax: 800.18817
Servicio técnico: 800.18712

Singapur

Pedidos: 65.67775366
Fax: 65.67785177
Servicio técnico: 65.67775366

España

Pedidos: 91.630.7050
Fax: 91.630.5145
Servicio técnico: 91.630.7050

Suecia

Pedidos: 020.790282
Fax: 020.790582
Servicio técnico: 020.798328

Suiza

Pedidos: 055.254.22.11
Fax: 055.254.22.13
Servicio técnico: 055.254.22.12

Reino Unido

Pedidos: 01293.422.911
Fax: 01293.422.922
Servicio técnico: 01293.422.999

EE. UU.

Pedidos: 800.426.8157
Fax: 800.718.2056
Servicio técnico: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

DNA-verekatsuti

ET – Eesti

I. Sihtotstarve

PAXgene'i DNA-verekatsuti on mõeldud DNA-d vajavates molekulaarsetes diagnostilistes katsemeetodites kasutatava kvaliteetse DNA ettevalmistamiseks vajaliku täisvereproovi kogumiseks, mittehüübimiseks, stabiliseerimiseks, transportimiseks ja säilitamiseks.

Seadme jõudlusomadusi pole molekulaarsete diagnostiliste analüüsides jaoks üldisemalt välja selgitatud. Kasutajad peavad toote kasutamise konkreetse molekulaarse diagnostilise analüüsi jaoks valideerima.

Toote omadused

PAXgene'i DNA-verekatsuti • 2,5 ml • 13 × 75 mm • K₂EDTA lisaaine
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 katsutit karbis • 1000 katsutit pakendis

II. Kokkuvõte ja selgitus

PAXgene'i DNA-verekatsuti on täisvere kogumisvahend genoomse DNA isoleerimiseks suletud ja vaakumi abil tühjendatud süsteemis. Verd kogutakse standardse flebotoomia protokoll järgi vaakumi abil tühjendatud katsutisse, mis sisaldab K₂EDTA lisaainet. DNA täielik isoleerimine toimub käsitsi või automaatsete meetoditega, näiteks sadestuse väljasoolamine, magnetgraanulid või silikoonipõhiste membraanide tehnoloogiad.

III. Hoiatused

Katsuti sisu ärritab nahka.


- Sissehingamisel viige katsuti sisuga kokku puutunud inimene värske õhu kätte.
- Kokkupuutel nahaga loputage nahka ohtra vee ja seebiga vähemalt 15 minutit.
- Silma sattumisel loputage silmi ohtra veega vähemalt 15 minutit.
- Allaneelamisel tarbige ohtralt vett. Pöörduge arsti poole.

IV. Proovide kogumine ja analüüsiks ettevalmistamine

A. Vere kogumiseks vajalikud lisatarvikud (ei ole kaasas PAXgene'i DNA-verekatsutiga)

1. Verekogumisnõel, näiteks BD Vacutainer® Eclipse™-i või BD Vacutainer Eclipse Signal™-i verekogumisnõel. Vt tellimisteavet.
2. Õigeks toimimiseks peab kasutama BD Vacutaineri nõelahoidikut. Vt tellimisteavet.
3. Proovide positiivse doonori tuvastamise etiketid (vajaduse korral)
4. Alkohooliga immutatud vatipulk proovi võtmise koha puhastamiseks
5. Kuiv steriilne marlilapp
6. Žgutt
7. Kasutatud nõela äraviskamiseks mõeldud konteiner või nõela/hoidiku kombinatsioon

B. Proovide kogumine



Üldised juhised

KANDKE VEENIPUNKTSIOONI AJAL JA VEREKOGUMISKATSUTITE KÄITLEMISEL KINDLAID, ET MINIMEERIDA VEREGA KOKKUPUUTUMISE OHTU.

1. Paigaldage nõel hoidikusse. Veenduge, et nõel asetseb kindlalt paigal, et vältida selle lahtitulekut kasutamise ajal.
2. Asetage katsuti hoidikusse. Märkus. Ärge torgake korgi sisse auku.
3. Valige veenipunktsiooni koht.
4. Paigaldage žgutt. Valmistage veenipunktsiooni koht sobiva antiseptikuga ette. **ÄRGE PUUDUTAGE VEENIPUNKTSIOONI PIIRKONDA PÄRAST SELLE PUHASTAMIST.**
5. Asetage patsiendi käsivars langevasse asendisse.
6. Eemaldage nõelalt kate. Tehke veenipunktsioon, NII ET KÄSI ON LANGEVAS ASENDIS JA KATSUTI KORK JÄÄB ÜLESPOOLE.
7. Viige hoidikus olevad katsutid korgi läbistamisel keskele, et vältida külgmisest seinast läbitungimist ja sellele järgnevat enneaegset vaakumi kadu. Lükake katsuti nõelale, torgates korgi membraani augu.
8. EEMALDAGE ŽGUTT KOHE, KUI VERI VALGUB KATSUTISSE. ÄRGE LASKE KATSUTI SISUL PROTSEDUURI AJAL KORGI VÕI NÕELA OTSAGA KOKKU PUUTUDA.

Märkus. Nõela muhvist võib aeg-ajalt verd lekkida. Verega kokkupuutumise ohu minimeerimiseks võtke kasutusele standardsed ettevaatusabinõud. Kui katsutisse ei voola üldse verd või kui verevool lakkab enne piisaval hulgal proovi kogumist, soovitatakse rahuldava kogumistulemuse saamiseks teha järgmist.

- a. Lükake katsutit edasi, kuni selle kork on läbistatud. Vajaduse korral hoidke katsutit paigas, et tagada täielik vaakumi tõmme.
 - b. Veenduge, et nõelaga kanüül asetseb veenis õigesti.
9. Kui katsuti on määratud mahu ulatuses täidetud ja verevool lakkab, eemaldage katsuti hoidikust.
 10. Pöörake 8 korda.
 11. Eemaldage nõel veenist ja vajutage kuiva steriilse vatipulgaga punktsioonikohale, kuni veritsus lõpeb.
 12. Kui veri on hüübinud, pange käele soovi korral side.
 13. Pärast veenipunktsiooni võib korgi pealmisel osal verejääke leiduda. Verega kokkupuute vältimiseks võtke katsutite käitlemisel kasutusele õiged ettevaatusabinõud.
 14. Visake nõel ja hoidik asutuse töökorra ja juhiste kohaselt minema.
 15. Säilitage täidetud PAXgene'i DNA-verekatsutit toatemperatuuril (18-25 °C). Vaadake toatemperatuuril (18-25 °C) või temperatuuril 2-8 °C, või -20 °C olevate vereproovide DNA stabiilsuse omadusi.

Vt lisateavet proovide külmutamise ja sulatamise kohta PAXgene'i DNA-verekatsutites, kui soovite proove säilitada temperatuuril -70 °C / -80 °C.

Võimaliku tagasivoolu vältimiseks kasutatakse järgmisi tehnikaid.

- a. Asetage doonori käsivars langevasse asendisse.
- b. Hoidke katsutit nii, et kork jääb ülespoole.
- c. Vabastage žgutt kohe, kui veri hakkab katsutisse voolama.
- d. Veenduge, et katsuti lisained ei puutu veenipunktsiooni ajal korgi või nõela otsaga kokku.

C. Proovide külmutamine ja sulatamine PAXgene'i DNA-verekatsutis

1. Pange PAXgene'i DNA-verekatsuti püstises asendis traatstatiivile. **Ärge külmutage katsuteid püstises asendis vahtpolüstüroolist Styrofoam™-i alusel, kuna katsutid võivad nii praguneda.**
2. PAXgene'i DNA-verekatsuteid võib säilitada -20 °C juures ja madalamal temperatuuril. Kui katsuteid tuleb hoida madalamal temperatuuril kui -20 °C, külmutage neid kõigepealt -20 °C juures 24 tundi ja seejärel viige need -70 °C või -80 °C juurde.

3. Sulatage PAXgene'i DNA-verekatsuteid traatstatiivil ümbritsevas temperatuuris (18-25 °C) umbes kaks tundi.

Ärge sulatage PAXgene'i DNA-verekatsuteid kõrgema kui 25 °C juures.

4. Pöörake sulatatud PAXgene'i DNA-verekatsuti ettevaatlikult 10 korda ümber.

Märkus. Külmutunud PAXgene'i DNA-verekatsutid purunevad löögi korral. Transpordi käigus purunemise ohu vähendamiseks tuleks külmutatud katsuteid kohelda samamoodi kui klaasist katsuteid. Kasutajad peavad PAXgene'i DNA-verekatsute jaoks valideerima oma külmutus- ja transpordiprotokolli.

D. Provide analüüsiks ettevalmistamine


Vereproove tuleb töödelda DNA-proovide ettevalmistamiskomplektiga kaasasolevate juhiste järgi. Vt nt tellimisteavet.

V. Tööomadused

Pärast vere katsutisse lisamist on DNA temperatuuril 18-25 °C stabiilne kuni 14 päeva (joonis1). DNA stabiilsuse uuringute põhjal võib verd katsutis säilitada kuni 14 päeva temperatuuril 18-25 °C, 28 päeva temperatuuril 2-8 °C, 3 päeva temperatuuril 35 °C või minimaalselt kuus kuud temperatuuril -20 °C, kui DNA kontsentratsioon on 12,5 ng/μl ja DNA puhtus (A_{260}/A_{280}) 1,7-1,9.

Kõige uuemaid andmeid külmutatud proovide kohta leiate aadressilt www.PreAnalytix.com.

DNA stabiilsus vereproovides temperatuuril 18-25 °C

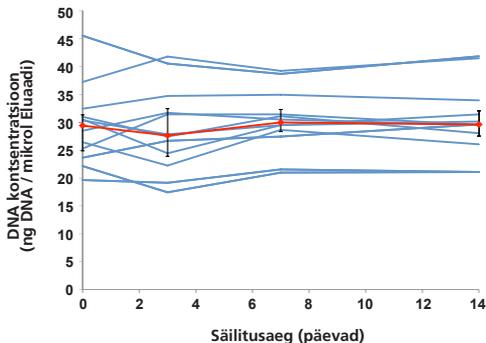

Joonis 1

Verd võeti selleks loa andnud 12 täiskasvanult doonorilt ja seda säilitati 18-25 °C juures ettenähtud arvu päevi, millele järgnes kogu DNA puhastamine. Veri koguti ja seda säilitati PAXgene'i DNA-verekatsutites ja kogu DNA puhastati QIAGEN® QIASymphony® DSP DNA minikomplektiga QIAGEN QIASymphony automaatseadmes.

VI. Piirangud

1. Võetava vere hulk peaks olema 2,5 ml PAXgene'i DNA-verekatsuti kohta, kuid see maht võib erineda olenevalt kõrgusest, ümbritsevast temperatuurist, õhurõhust, katsuti vanusest, veenirõhust ja täitmistehnikast.

VII. Ettevaatusabinõud

1. Võtke kasutusele standardsed ettevaatusabinõud. Kasutage kindaid, kitleid, kaitseprille, muid isikukaitsevahendeid ja tehnilist kontrolli, et kaitsta end verepritsmete, -lekete ja võimaliku vere kaudu levivate patogeenidega kokkupuutumise eest.
2. Käideldge kõiki bioloogilisi proove ja vere kogumisel kasutatud teravaid vahendeid asutuse töökorra ja protseduuride kohaselt. Bioloogiliste proovidega kokkupuutumisel (nt torkehaava korral) otsige meditsiinilist abi, kuna proovid võivad edasi kanda viirushepatiiti, HIV-i (AIDS-i) või muid nakkushaigusi.


Kasutage mis tahes sisseehitatud nõelakaitset, kui see verekogumiskomplektil olemas on. PreAnalytiX ei soovita kasutatud nõeltele uuesti katet paigaldada. Samas võivad teie asutuse töökord ja protseduurid erineda olla ning neid tuleb alati järgida.

3. Visake kõik verekogumiskatsutid selleks heakskiidu saanud bioohtlike jäätmete konteineritesse.
4. Ärge kasutage PAXgene'i DNA-verekatsuteid korduvalt.
5. Ärge kasutage PAXgene'i DNA-verekatsuteid pärast etiketile trükitud aegumistähtaja möödumist.
6. Liiga suur tsentrifuugimise kiirus (üle 10 000 RCF-i) võib põhjustada PAXgene'i DNA-verekatsuti purunemise, kasutaja kokkupuute verega ja võimaliku vigastuse.
7. Ärge viige proovi süstlast katsutisse.

VIII. Säilitamine

1. Säilitage kasutamata PAXgene'i DNA-verekatsuteid temperatuuril 18 °C kuni 25 °C. Lubatud on temperatuuri piiratud kõrvalekaldeid kuni 40 °C. Ärge kasutage katsuteid pärast aegumistähtaja möödumist.


IX. BD Hemogardi korki eemaldamise juhised



1. Hoidke ühe käega PAXgene'i DNA-verekatsutit ja asetage põial BD Hemogardi korki alla. (Täiendava stabiilsuse huvides toetage käsivars kindlale pinnale.) Keerake vaba käega BD Hemogardi korki, lükates samal ajal teise käe põialt üles AINULT KATSUTI KORKI VABANEMISENI.

2. Võtke põial enne korki tõstmist sellelt ära. ÄRGE lükake korki pöidla abil katsutilt maha. Kui katsuti sisaldab verd, on teil oht sellega kokku puutuda. Selleks et vältida korki eemaldamisel vigastuste tekkimist, tuleb põial, millega korki üles lükatakse, kindlasti katsutilt ära võtta kohe, kui BD Hemogardi kork vabaneb.
3. Tõstke kork katsutilt ära. Kui plastkate peaks kummist korki küljest ära tulema, mis on küll ebatõenäoline, ÄRGE KORKI UUESTI KOKKU PANGE. Eemaldage kummist kork ettevaatlikult katsutilt.

X. BD Hemogardi korki taaspaigalduse juhised



1. Asetage kork uuesti katsutile.
2. Keerake ja suruge seda kindlalt alla, kuni kork on täielikult paigas. Kork tuleb täielikult tagasi panna, et see püsiks käitlemise ajal kindlalt katsutil.

Tehniline abi

Kui teil on küsimusi PAXgene'i DNA-verekatsuti kohta, võtke ühendust BD tehnilise teeninduse osakonnaga, mis on toodud jaotises BD – klienditeenindus.

Tellimisteave

PAXgene'i tooted

PAXgene'i DNA-verekatsuti / 761165

Sisu: 1000 verekogumiskatsutit.

BD tooted*

BD Vacutainer Eclipse'i verekogumisnõel / 368609 CE

Sisu: 21G 1¼-tolline nõel, 0,8 mm x 32 mm, 48 karbis, 480 pakendis

BD Vacutainer Eclipse'i verekogumisnõel eelkinnitatud hoidikuga / 368650

Sisu: 21G 1¼-tolline nõel, 0,8 mm x 32 mm, 100 pakendis

BD Vacutainer Eclipse Signali verekogumisnõel / 368835 CE

Sisu: 21G 1¼-tolline nõel, 0,8 mm x 32 mm, 50 karbis, 400 pakendis

BD Vacutaineri ühekordselt kasutatav hoidik / 364815

Sisu: ainult 13 mm ja 16 mm läbimõõduga katsutitele, 1000 pakendis

* Need katalooginumbrid esindavad tavapäraseid tooteid, mida saab kasutada koos PAXgene'i DNA-verekatsutiga.

BD vere kogumise lisatarvikute tellimine

Minge aadressile <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Valige riik • Kerige alla valiku BD Diagnostics – Preanalytical Systems juurde • Valige number

QIAGENi tooted*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA komplekt / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Sisu: reaktiivide kassett, ensüümide raam, läbitorkekaas, puhver-ATE, korduvkasutatav kinnituskomplekt

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Sisu: QIAamp Mini pöördtorud, kogumiskatsutid, puhver-AL, puhver-ATL, puhver-AW1, puhver-AW2, puhver-AE, QIAGEN proteaas, proteaasi lahus

QIAGEN Gentra® Puregene® verekomplekt / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Sisu: erütrotsüütide lüüsimise lahus, raku lüüsimise lahus, proteiini sadestumise lahus, DNA hüdratatsioonilahus, ribonukleas A lahus

* Need katalooginumbrid esindavad tavapäraseid DNA ettevalmistuskomplekte, mida saab kasutada koos z PAXgene'i DNA-verekatsutiga.

QIAGEN DNA ettevalmistuskomplektide tellimine

Minge aadressile <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

PAXgene'i DNA-verekatsuti valmistab ettevõtte BD Ühendkuningriigis PreAnalytiX GmbH jaoks. PAXgene ja PreAnalytiX on ettevõtte PreAnalytiX GmbH kaubamärgid; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra ja Puregene on ettevõtte QIAGEN NV kaubamärgid; Styrofoam on ettevõtte The Dow Chemical Company kaubamärk; kõik teised kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Becton, Dickinson and Company.

BD – klienditeenindus

Argentina, Uruguay ja Paraguay

Tellimused: 011.4551.7100
E-post: crc_argentina@bd.com

Austraalia

Tellimused: 1.800.656. 100
Faks: 1.800.656.110
E-post: bd_anz@bd.com

Austria

Tellimused: 43.1.7063660
Faks: 43.1.7063660-11

Belgia

Tellimused: 32.53.720.556
Faks: 32.53.720.549

Brasiilia

Tellimused: 0800.055.5654
E-post: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Tellimused: 800.268.5430
Faks: 800.565.0897
E-post: custsvccan@bd.com

Taani

Tellimused: 45.43.43.45.66
Faks: 45.43.96.56.76
E-post: bdcg_dk@europe.bd.com

Ida-Euroopa

Tellimused: 48.22.651.75.88
Faks: 48.22.651.75.89

Soome

Tellimused: 358.9.88.70.780
Faks: 358.9.88.70.7816
E-post: bdorder_finland@europe.bd.com

Prantsusmaa

Tellimused: 33.476.689496
Faks: 33.476.683693
E-post: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Saksamaa

Tellimused: 49.6221305553
Faks: 49.6221305379

Itaalia

Tellimused: 39.02.48.240.500
Faks: 39.02.48.240.344
Tehniline: 39.02.48.240.264
E-post: ordini_medicale@europe.bd.com

Lähis-Ida ja Aafrika (EMA)

Tellimused: 971.4.3379525
Faks: 971.4.03379551
E-post: EMA_PAS@bd.com

Holland

Tellimused: 31.20.6545.716
Faks: 31.20.5829.421
E-post: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Uus-Meremaa

Tellimused: 0800.572.468
Faks: 0800.572.469
E-post: bd_anz@bd.com

Norra

Tellimused: 47.73.59.12.00
Faks: 47.73.59.12.01

Hispaania

Tellimused: 34.902.27.17.27
Faks: 34.91.848.81.04
E-post: servicio_de_clientes@bd.com

Rootsi

Tellimused: 46.8.775.51.60
Faks: 46.8.775.51.95
E-post: bdorder_sweden@europe.bd.com

Šveits

Tellimused: 41.61.4852222
Tellimused: 41.61.4852200

Ühendkuningriik

Tellimused: 44.1.865.781.666
Faks: 44.1.865.717.313
E-post: bduk_customerservice@europe.bd.com

Ameerika Ühendriigid

Tellimused: 888.237.2762
Faks: 800.847.2220
Tehniline: 800.631.0174
E-post: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – klienditeenindus

Austraalia

Tellimused: 03.9840.9800
Faks: 03.9840.9888
Tehniline: 1.800.243.066

Austria

Tellimused: 0800/28.10.10
Faks: 0800/28.10.19
Tehniline: 0800/28.10.11

Belgia

Tellimused: 0800.79612
Faks: 0800.79611
Tehniline: 0800.79556

Kanada

Tellimused: 800.572.9613
Faks: 800.713.5951
Tehniline: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Hiina

Tellimused: 0086.21.3865.3865
Faks: 0086.21.3865.3965
Tehniline: 800.988.0325 / 800.988.0327

Taani

Tellimused: 80.885945
Faks: 80.885944
Tehniline: 80.885942

Soome

Tellimused: 0800.914416
Faks: 0800.914415
Tehniline: 0800.914413

Prantsusmaa

Tellimused: 01.60.920.926
Faks: 01.60.920.925
Tehniline: 01.60.920.930
Pakkumised: 01.60.920.928

Saksamaa

Tellimused: 02103.29.12000
Faks: 02103.29.22000
Tehniline: 02103.29.12400

Hongkong

Tellimused: 800.933.965
Faks: 800.930.439
Tehniline: 800.930.425

Iirimaa

Tellimused: 1800.555.049
Faks: 1800.555.048
Tehniline: 1800.555.061

Itaalia

Tellimused: 02.33430411
Faks: 02.33430426
Tehniline: 800.787980

Jaapan

Telefon: 03.5547.0811
Faks: 03.5547.0818
Tehniline: 03.5547.0811

Lõuna-Korea

Tellimused: 1544.7145
Faks: 1544.7146
Tehniline: 1544.7145

Luksemburg

Tellimused: 8002.2076
Faks: 8002.2073
Tehniline: 8002.2067

Holland

Tellimused: 0800.0229592
Faks: 0800.0229593
Tehniline: 0800.0229602

Norra

Tellimused: 800.18859
Faks: 800.18817
Tehniline: 800.18712

Singapur

Tellimused: 65.67775366
Faks: 65.67785177
Tehniline: 65.67775366

Hispaania

Tellimused: 91.630.7050
Faks: 91.630.5145
Tehniline: 91.630.7050

Rootsi

Tellimused: 020.790282
Faks: 020.790582
Tehniline: 020.798328

Šveits

Tellimused: 055.254.22.11
Faks: 055.254.22.13
Tehniline: 055.254.22.12

Ühendkuningriik

Tellimused: 01293.422.911
Faks: 01293.422.922
Tehniline: 01293.422.999

Ameerika Ühendriigid

Tellimused: 800.426.8157
Faks: 800.718.2056
Tehniline: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

DNA-verinäyteputki

FI – Suomi

I. Käyttötarkoitus

PAXgene DNA -verinäyteputki on tarkoitettu kokoverinäytteen keräämiseen ja verinäytteen hyytymisen estämiseen sekä sen vakauttamiseen, kuljetukseen ja säilytykseen, jotta voidaan valmistella korkealaatuinen DNA-näyte käytettäväksi DNA:ta vaativissa molekyyli diagnostiikoissa.

Tämän laitteen suorituskykyominaisuuksia ei ole yleisesti määritetty molekyyli diagnostiikoiden osalta. Käyttäjien on validoitava tämän tuotteen käyttö käyttämälleen molekyyli diagnostiikalle.

Tuotteen ominaisuudet

PAXgene DNA -verinäyteputki • 2,5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA-lisäaine
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 putkea/pakkaus • 1 000 putkea/laatikko

II. Yhteenveto ja selitys

PAXgene DNA -verinäyteputken avulla kerätään kokoverinäyte genomisen DNA:n eristämiseksi suljetussa tyhjiöjärjestelmässä. Verinäyte otetaan vakiovenesektiona vakuumputken, jossa on K₂EDTA-lisäainetta. DNA eristetään täydellisesti joko manuaalisin tai automaattisin menetelmin, kuten suolasaostuksella, magneettihelmillä tai silikakalvotekniikoilla.

III. Varoitukset

Tämän putken sisältö ärsyttää ihoa.


- Sisäänhengityksen jälkeen altistunut henkilö on siirrettävä raittiiseen ilmaan.
- Ihokosketuksen jälkeen ihoa on heti huuhdeltava runsaalla vedellä ja saippualla vähintään 15 minuuttia.
- Silmäkosketuksen jälkeen silmiä on heti huuhdeltava runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia.
- Jos ainetta nielaistaan, on juotava heti runsaasti vettä. Käänny lääkärin puoleen.

IV. Näytteiden otto ja valmistelu analyysiä varten

A. Näytteenotossa tarvittavat välineet (eivät sisälly PAXgene DNA -verinäyteputken pakkaukseen)

1. Näytteenottoneula, esim. BD Vacutainer® Eclipse™ -neula tai BD Vacutainer Eclipse Signal™ -neula. Katso kohta Tilaustiedot.
2. BD Vacutainer -neulanpidikettä on käytettävä oikean toiminnan varmistamiseksi. Katso kohta Tilaustiedot.
3. Tuotetarrat, joiden perusteella luovuttajien näytteet tunnustetaan, jos tarpeen
4. Alkoholituppo kohdealueen puhdistamista varten
5. Kuivaa steriiliä sideharsoa
6. Puristusside
7. Neulojen hävityksistä käytetylle neulalle tai neulan/pidikkeen yhdistelmälle

B. Näytteenottomenetelmä



Yleiset ohjeet

MINIMOI VAARALLE ALTISTUMISTA KÄYTTÄMÄLLÄ KÄSINEITÄ LASKIMOPUNKTION AIKANA JA VERINÄYTEPUTKIA KÄSITELTÄESSÄ.

1. Asenna neula pidikkeeseen. Tarkista, että neula asettuu tiukasti sen varmistamiseksi, että neula ei irtoa kiinnityksestä käytön aikana.
2. Aseta putki pidikkeeseen. Huomautus: Älä puhkaise tulppaa.
3. Valitse pistokohta.
4. **Kiinnitä puristusside. Valmistele pistokohta asianmukaisella antiseptisellä aineella. ÄLÄ PALPOI PISTOKOHTAA YMPÄRÖIVÄÄ ALUETTA PUHDISTAMISEN JÄLKEEN.**
5. Aseta potilaan käsivarsi alas suuntautuvaan asentoon.
6. Irrota neulansuojus. Tee laskimopunktio KÄSIVARSI ALAS SUUNNATTUNA JA PUTKEN TULPPA KOHDISTETTUNA YLÖSPÄIN.
7. Keskitä putket pidikkeen keskelle tulppaa puhkaistaessa, jotta sivuseinää ei puhkaista ja tyhjiötä menetetä enenaikaisesti. Työnnä putki neulaan, jolloin tulpan kalvo puhkeaa.
8. **POISTA PURISTUSSIDE HETI, KUN VERTA ILMAANTUU PUTKEEN. ÄLÄ ANNA PUTKEN SISÄLLÖN KOSKETTAA TULPPAA TAI NEULAN PÄÄTÄ TOIMENPITEEN AIKANA.**

Huomautus: Verta saattaa toisinaan vuotaa neulan holkista. Minimoi altistusvaaraa noudattamalla yleisiä varotoimia. Jos verta ei virtaa putkeen tai jos verenvirtaus loppuu ennen kuin riittävä näyte on saatu, seuraavia vaiheita suositellaan hyväksyttävän näytteenoton loppuunsaattamiseksi:

- a. Työnnä putkea eteenpäin, kunnes putken tulppa on läpäisty. Pidä tarvittaessa paikallaan ja varmista, että tyhjiö vetää veren putkeen.
 - b. Varmista neulan oikea sijainti laskimossa.
9. Kun putki on täyttynyt merkittyyn tilavuuteen ja veren virtaus loppuu, poista putki pidikkeestä.
 10. Käännä 8 kertaa.
 11. Irrota neula laskimosta ja paina pistoskohtaa kuivalla steriilillä tupolla, kunnes verenvuoto loppuu.
 12. Kun verenvuoto on tyrehtynyt, kiinnitä sidos haluttaessa.
 13. Laskimopunktion jälkeen tulpan yläosassa saattaa olla jäämäverta. Noudata asianmukaisia varotoimia ja vältä koskettamasta tätä verta putkia käsiteltäessä.
 14. Hävitä neula ja pidike laitoksen käytännön ja menettelytavan mukaisesti.
 15. Säilytä täytettyä PAXgene DNA -verinäyteputkea huoneenlämmössä (18-25 °C). Katso suorituskykyominaisuudet DNA:n stabiiliuden suhteen verinäytteissä huoneenlämmössä (18-25 °C) ja asteissa 2-8 °C, tai -20 °C.

Katso kohta PAXgene DNA -verinäyteputkissa olevien näytteiden pakastus ja sulatus, jos säilytyslämpötila on -70 °C / -80 °C.

Mahdollisen takaisinvirtauksen estämiseksi on käytettävä seuraavia menetelmiä:

- a. Aseta luovuttajan käsivarsi alas suuntautuvaan asentoon.
- b. Pidä putkesta kiinni siten, että tulppa osoittaa ylöspäin.
- c. Vapauta puristusside heti, kun verta alkaa virrata putkeen.
- d. Varmista, että putken lisäaineet eivät kosketa tulppaa tai neulan päätä laskimopunktion aikana.

C. PAXgene DNA -verinäyteputkissa olevien näytteiden pakastus ja sulatus

1. Aseta PAXgene DNA -verinäyteputki pystyasentoon lankatelineeseen. **Putkia ei saa pakastaa pystyasennossa Styrofoam™-vaahtomuovitarjottimella, koska se saattaa johtaa putkien halkeiluun.**
2. PAXgene DNA -verinäyteputkia voi säilyttää -20 °C:ssa ja sen alla olevissa lämpötiloissa. Jos putkia säilytetään alle -20 °C:n lämpötiloissa, ne on ensin jäädytettävä -20 °C:ssa 24 tuntia ja sitten siirrettävä -70 °C:hen tai -80 °C:hen.

(jatkuu)

3. Sulata PAXgene DNA -verinäyteputket lankatelineessä huoneenlämmössä (18-25°C) noin kaksi tuntia. **Älä sulata PAXgene DNA -verinäyteputkia yli 25°C:n lämpötiloissa.**

4. Käännä sulatettuja PAXgene DNA -verinäyteputkia huolellisesti 10 kertaa.

Huomautus: Pakastetut PAXgene DNA -verinäyteputket ovat alttiita rikkoutumiselle iskun sattuessa. Pakastettuja putkia on käsiteltävä samaan tapaan kuin lasiputkia rikkoutumisvaaran vähentämiseksi kuljetuksen aikana. Käyttäjien tulee validoida pakastus- ja kuljetusprotokollansa PAXgene DNA -verinäyteputkille.

D. Näytteen valmistelu analyysiä varten


Verinäytteet on käsiteltävä DNA-näytteenvalmistelupakkauksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Katso esimerkkejä kohdasta Tilaustiedot.

V. Suorituskykyominaisuudet

Kun veri on otettu putkeen, DNA säilyy stabiilina 14 päivää 18-25°C:ssa (kuva 1). DNA:n stabiiliuteen liittyvien tutkimusten mukaan verta voidaan säilyttää putkessa 14 päivää 18-25°C:ssa, 28 päivää 2-8°C:ssa, 3 päivää 35°C:ssa ja vähintään 6 kuukautta -20°C:ssa, kun DNA-pitoisuus on $\geq 12,5$ ng/ μ l ja DNA-puhtaus (A_{260}/A_{280}) 1,7–1,9.

Katso uusimmat tiedot jäädytettujen näytteiden stabiiliudesta osoitteesta www.PreAnalytix.com.

DNA:n stabiilius verinäytteissä 18-25°C:ssa

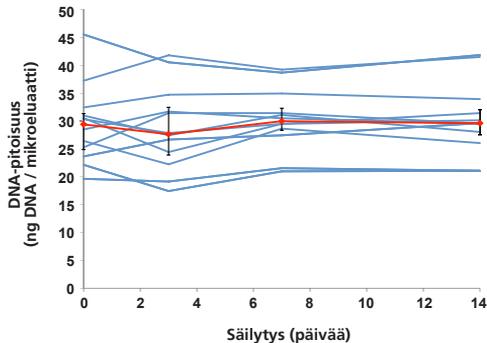

Kuva 1

Verta otettiin 12 suostumuksen antaneelta aikuisluovuttajalta, ja näytteitä säilytettiin 18-25°C:ssa mainittu määrä päiviä, minkä jälkeen DNA puhdistettiin täysin. Verta otettiin ja säilytettiin PAXgene DNA -verinäyteputkissa, ja DNA puhdistettiin QIAGEN® QIASymphony® DSP DNA Mini -pakkauksella, joka sisältyy QIAGEN QIASymphony -automaattilaitteeseen.

VI. Rajoitukset

1. Otetun näytteen verimäärän on oltava 2,5 ml PAXgene DNA -verinäyteputkea kohden, mutta tämä määrä voi vaihdella merenpinnan korkeuden, ympäröivän lämpötilan, ilmanpaineen, putken iän, laskimopaineen ja täyttömenetelmän mukaan.

VII. Varotoimet

1. Noudata yleisiä varotoimia. Käytä käsineitä, suojaopukuja, silmäsuojia, muita henkilösuojaimia ja teknisiä torjuntakeinoja suojautuaksesi veriroiskeilta, verivuodoilta ja mahdolliselta altistumiselta veriteitse leviävillä taudinaiheuttajille.

2. Käsittele kaikkia biologisia näytteitä ja verinäytteenottoon tarkoitettuja teräviä välineitä laitoksesi käytäntöjen ja menetelmien mukaisesti. Käännä lääkärin puoleen, jos olet altistunut biologisille näytteille (esimerkiksi pistohaavan välityksellä), koska näytteistä voi saada virushepatiitti- tai HIV-tartunnan (AIDS) tai muita tarttuvia tautteja.


Käytä mahdollista kiinteää neulasuojusta, jos verinäytteenottovälineessä on sellainen. PreAnalytiX ei suosittele suojusten asettamista takaisin käytettyihin neuloihin. Laitoksesi käytäntö ja menettelytavat saattavat kuitenkin poiketa tästä, ja niitä tulee aina noudattaa.

3. Hävitä kaikki verinäytteen ottamisessa käytetyt putket viemällä ne biovaarallisen jätteen hävittämiseen tarkoitettuihin hyväksytyihin säiliöihin.
4. Älä käytä PAXgene DNA -verinäyteputkia uudelleen.
5. PAXgene DNA -verinäyteputkia ei saa käyttää putken tuotetarraan merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
6. Liiallinen sentrifugointivoima (yli 10 000 RCF) saattaa aiheuttaa PAXgene DNA -verinäyteputken rikkoutumisen, altistumisen verelle ja mahdollisen vamman.
7. Älä siirrä näytettä ruiskusta putkeen.

VIII. Säilytys

1. Säilytä käyttämättömiä PAXgene DNA -verinäyteputkia 18-25°C:ssa. Lyhytaikaiset lämpötilannousut enintään 40°C:hen ovat hyväksyttäviä. Putkia ei saa käyttää niiden viimeisen käyttöpäivän jälkeen.


IX. BD Hemogard -sulkimen poistaminen



1. Tartu toisella kädellä PAXgene DNA -verinäyteputkeen asettamalla peukalo BD Hemogard -sulkimen alle. (Saat lisävakautta asettamalla käsivartesi tukevalle tasolle.) Kierrä toisella kädellä BD Hemogard -suljinta ja työntäen samanaikaisesti toisen käden peukalolla ylöspäin VAIN NIIN PITKÄÄN, ETTÄ PUTKEN TULPPA LÖYSTYY.

2. Siirrä peukalo pois ennen sulkimen nostamista. ÄLÄ käytä peukaloo sulkimen työntämiseen irti putkesta. Jos putkessa on verta, on olemassa altistumisvaara. Suljinta poistettaessa tapahtuvan vamman estämiseksi on tärkeää, että poistettavan sulkimen ylöspäin työntämiseen käytettävä peukalo irrotetaan kosketuksesta putken kanssa heti, kun BD Hemogard -suljin löystyy.
3. Nosta suljin pois putkesta. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että muovisuojus irtoaa kumitulpasta, ÄLÄ KOKOAA SULJINTA UUDELLEEN. Poista kumitulppa varovasti putkesta.

X. BD Hemogard -sulkimen asettaminen takaisin



1. Aseta suljin takaisin putken päälle.
2. Kierrä ja työnnä kunnolla alaspäin, kunnes tulppa on täysin asettunut takaisin paikalleen. Tulppa on asetettava kunnolla takaisin paikalleen, jotta suljin pysyy tiukasti putkessa käsittelyn aikana.

Tekninen tuki

Jos sinulla on kysyttävää PAXgene DNA -verinäyteputkesta, ota yhteyttä johonkin BD:n teknisen tuen yksiköistä, jotka on luettelut BD – Asiakaspalvelu -osiossa.

Tilastiedot

PAXgene-tuotteet

PAXgene DNA -verinäyteputki / 761165

Sisältö: 1 000 verinäytteenottoputkea.

BD-tuotteet*

BD Vacutainer Eclipse -näytteenottoneula / 368609 CE

Sisältö: 21G 1¼ tuuman neula, 0,8 mm x 32 mm, 48/rasia, 480/laatikko

BD Vacutainer Eclipse -näytteenottoneula, jossa valmiiksi kiinnitetty pidike / 368650

Sisältö: 21G 1¼ tuuman neula, 0,8 mm x 32 mm, 100/laatikko

BD Vacutainer Eclipse Signal -näytteenottoneula / 368835 CE

Sisältö: 21G 1¼ tuuman neula, 0,8 mm x 32 mm, 50/rasia, 400/laatikko

BD Vacutainer -kertakäyttöinen pidike / 364815

Sisältö: Laatikko vain 13 mm ja 16 mm halkaisijoille, 1 000/laatikko

* Nämä luettelonumerot edustavat tyypillisiä tuotteita, joita voi käyttää PAXgene DNA -verinäyteputken kanssa.

BD-näytteenottovälineiden tilaaminen:

Mene osoitteeseen: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Valitse maa • Vieritä alas kohtaan BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Valitse numero

QIAGEN-tuotteet*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA -pakkaus / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Sisältö: Reagenssipatruuna, entsyymiteline, lävistyskorkki, ATE-puskuri, tiivistyssarja uudelleenkäyttöä varten

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Sisältö: QIAamp Mini -pylväät, näytteenottoputket, AL-puskuri, ATL-puskuri, AW1-puskuri, AW2-puskuri, AE-puskuri, QIAGEN-proteaasi, proteaasiliuos

QIAGEN Gentra® Puregene® -näytteenottopakkaus / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1 000 ml)

Sisältö: RBC-lyysiliuos, solujen lyysiliuos, proteiinin saostusliuos, DNA-rehydraatioliuos, RNase A -liuos

* Nämä luettelonumerot edustavat tyypillisiä DNA-valmistelupakkauksia, joita voi käyttää PAXgene DNA -verinäyteputken kanssa.

QIAGEN DNA -valmistelupakkausten tilaaminen:

Mene osoitteeseen: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

PAXgene DNA -verinäyteputki on valmistettu Iso-Britanniassa ja sen on PreAnalytiX GmbH:lle valmistuttanut BD. PAXgene ja PreAnalytiX ovat PreAnalytiX GmbH:n tavaramerkkejä; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra ja Puregene ovat QIAGEN NV:n tavaramerkkejä; Styrofoam on The Dow Chemical Companyn tavaramerkki; kaikki muut tavaramerkit ovat Becton, Dickinson and Companyn omaisuutta.

(jatkuu)

BD – Asiakaspalvelu

Argentiina, Uruguay ja Paraguay

Tilaukset: 011 4551 7100

Sähköposti: crc_argentina@bd.com

Australia

Tilaukset: 1 800 656 100

Faksi: 1 800 656 110

Sähköposti: bd_anz@bd.com

Itävalta

Tilaukset: 43 1 7063660

Faksi: 43 1 7063660-11

Belgia

Tilaukset: 32 53 720 556

Faksi: 32 53 720 549

Brasilia

Tilaukset: 0800 055 5654

Sähköposti: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Tilaukset: 800 268 5430

Faksi: 800 565 0897

Sähköposti: custsvccan@bd.com

Tanska

Tilaukset: 45 43 43 45 66

Faksi: 45 43 96 56 76

Sähköposti: bdcs_dk@europe.bd.com

Itä-Eurooppa

Tilaukset: 48 22 651 75 88

Faksi: 48 22 651 75 89

Suomi

Tilaukset: 358 9 88 70 780

Faksi: 358 9 88 70 7816

Sähköposti: bdorder_finland@europe.bd.com

Ranska

Tilaukset: 33 476 689496

Faksi: 33 476 683693

Sähköposti: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Saksa

Tilaukset: 49 6221305553

Faksi: 49 6221305379

Italia

Tilaukset: 39 02 48 240 500

Faksi: 39 02 48 240 344

Tekninen tuki: 39 02 48 240 264

Sähköposti: ordini_medicale@europe.bd.com

Lähi-itä ja Afrikka (EMA)

Tilaukset: 971 4 3379525

Faksi: 971 4 03379551

Sähköposti: EMA_PAS@bd.com

Alankomaat

Tilaukset: 31 20 6545 716

Faksi: 31 20 5829 421

Sähköposti: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Uusi-Seelanti

Tilaukset: 0800 572 468

Faksi: 0800 572 469

Sähköposti: bd_anz@bd.com

Norja

Tilaukset: 47 73 59 12 00

Faksi: 47 73 59 12 01

Espanja

Tilaukset: 34 902 27 17 27

Faksi: 34 91 848 81 04

Sähköposti: servicio_de_clientes@bd.com

Ruotsi

Tilaukset: 46 8 775 51 60

Faksi: 46 8 775 51 95

Sähköposti: bdorder_sweden@europe.bd.com

Sveitsi

Tilaukset: 41 61 4852222

Tilaukset: 41 61 4852200

Iso-Britannia

Tilaukset: 44 1 865 781 666

Faksi: 44 1 865 717 313

Sähköposti: bduk_customerservice@europe.bd.com

USA

Tilaukset: 888 237 2762

Faksi: 800 847 2220

Tekninen tuki: 800 631 0174

Sähköposti: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Asiakaspalvelu

Australia

Tilaukset: 03 9840 9800
Faksi: 03 9840 9888
Tekninen tuki: 1 800 243 066

Itävalta

Tilaukset: 0800/28 10 10
Faksi: 0800/28 10 19
Tekninen tuki: 0800/28 10 11

Belgia

Tilaukset: 0800 79612
Faksi: 0800 79611
Tekninen tuki: 0800 79556

Kanada

Tilaukset: 800 572 9613
Faksi: 800 713 5951
Tekninen tuki: 800 DNA PREP
(800 362 7737)

Kiina

Tilaukset: 0086 21 3865 3865
Faksi: 0086 21 3865 3965
Tekninen tuki: 800 988 0325 / 800 988 0327

Tanska

Tilaukset: 80 885945
Faksi: 80 885944
Tekninen tuki: 80 885942

Suomi

Tilaukset: 0800 914416
Faksi: 0800 914415
Tekninen tuki: 0800 914413

Ranska

Tilaukset: 01 60 920 926
Faksi: 01 60 920 925
Tekninen tuki: 01 60 920 930
Tarjoukset: 01 60 920 928

Saksa

Tilaukset: 02103 29 12000
Faksi: 02103 29 22000
Tekninen tuki: 02103 29 12400

Hongkong

Tilaukset: 800 933 965
Faksi: 800 930 439
Tekninen tuki: 800 930 425

Irlanti

Tilaukset: 1800 555 049
Faksi: 1800 555 048
Tekninen tuki: 1800 555 061

Italia

Tilaukset: 02 33430411
Faksi: 02 33430426
Tekninen tuki: 800 787980

Japani

Puhelin: 03 5547 0811
Faksi: 03 5547 0818
Tekninen tuki: 03 5547 0811

Korea (Etelä)

Tilaukset: 1544 7145
Faksi: 1544 7146
Tekninen tuki: 1544 7145

Luxemburg

Tilaukset: 8002 2076
Faksi: 8002 2073
Tekninen tuki: 8002 2067

Alankomaat

Tilaukset: 0800 0229592
Faksi: 0800 0229593
Tekninen tuki: 0800 0229602

Norja

Tilaukset: 800 18859
Faksi: 800 18817
Tekninen tuki: 800 18712

Singapore

Tilaukset: 65 67775366
Faksi: 65 67785177
Tekninen tuki: 65 67775366

Espanja

Tilaukset: 91 630 7050
Faksi: 91 630 5145
Tekninen tuki: 91 630 7050

Ruotsi

Tilaukset: 020 790282
Faksi: 020 790582
Tekninen tuki: 020 798328

Sveitsi

Tilaukset: 055 254 22 11
Faksi: 055 254 22 13
Tekninen tuki: 055 254 22 12

Iso-Britannia

Tilaukset: 01293 422 911
Faksi: 01293 422 922
Tekninen tuki: 01293 422 999

USA

Tilaukset: 800 426 8157
Faksi: 800 718 2056
Tekninen tuki: 800 DNA PREP
(800 362 7737)

Tube pour ADN sanguin

FR – Français

I. Utilisation prévue

Le tube pour ADN sanguin PAXgene est conçu pour prélever, anticoaguler, stabiliser, transporter et stocker un échantillon de sang veineux total à des fins de préparation d'ADN de haute qualité, à utiliser dans les méthodes de tests diagnostics moléculaires qui nécessitent de l'ADN.

Les caractéristiques de performance de ce dispositif n'ont pas été établies pour les essais diagnostics moléculaires en général. Les utilisateurs doivent valider l'utilisation du produit pour leur essai diagnostic moléculaire particulier.

Caractéristiques du produit

Tube pour ADN sanguin PAXgene • 2,5 ml • 13 x 75 mm • additif : K₂EDTA
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 tubes/boîte groupée • 1000 tubes/carton

II. Résumé et explication

Le tube pour ADN sanguin PAXgene permet de prélever du sang total afin d'isoler l'ADN génomique dans un système fermé sous vide. Le sang est prélevé selon un protocole standard de phlébotomie dans un tube sous vide contenant du K₂EDTA comme additif. L'isolement complet de l'ADN est réalisé par des méthodes manuelles ou automatisées telles que la précipitation par salage, les billes magnétiques ou les technologies basées sur la membrane de silice.

III. Avertissements

Le contenu de ce tube est irritant pour la peau.


- En cas d'inhalation, respirer de l'air frais.
- En cas de contact avec la peau, rincer immédiatement et abondamment la peau à l'eau savonneuse pendant 15 minutes au moins.
- En cas de contact oculaire, rincer immédiatement et abondamment à l'eau pendant 15 minutes au moins.
- En cas d'ingestion, boire immédiatement une grande quantité d'eau. Consulter un médecin.

IV. Prélèvement et préparation des échantillons pour analyse

A. Accessoires requis pour le prélèvement sanguin (non inclus avec le tube pour ADN sanguin PAXgene)

1. Aiguille de prélèvement sanguin telle que les aiguilles BD Vacutainer® Eclipse™ ou BD Vacutainer Eclipse Signal™. Voir les informations relatives à la commande.
2. Un corps de prélèvement BD Vacutainer doit être utilisé pour assurer le bon fonctionnement du dispositif. Voir les informations relatives à la commande.
3. Des étiquettes pour l'identification positive des donneurs d'échantillons, si nécessaire.
4. Tampon imbibé d'alcool pour le nettoyage du site.
5. Gaze sèche et stérile.
6. Garrot.
7. Conteneur d'aiguilles pour aiguilles usagées ou combinaison aiguille/support.

B. Procédure de prélèvement d'échantillon



Instructions générales

PORTER DES GANTS PENDANT LA PONCTION VEINEUSE ET DURANT LA MANIPULATION DES TUBES DE PRÉLÈVEMENT SANGUIN AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'EXPOSITION.

1. Assembler l'aiguille dans le corps de prélèvement. Veiller à ce que l'aiguille soit solidement fixée de manière à ce qu'elle ne se désenfile pas pendant l'utilisation.
2. Placer le tube dans le corps de prélèvement. Remarque : Ne pas perforer le bouchon.
3. Sélectionner le site de ponction veineuse.
4. **Poser le garrot. Préparer le site de ponction veineuse avec un antiseptique approprié. NE PAS PALPER LE SITE DE PONCTION VEINEUSE APRÈS LE NETTOYAGE.**
5. Orienter le bras du patient vers le bas.
6. Retirer le protecteur de l'aiguille. Effectuer la ponction veineuse **AVEC LE BRAS VERS LE BAS ET LE BOUCHON DU TUBE À LA POSITION LA PLUS ÉLEVÉE.**
7. Centrer les tubes dans le corps de prélèvement au moment de perforer le bouchon pour empêcher la pénétration de la paroi latérale et la perte d'aspiration prématurée qui s'ensuit. Pousser le tube sur l'aiguille en perforant la membrane du bouchon.
8. **RETIRER LE GARROT DÈS L'APPARITION DU SANG DANS LE TUBE. FAIRE EN SORTE QUE LE CONTENU DU TUBE NE TOUCHE NI LE BOUCHON NI LA POINTE DE L'AIGUILLE PENDANT LA PROCÉDURE.**

Remarque : Du sang peut parfois fuir du manchon d'aiguille. Adopter des précautions universelles pour réduire le risque d'exposition. Si le sang ne s'écoule pas dans le tube ou qu'il arrête de s'écouler avant le prélèvement d'un échantillon adéquat, les mesures suivantes sont recommandées pour terminer le prélèvement de manière satisfaisante :

- a. Pousser le tube en avant jusqu'à ce que l'aiguille perce-bouchon pénètre dans le tube. Si nécessaire, le tenir en place pour garantir l'aspiration totale du vide.
 - b. Confirmer la position correcte de l'aiguille dans la veine.
9. Lorsque le tube est rempli jusqu'au volume indiqué et que le sang ne s'écoule plus, retirer le tube du corps de prélèvement.
 10. Retourner 8 fois.
 11. Retirer l'aiguille de la veine, en appliquant une pression sur le site de ponction avec un tampon stérile sec jusqu'à ce que le saignement cesse.
 12. Une fois que la coagulation se produit, appliquer un pansement si souhaitable.
 13. Après la ponction veineuse, la partie supérieure du bouchon peut contenir du sang résiduel. Prendre des précautions adéquates lors de la manipulation des tubes pour éviter un contact avec ce sang.
 14. Jeter l'aiguille et le corps de prélèvement conformément au protocole et aux directives de l'établissement.
 15. Conserver le tube pour ADN sanguin PAXgene rempli à température ambiante (18-25 °C). Voir les caractéristiques de performance de stabilité de l'ADN dans les échantillons sanguins à température ambiante (18-25 °C), 2-8 °C, ou -20 °C.

Pour plus de détails, voir la procédure de congélation et de décongélation des échantillons dans les tubes pour ADN sanguin PAXgene si la température de conservation de -70 °C/-80 °C est choisie.

(Suite)

Les techniques suivantes seront utilisées pour prévenir un reflux possible :

- Orienter le bras du donneur vers le bas.
- Tenir le tube avec le bouchon à la position la plus élevée.
- Retirer le garrot dès que le sang commence à s'écouler dans le tube.
- Veiller à ce que les additifs du tube ne touchent pas le bouchon ou la pointe de l'aiguille durant la ponction veineuse.

C. Procédure de congélation et de décongélation des échantillons prélevés dans des tubes pour ADN sanguin PAXgene

- Poser le tube pour ADN sanguin PAXgene à la verticale dans un portoir métallique. **Ne pas congeler les tubes à la verticale dans un plateau en mousse de polystyrène Styrofoam™, car cela risquerait de fissurer les tubes.**
- Les tubes pour ADN sanguin PAXgene peuvent être conservés à -20 °C et au-dessous. Si les tubes doivent être conservés à des températures inférieures à -20 °C, les congeler d'abord à -20 °C pendant 24 heures, puis les transférer dans un congélateur à -70 °C ou -80 °C.
- Décongeler les tubes pour ADN sanguin PAXgene dans un portoir métallique à température ambiante (18-25 °C) pendant deux heures environ. **Ne pas décongeler les tubes pour ADN sanguin PAXgene à des températures supérieures à 25 °C.**
- Retourner soigneusement à 10 reprises les tubes pour ADN sanguin PAXgene décongelés.

Remarque : Une fois congelés, les tubes pour ADN sanguin PAXgene sont susceptibles de se rompre s'ils subissent un choc. Pour réduire le risque de rupture pendant l'expédition, les tubes congelés doivent être traités de la même manière que des tubes en verre. Les utilisateurs doivent valider leur propre protocole de congélation et d'expédition pour les tubes pour ADN sanguin PAXgene.

D. Procédure de préparation des échantillons pour analyse

Les échantillons de sang doivent être traités conformément aux instructions fournies avec le kit de préparation des échantillons d'ADN. Pour voir des exemples, se reporter aux Informations relatives à la commande.

V. Caractéristiques de performance

Après l'introduction du sang dans le tube, l'ADN reste stable pendant 14 jours à 18-25 °C (Figure 1). Selon les études de stabilité de l'ADN, le sang peut être stocké dans le tube pendant 14 jours à 18-25 °C, 28 jours à 2-8 °C, 3 jours à 35 °C, ou pendant un minimum de 6 mois à -20 °C avec une concentration d'ADN $\geq 12,5$ ng/ μ l et une pureté de l'ADN (A_{260}/A_{280}) de 1,7-1,9.

Pour obtenir les informations les plus récentes à propos de la stabilité des échantillons congelés, consulter le site www.PreAnalytiX.com.

Stabilité de l'ADN dans les échantillons de sang entre 18 et 25 °C

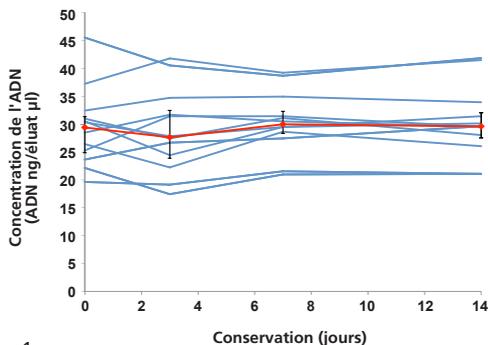


Figure 1

Du sang a été prélevé sur 12 donneurs adultes consentants et conservé entre 18 et 25 °C pendant le nombre de jours indiqué, avant de subir une purification de l'ADN total. Le sang a été prélevé et conservé dans des tubes pour ADN sanguin PAXgene, et l'ADN total a été purifié à l'aide du minikit QIAGEN® QIASymphony® DSP pour ADN sur l'instrument automatisé QIAGEN QIASymphony.

VI. Limites

1. La quantité de sang prélevée doit être de 2,5 ml par tube pour ADN sanguin PAXgene, mais ce volume peut varier en fonction de l'altitude, de la température ambiante, de la pression barométrique, de l'âge du tube, de la pression veineuse et de la technique de remplissage.

VII. Précautions

1. Adopter des précautions universelles. Utiliser des gants, blouses, lunettes de protection et autre équipement de protection individuelle ainsi que des moyens mécaniques pour se protéger des projections de sang, des fuites de sang et de l'exposition éventuelle aux pathogènes à diffusion hématogène.
2. Manipuler tous les échantillons biologiques et les dispositifs piquants/tranchants de prélèvement sanguin conformément aux réglementations et procédures en vigueur dans l'établissement. S'adresser à un médecin en cas d'exposition à des échantillons biologiques (par exemple, une blessure provoquée par une piqûre d'aiguille), car ils peuvent transmettre une hépatite virale, le SIDA (VIH) ou d'autres maladies infectieuses.


Utiliser le protecteur d'aiguille intégré, si le dispositif de prélèvement sanguin en est pourvu. PreAnalytiX déconseille de remettre les aiguilles usagées dans leur protecteur. Toutefois, les protocoles et les procédures de l'établissement peuvent différer et doivent toujours être observés.

3. Jeter tous les tubes de prélèvement sanguin dans des collecteurs pour objets contaminés homologués pour leur mise au rebut.
4. Ne pas réutiliser les tubes pour ADN sanguin PAXgene.
5. Ne pas utiliser les tubes pour ADN sanguin PAXgene après la date de péremption imprimée sur l'étiquette du tube.
6. Une force centrifuge excessive (plus de 10 000 FCR) peut provoquer la rupture du tube pour ADN sanguin PAXgene, une exposition au sang et des blessures éventuelles.
7. Ne pas transférer un échantillon d'une seringue dans un tube.

VIII. Conservation


1. Conserver les tubes pour ADN sanguin PAXgene non utilisés entre 18 et 25 °C. Des augmentations limitées de température jusqu'à 40°C sont admises. Ne pas utiliser les tubes après la date de péremption.

IX. Instructions pour le retrait du bouchon BD Hemogard



1. Saisir le tube pour ADN sanguin PAXgene d'une main en plaçant le pouce sous le bouchon BD Hemogard (pour plus de stabilité, poser le bras sur une surface solide). De l'autre main, tourner le bouchon BD Hemogard tout en le repoussant simultanément avec le pouce de l'autre main, mais **UNIQUEMENT JUSQU'À CE QUE LE BOUCHON DU TUBE SE DÉVISSE.**
2. Retirer le pouce avant de soulever le bouchon. **NE PAS** utiliser le pouce pour soulever le bouchon du tube. Si le tube contient du sang, il existe un risque d'exposition. Pour contribuer à éviter toute blessure pendant le retrait du bouchon, il est important que le pouce utilisé pour repousser le bouchon soit retiré du tube dès que le bouchon BD Hemogard est dévissé.
3. Soulever le bouchon du tube. Dans le cas improbable où la jupe en plastique se détacherait du bouchon en caoutchouc, **NE PAS REMONTER LE BOUCHON.** Retirer délicatement le bouchon en caoutchouc du tube.

X. Instructions pour la réintroduction du bouchon BD Hemogard



1. Remettre le bouchon sur le tube.
2. Tourner et appuyer fermement jusqu'à ce que le bouchon soit complètement réintroduit. Le bouchon doit être réintroduit en entier pour qu'il reste bien en place sur le tube pendant la manipulation.

Assistance technique

Pour toute question concernant le tube pour ADN sanguin PAXgene, contacter l'un des départements des services techniques BD répertoriés page 72 dans la section BD – Service à la clientèle.

Produits PAXgene

Informations relatives à la commande

Tube pour ADN sanguin PAXgene / 761165

Contenu : 1000 tubes de prélèvement sanguin.

Produits BD*

Aiguille de prélèvement sanguin BD Vacutainer Eclipse / 368609 CE

Contenu : Aiguille 21G 1¼ po, 0,8 x 32 mm, 48/boîte, 480/carton

Aiguille de prélèvement sanguin BD Vacutainer Eclipse avec corps de prélèvement préassemblé / 368650

Contenu : Aiguille 21G 1¼ po, 0,8 x 32 mm, 100/carton

Aiguille de prélèvement sanguin BD Vacutainer Eclipse Signal / 368835 CE

Contenu : Aiguille 21G 1¼ po, 0,8 x 32 mm, 50/boîte, 400/carton

Corps de prélèvement à usage unique BD Vacutainer / 364815

Contenu : Carton seulement pour les corps de prélèvement de 13 et 16 mm de diamètre, 1000/carton

* Ces numéros de référence correspondent à des produits courants qui peuvent être utilisés avec le tube pour ADN sanguin PAXgene.

Pour commander des accessoires de prélèvement sanguin BD :

Consulter le site : <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Sélectionner le pays • Défiler jusqu'à BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Composer le numéro

Produits QIAGEN*

Kit QIAGEN QIASymphony DSP pour ADN / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Contenu : Cartouche de réactif, portoir pour enzyme, bouchon percable, tampon ATE, jeu de bouchons réutilisables

Kit QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini / 61104 (50)

Contenu : Mini colonnes de centrifugation QIAamp, tubes de prélèvement, tampon AL, tampon ATL, tampon AW1, tampon AW2, tampon AE, protéase QIAGEN, solvant pour protéase

Kit sanguin QIAGEN Gentra® Puregene® / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Contenu : Solution de lyse des érythrocytes, solution de lyse des globules, solution de précipitation des protéines, solution d'hydratation de l'ADN, solution RNase A

* Ces numéros de référence correspondent à des produits courants de préparation de l'ADN qui peuvent être utilisés avec le tube pour ADN sanguin PAXgene.

Pour commander des kits de préparation d'ADN QIAGEN :

Consulter le site : <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

Le tube pour ADN sanguin PAXgene est fabriqué au Royaume-Uni par BD pour PreAnalytiX GmbH. PAXgene et PreAnalytiX sont des marques de commerce de PreAnalytiX GmbH ; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene sont des marques de commerce de QIAGEN NV ; Styrofoam est une marque de commerce de The Dow Chemical Company ; toutes les autres marques de commerce sont la propriété de Becton, Dickinson and Company.

(Suite)

BD – Service à la clientèle

Argentine, Uruguay et Paraguay

Commandes : 011.4551.7100
E-mail : crc_argentina@bd.com

Australie

Commandes : 1.800.656.100
Télécopie : 1.800.656.110
E-mail : bd_anz@bd.com

Autriche

Commandes : 43.1.7063660
Télécopie : 43.1.7063660-11

Belgique

Commandes : 32.53.720.556
Télécopie : 32.53.720.549

Brésil

Commandes : 0800.055.5654
E-mail : consultoria_vacutainer@bd.com

Canada

Commandes : 800.268.5430
Télécopie : 800.565.0897
E-mail : custsvccan@bd.com

Danemark

Commandes : 45.43.43.45.66
Télécopie : 45.43.96.56.76
E-mail : bdcg_dk@europe.bd.com

Europe de l'Est

Commandes : 48.22.651.75.88
Télécopie : 48.22.651.75.89

Finlande

Commandes : 358.9.88.70.780
Télécopie : 358.9.88.70.7816
E-mail : bdorder_finland@europe.bd.com

France

Commandes : 33.476.689496
Télécopie : 33.476.683693
E-mail : BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Allemagne

Commandes : 49.622130553
Télécopie : 49.6221305379

Italie

Commandes : 39.02.48.240.500
Télécopie : 39.02.48.240.344
Assistance technique : 39.02.48.240.264
E-mail : ordini_medicale@europe.bd.com

Moyen-Orient et Afrique (EMA)

Commandes : 971.4.3379525
Télécopie : 971.4.03379551
E-mail : EMA_PAS@bd.com

Pays-Bas

Commandes : 31.20.6545.716
Télécopie : 31.20.5829.421
E-mail : vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Nouvelle-Zélande

Commandes : 0800.572.468
Télécopie : 0800.572.469
E-mail : bd_anz@bd.com

Norvège :

Commandes : 47.73.59.12.00
Télécopie : 47.73.59.12.01

Espagne

Commandes : 34.902.27.17.27
Télécopie : 34.91.848.81.04
E-mail : servicio_de_clientes@bd.com

Suède

Commandes : 46.8.775.51.60
Télécopie : 46.8.775.51.95
E-mail : bdorder_sweden@europe.bd.com

Suisse

Commandes : 41.61.4852222
Commandes : 41.61.4852200

Royaume-Uni

Commandes : 44.1.865.781.666
Télécopie : 44.1.865.717.313
E-mail : bduk_customerservice@europe.bd.com

États-Unis

Commandes : 888.237.2762
Télécopie : 800.847.2220
Assistance technique : 800.631.0174
E-mail : www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Service à la clientèle

Australie

Commandes : 03.9840.9800
Télécopie : 03.9840.9888
Assistance technique : 1.800.243.066

Autriche

Commandes : 0800/28.10.10
Télécopie : 0800/28.10.19
Assistance technique : 0800/28.10.11

Belgique

Commandes : 0800.79612
Télécopie : 0800.79611
Assistance technique : 0800.79556

Canada

Commandes : 800.572.9613
Télécopie : 800.713.5951
Assistance technique : 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Chine

Commandes : 0086.21.3865.3865
Télécopie : 0086.21.3865.3965
Assistance technique : 800.988.0325 / 800.988.0327

Danemark

Commandes : 80.885945
Télécopie : 80.885944
Assistance technique : 80.885942

Finlande

Commandes : 0800.914416
Télécopie : 0800.914415
Assistance technique : 0800.914413

France

Commandes : 01.60.920.926
Télécopie : 01.60.920.925
Assistance technique : 01.60.920.930
Offres : 01.60.920.928

Allemagne

Commandes : 02103.29.12000
Télécopie : 02103.29.22000
Assistance technique : 02103.29.12400

Hong Kong

Commandes : 800.933.965
Télécopie : 800.930.439
Assistance technique : 800.930.425

Irlande

Commandes : 1800.555.049
Télécopie : 1800.555.048
Assistance technique : 1800.555.061

Italie

Commandes : 02.33430411
Télécopie : 02.33430426
Assistance technique : 800.787980

Japon

Téléphone : 03.5547.0811
Télécopie : 03.5547.0818
Assistance technique : 03.5547.0811

Corée (du Sud)

Commandes : 1544.7145
Télécopie : 1544.7146
Assistance technique : 1544.7145

Luxembourg

Commandes : 8002.2076
Télécopie : 8002.2073
Assistance technique : 8002.2067

Pays-Bas

Commandes : 0800.0229592
Télécopie : 0800.0229593
Assistance technique : 0800.0229602

Norvège

Commandes : 800.18859
Télécopie : 800.18817
Assistance technique : 800.18712

Singapour

Commandes : 65.67775366
Télécopie : 65.67785177
Assistance technique : 65.67775366

Espagne

Commandes : 91.630.7050
Télécopie : 91.630.5145
Assistance technique : 91.630.7050

Suède

Commandes : 020.790282
Télécopie : 020.790582
Assistance technique : 020.798328

Suisse

Commandes : 055.254.22.11
Télécopie : 055.254.22.13
Assistance technique : 055.254.22.12

Royaume-Uni

Commandes : 01293.422.911
Télécopie : 01293.422.922
Assistance technique : 01293.422.999

États-Unis

Commandes : 800.426.8157
Télécopie : 800.718.2056
Assistance technique : 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Epruveta za prikupljanje DNA iz krvi

HR – Hrvatski

I. Namjena

PAXgene epruveta za prikupljanje DNA iz krvi predviđena je za prikupljanje, antikoaguliranje, stabiliziranje, prijenos i pohranjivanje uzorka pune krvi iz vena radi pripreme DNA visoke kvalitete za upotrebu u molekularnim dijagnostičkim ispitivanjima za koje je potrebna DNA.

Općenito, karakteristike rada ove naprave nisu utvrđene za analize molekularne dijagnostike. Korisnici moraju potvrditi upotrebu proizvoda za njihovu specifičnu analizu molekularne dijagnostike.

Značajke proizvoda

PAXgene epruveta za prikupljanje DNA iz krvi • 2,5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA aditiv
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 epruveta po kartonu • 1.000 epruveta po kutiji

II. Sažetak i objašnjenje

PAXgene epruveta za prikupljanje DNA iz krvi sredstvo je za prikupljanje pune krvi za izolaciju genomske DNA u zatvorenom, evakuiranom sustavu. Krv se prikuplja prema standardnom protokolu za puštanje krvi u epruvetu s podtlakom koja sadrži K₂EDTA aditiv. Potpuna izolacija DNA izvodi se pomoću ručnih ili automatiziranih metoda kao što su izlučivanje isoljavanjem, magnetske kuglice ili tehnologije na bazi silikonske membrane.

III. Upozorenja

Sadržaj ove epruvete nadražuje kožu.


- Nakon udisanja, premjestite izloženu osobu na svježi zrak.
- U slučaju dodira s kožom, odmah isperite obilnom količinom otopine sapuna u vodi u trajanju od barem 15 minuta.
- U slučaju dodira s očima, odmah isperite obilnom količinom vode u trajanju od barem 15 minuta.
- U slučaju gutanja, odmah popijte velike količine vode. Potražite liječničku pomoć.

IV. Prikupljanje i priprema uzorka za analizu

A. Potrebna dodatna oprema za prikupljanje krvi (nije isporučena s PAXgene epruvetom za prikupljanje DNA iz krvi)

1. Igla za prikupljanje krvi, kao što su BD Vacutainer® Eclipse™ ili BD Vacutainer Eclipse Signal™ igla za prikupljanje krvi. Pogledajte informacije o narudžbi.
2. Da bi se osigurao propisani način rada, mora se upotrebljavati BD Vacutainer držač igle. Pogledajte informacije o narudžbi.
3. Oznake za pozitivnu identifikaciju donatora prema uzorcima, ako je potrebno
4. Blazinica natopljena alkoholom za čišćenje mjesta uboda
5. Suha, sterilna gaza
6. Čvrsti podvez
7. Posuda za odlaganje rabljenih igala ili kombinacije igle/držača

B. Postupak za prikupljanje uzorka



Općenite upute

KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD IZLOŽENOSTI, TIJEKOM PUNKCIJE VENE IMAJTE NA SEBI RUKAVICE ISTO KAO I KOD RUKOVANJA EPRUVETAMA ZA PRIKUPLJANJE KRVI.

1. Stavite iglu u držač. Obavezno provjerite je li igla čvrsto umetnuta kako biste bili sigurni da se igla tijekom upotrebe ne odvoji.
2. Stavite epruvetu u držač. Napomena: Nemojte probušiti čep.
3. Odaberite mjesto za punkciju vene.
- 4. Stavite čvrsti podvez. Pripremite mjesto punkcije vene s odgovarajućim antiseptikom. NAKON ČIŠĆENJA NEMOJTE OPIPAVATI MJESTO PUNKCIJE VENE.**
5. Položite ruku pacijenta prema dolje.
6. Uklonite štitnik igle. Izvršite punkciju vene S RUKOM PREMA DOLJE I ČEPOM EPRUVETE GORE.
7. Prilikom penetraciju u čep centrirajte epruvete u držaču da biste spriječili bočnu penetraciju i posljedični prerani gubitak vakuuma. Gurnite epruvetu na iglu, čime ćete probiti membranu na čepu.
- 8. UKLONITE ČVRSTI PODVEZ ČIM SE KRV POJAVI U EPRUVETI. NEMOJTE DOPUSTITI DA TIJEKOM IZVOĐENJA POSTUPKA SADRŽAJ EPRUVETE DOĐE U KONTAKT S ČEPOM ILI ZAVRŠETKOM IGLE.**

Napomena: Povremeno može doći do curenja krvi iz naglavka igle. Kako biste smanjili opasnost od izloženosti, primijenite opće mjere opreza. Ako u epruvetu ne teče krv ili krv prestane teći prije nego je prikupljen odgovarajući uzorak krvi, predložimo sljedeće korake za završavanje uspješnog prikupljanja:

- a. Gurnite epruvetu prema naprijed tako da penetrirate čep. Po potrebi držite čvrsto na mjestu kako biste osigurali potpuno prikupljanje u vakuumu.
 - b. Uvjerite se da je igla u veni u ispravnom položaju.
9. Kada je epruveta napunjena do navedenog volumena i prestane teći krv, uklonite je iz držača.
 10. Preokrenite je 8 puta.
 11. Izvadite iglu iz vene pritiskujući mjesto uboda suhom, sterilnom blazinicom dok se krvarenje ne zaustavi.
 12. Kada dođe do zgrušavanja, po želji možete staviti povez.
 13. Nakon punkcije vene u vrhu čepa može biti ostataka krvi. Poduzmite odgovarajuće mjere opreza kada rukujete s epruvetama kako biste izbjegli kontakt s tom krvlju.
 14. Odložite iglu i držač u skladu s pravilima i smjernicama vaše ustanove.
 15. Pohranite napunjenu PAXgene epruvetu za prikupljanje DNA iz krvi na sobnoj temperaturi (18-25°C). Pogledajte Karakteristike rada za stabilnost DNA u uzorcima krvi na sobnoj temperaturi (18-25°C), 2-8°C ili -20°C.

Pogledajte Postupak zamrzavanja i otapanja uzoraka u PAXgene epruveti za prikupljanje DNA iz krvi za pojediniosti ako je potrebna temperatura skladištenja od -70°C / -80°C.

Primijenite sljedeće tehnike za prevenciju mogućeg povratnog protoka:

- a. Položite ruku donora prema dolje.
- b. Držite epruvetu sa zatvaračem pri vrhu.
- c. Otpustite čvrsti podvez čim krv počne istjecati u epruvetu.
- d. Obavezno provjerite da aditivi u epruveti ne dodiruju zatvarač ili kraj igle tijekom punkcije vene.

(nastavlja se)

C. Postupak zamrzavanja i otapanja uzoraka u PAXgene epruvetama za prikupljanje DNA iz krvi

1. Postavite PAXgene epruvetu za prikupljanje DNA iz krvi uspravno u žičanoj polici. **Nemojte zamrzavati epruvete u uspravnom položaju u ladici od stiropora Styrofoam™ jer to može uzrokovati pucanje epruveta.**
2. PAXgene epruvete za prikupljanje DNA iz krvi mogu se pohranjivati na -20°C i niže. Ako epruvete treba čuvati na temperaturama ispod -20°C, prvo ih zamrznete na -20°C u trajanju od 24 sata, a zatim ih preselite na -70°C ili -80°C.
3. Odmrzavajte PAXgene epruvete za prikupljanje DNA iz krvi u žičanoj rešetki na temperaturi okoline (18-25°C) približno dva sata. **PAXgene epruvete za prikupljanje DNA iz krvi nemojte otapati na temperaturama iznad 25°C.**
4. Pažljivo 10 puta preokrenite odmrznute PAXgene epruvete za prikupljanje DNA iz krvi.

Napomena: Zamrznute PAXgene epruvete za prikupljanje DNA iz krvi mogu se polomiti u slučaju udarca. Da biste smanjili rizik od lomova tijekom otpreme, zamrznute epruvete tretirajte na isti način kao i staklene. Korisnici moraju potvrditi vlastiti protokol za zamrzavanje i otpremu za PAXgene epruvete za prikupljanje DNA iz krvi.

D. Postupak pripreme uzorka za analizu


Uzorci krvi moraju se obraditi u skladu s uputama priloženima u kompletu za pripremu DNA uzorka. Primjere možete pronaći u Informacijama o narudžbi.

V. Karakteristike rada

Nakon uvođenja krvi u epruvetu, DNA će ostati stabilna 14 dana na temperaturama 18-25°C (slika 1). Temeljem studija stabilnosti DNA, krv se može čuvati u epruveti u trajanju od 14 dana na temperaturama 18–25 °C, 28 dana na temperaturama 2–8 °C, 3 dana na temperaturi 35 °C ili najmanje 6 mjeseca na temperaturama -20 °C s DNA koncentracijom $\geq 12,5$ ng/ μ l i čistoćom DNA (A_{260}/A_{280}) od 1,7–1,9.

Najnovije podatke o stabilnosti zamrznutih uzoraka potražite na www.PreAnalytiX.com.

Stabilnost DNA u uzorcima krvi na temperaturama 18-25°C

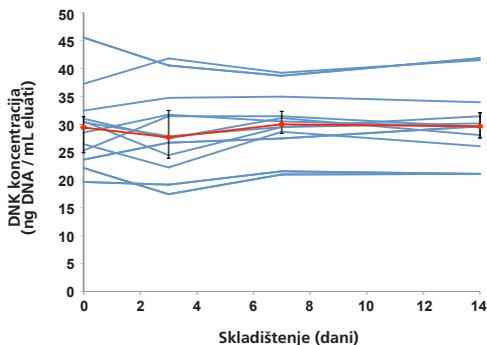

Slika 1

Krv je prikupljena od 12 dragovoljnih odraslih donora i pohranjena na 18-25°C na navedeni broj dana nakon čega je uslijedilo pročišćavanje ukupne DNA. Krv je prikupljena i pohranjena u PAXgene epruvete za prikupljanje DNA iz krvi, a ukupna DNA je pročišćena primjenom QIAGEN® QIASymphony® DSP DNA Mini kompleta na automatiziranom instrumentu QIAGEN QIASymphony.

VI. Ograničenja

1. Količina prikupljene krvi treba iznositi 2,5 ml po PAXgene epruveti za prikupljanje DNA iz krvi, ali taj volumen može ovisiti o nadmorskoj visini, temperaturi okoline, tlaku zraka, starosti epruvete, venskom tlaku i tehničkoj punjenju.

(nastavlja se)

VII. Mjere opreza

1. Primjenjujte opće prihvaćene mjere opreza. Upotrebljavajte rukavice, pregače, zaštitu za oči, ostalu zaštitnu opremu i kontrole na uređaju koje će vas zaštititi od prskanja krvi, curenja krvi i potencijalne izloženosti patogenima koji se prenose krvlju.
2. Pri rukovanju svim biološkim uzorcima i oštrim predmetima kompleta za prikupljanje krvi, pridržavajte se pravilnika i procedura ustanove u kojoj radite. U slučaju izlaganja biološkim uzorcima (primjerice, ozljede uslijed uboda), potražite odgovarajuću medicinsku pomoć budući da se putem uzorka mogu prenijeti virusni hepatitis, HIV (SIDA) i druge zarazne bolesti.


Upotrijebite svaki ugrađeni zaštitnik igle, ako je isporučen uz komplet za prikupljanje krvi. PreAnalytiX ne preporučuje ponovno stavljanje zaštite na iskorištene igle. Međutim, pravila i postupci u vašoj ustanovi možda su različiti i uvijek morate postupati u skladu s njima.

3. Sve epruvete za prikupljanje krvi odložite u spremnike za biološki otpad čija je uporaba odobrena za tu namjenu.
4. Nemojte ponovno upotrebljavati PAXgene epruvete za prikupljanje DNA iz krvi.
5. Nemojte upotrebljavati PAXgene epruvete za prikupljanje DNA iz krvi nakon datuma isteka valjanosti ispisanog na naljepnici epruvete.
6. Prekomjerna brzina centrifugiranja (više od 10.000 RCF) može uzrokovati pucanje PAXgene epruvete za prikupljanje DNA iz krvi, izloženost krvi i moguću ozljedu.
7. Nemojte prenositi uzorak iz štrcaljke u epruvetu.

VIII. Čuvanje

1. Nekorištene PAXgene epruvete za prikupljanje DNA iz krvi čuvajte na temperaturama 18-25°C. Dozvoljene su ograničene povremene promjene temperature do 40°C. Ne koristite epruvete ako im je istekao rok uporabe.


IX. Upute za uklanjanje BD Hemogard zatvarača



1. Jednom rukom uhvatite PAXgene epruvetu za prikupljanje DNA iz krvi s palcem položenim ispod BD Hemogard zatvarača. (Radi dodatne stabilnosti položite ruku na krutu površinu). Drugom rukom zaokrenite BD Hemogard zatvarač i istovremeno ga gurajte prema gore s palcem druge ruke **SVE DOK SE NE OLABAVI ZATVARAČ EPRUVETE.**

2. Prije podizanja zatvarača odmaknite palac. **NEMOJTE** upotrebljavati palac kako biste odgurnuli zatvarač s epruvete. Ako u epruveti ima krvi, postoji opasnost od izloženosti. Da biste pomogli spriječiti ozljeđivanje tijekom uklanjanja zatvarača, važno je da palac koji koristite za potiskivanje zatvarača prema gore odmaknete s epruvete odmah kada BD Hemogard zatvarač postane opušten.
3. Podignite zatvarač s epruvete. Ako se plastični štitnik odvoji od gumenog čepa, što je malo vjerojatno, **NEMOJTE PONOVO POSTAVLJATI ZATVARAČ.** Pažljivo skinite gumeni čep s epruvete.

X. Upute za ponovno postavljanje BD Hemogard zatvarača



1. Zamijenite zatvarač na epruveti.
2. Zaokrenite i čvrsto potisnite prema dolje dok čep u potpunosti ne sjedne u otvor. Ponovno umetanje čepa do kraja nužno je kako bi zatvarač ostao pričvršćen na epruveti tijekom rukovanja.

Tehnička podrška

Ako imate pitanja u vezi PAXgene epruvete za prikupljanje DNA iz krvi, obratite se BD službi za tehničke usluge koje su navedene u odjeljku BD – služba za korisnike.

Podaci za naručivanje

PAXgene proizvodi

PAXgene epruveta za prikupljanje DNA iz krvi / 761165

Sadržaj: 1.000 epruveta za prikupljanje krvi.

BD proizvodi*

BD Vacutainer Eclipse igla za prikupljanje krvi / 368609 CE

Sadržaj: 21G 1¼" inčna igla , 0,8 mm x 32 mm, 48 po kutiji, 480 po pakiranju

BD Vacutainer Eclipse igla za prikupljanje krvi s unaprijed postavljenim držačem / 368650

Sadržaj: 21G 1¼" inčna igla , 0,8 mm x 32 mm, 100 po kutiji

BD Vacutainer Eclipse Signal igla za prikupljanje krvi / 368835 CE

Sadržaj: 21G 1¼" inčna igla , 0,8 mm x 32 mm, 50 po kutiji, 400 po pakiranju

BD Vacutainer jednokratni držač / 364815

Sadržaj: Pakiranje samo za promjer 13 mm i 16 mm, 1000 po kutiji

* Ovi kataloški brojevi predstavljaju tipične proizvode koji se mogu upotrebljavati s PAXgene epruvetom za prikupljanje DNA iz krvi.

Naručivanje BD dodatne opreme za prikupljanje krvi:

Idite na: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Odaberite državu • Listajte prema dolje do BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Birajte broj

QIAGEN proizvodi*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA komplet / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Sadržaj: Punjenje reagensa, rešetka s enzimima, poklopac za bušenje, spremnik ATE, komplet višekratnih brtvi

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Sadržaj: QIAamp Mini stupovi za okretanje, epruvete za prikupljanje, spremnik AL, spremnik ATL, spremnik AW1, spremnik AW2, spremnik AE, QIAGEN proteaza, otopina proteaze

QIAGEN Gentra® Puregene® komplet za prikupljanje krvi / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Sadržaj: RBC otopina za liziju, otopina za liziju stanica, otopina za izlučivanje bjelančevina, otopina za hidraciju DNA, RNase A otopina

* Ovi kataloški brojeve predstavljaju tipične komplete za pripremu DNA koji se mogu upotrebljavati s PAXgene epruvetom za prikupljanje DNA iz krvi.

Naručivanje QIAGEN DNA kompleta za pripremu:

Idite na: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

PAXgene epruveta za prikupljanje DNA iz krvi u UK proizvodi BD za tvrtku PreAnalytiX GmbH. PAXgene i PreAnalytiX trgovački su znakovi tvrtke PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene su trgovački znakovi tvrtke QIAGEN NV; Styrofoam je trgovački znak tvrtke The Dow Chemical Company; svi ostali trgovački znakovi vlasništvo su tvrtke Becton, Dickinson and Company.

(nastavlja se)

BD – služba za korisnike

Argentina, Urugvaj i Paragvaj

Narudžbe: 011.4551.7100

E-pošta: crc_argentina@bd.com

Australija

Narudžbe: 1.800.656.100

Telefaks: 1.800.656.110

E-pošta: bd_anz@bd.com

Austrija

Narudžbe: 43.1.7063660

Telefaks: 43.1.7063660-11

Belgija

Narudžbe: 32.53.720.556

Telefaks: 32.53.720.549

Brazil

Narudžbe: 0800.055.5654

E-pošta: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Narudžbe: 800.268.5430

Telefaks: 800.565.0897

E-pošta: custsvccan@bd.com

Danska

Narudžbe: 45.43.43.45.66

Telefaks: 45.43.96.56.76

E-pošta: bdcs_dk@europe.bd.com

Istočna Europa

Narudžbe: 48.22.651.75.88

Telefaks: 48.22.651.75.89

Finska

Narudžbe: 358.9.88.70.780

Telefaks: 358.9.88.70.7816

E-pošta: bdorder_finland@europe.bd.com

Francuska

Narudžbe: 33.476.689496

Telefaks: 33.476.683693

E-pošta: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Njemačka

Narudžbe: 49.6221305553

Telefaks: 49.6221305379

Italija

Narudžbe: 39.02.48.240.500

Telefaks: 39.02.48.240.344

Tehnička podrška: 39.02.48.240.264

E-pošta: ordini_medicale@europe.bd.com

Srednji Istok i Afrika (EMA)

Narudžbe: 971.4.3379525

Telefaks: 971.4.03379551

E-pošta: EMA_PAS@bd.com

Nizozemska

Narudžbe: 31.20.6545.716

Telefaks: 31.20.5829.421

E-pošta: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Novi Zeland

Narudžbe: 0800.572.468

Telefaks: 0800.572.469

E-pošta: bd_anz@bd.com

Norveška:

Narudžbe: 47.73.59.12.00

Telefaks: 47.73.59.12.01

Španjolska

Narudžbe: 34.902.27.17.27

Telefaks: 34.91.848.81.04

E-pošta: servicio_de_clientes@bd.com

Švedska

Narudžbe: 46.8.775.51.60

Telefaks: 46.8.775.51.95

E-pošta: bdorder_sweden@europe.bd.com

Švicarska

Narudžbe: 41.61.4852222

Narudžbe: 41.61.4852200

Ujedinjeno Kraljevstvo

Narudžbe: 44.1.865.781.666

Telefaks: 44.1.865.717.313

E-pošta: bduk_customerservice@europe.bd.com

SAD

Narudžbe: 888.237.2762

Telefaks: 800.847.2220

Tehnička podrška: 800.631.0174

E-pošta: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – služba za korisnike

Australija

Narudžbe: 03.9840.9800
Telefaks: 03.9840.9888
Tehnička podrška: 1.800.243.066

Austrija

Narudžbe: 0800/28.10.10
Telefaks: 0800/28.10.19
Tehnička podrška: 0800/28.10.11

Belgija

Narudžbe: 0800.79612
Telefaks: 0800.79611
Tehnička podrška: 0800.79556

Kanada

Narudžbe: 800.572.9613
Telefaks: 800.713.5951
Tehnička podrška: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Kina

Narudžbe: 0086.21.3865.3865
Telefaks: 0086.21.3865.3965
Tehnička podrška: 800.988.0325 / 800.988.0327

Danska

Narudžbe: 80.885945
Telefaks: 80.885944
Tehnička podrška: 80.885942

Finska

Narudžbe: 0800.914416
Telefaks: 0800.914415
Tehnička podrška: 0800.914413

Francuska

Narudžbe: 01.60.920.926
Telefaks: 01.60.920.925
Tehnička podrška: 01.60.920.930
Ponude: 01.60.920.928

Njemačka

Narudžbe: 02103.29.12000
Telefaks: 02103.29.22000
Tehnička podrška: 02103.29.12400

Hong Kong

Narudžbe: 800.933.965
Telefaks: 800.930.439
Tehnička podrška: 800.930.425

Irska

Narudžbe: 1800.555.049
Telefaks: 1800.555.048
Tehnička podrška: 1800.555.061

Italija

Narudžbe: 02.33430411
Telefaks: 02.33430426
Tehnička podrška: 800.787980

Japan

Telefon: 03.5547.0811
Telefaks: 03.5547.0818
Tehnička podrška: 03.5547.0811

Koreja (Južna)

Narudžbe: 1544.7145
Telefaks: 1544.7146
Tehnička podrška: 1544.7145

Luksemburg

Narudžbe: 8002.2076
Telefaks: 8002.2073
Tehnička podrška: 8002.2067

Nizozemska

Narudžbe: 0800.0229592
Telefaks: 0800.0229593
Tehnička podrška: 0800.0229602

Norveška

Narudžbe: 800.18859
Telefaks: 800.18817
Tehnička podrška: 800.18712

Singapur

Narudžbe: 65.67775366
Telefaks: 65.67785177
Tehnička podrška: 65.67775366

Španjolska

Narudžbe: 91.630.7050
Telefaks: 91.630.5145
Tehnička podrška: 91.630.7050

Švedska

Narudžbe: 020.790282
Telefaks: 020.790582
Tehnička podrška: 020.798328

Švicarska

Narudžbe: 055.254.22.11
Telefaks: 055.254.22.13
Tehnička podrška: 055.254.22.12

Ujedinjeno Kraljevstvo

Narudžbe: 01293.422.911
Telefaks: 01293.422.922
Tehnička podrška: 01293.422.999

SAD

Narudžbe: 800.426.8157
Telefaks: 800.718.2056
Tehnička podrška: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Vér-DNS cső

HU – Magyar

I. Rendeltetés

A PAXgene vér-DNS cső megfelelő eszköz az olyan vénás teljes vérminták levételére, antikoagulálására, stabilizálására, szállítására és tárolására, amelyeket a későbbiekben a molekuláris diagnosztikai eljárásokhoz használható, nagy tisztaságú DNS kinyerésére használnak fel.

Az eszköz teljesítményjellemzői általánosságban nem a molekuláris diagnosztikai tesztekre vonatkoznak. Az adott molekuláris diagnosztikai eljárás esetében a felhasználóknak kell validálniuk a termék használatát.

Termékjellemzők

PAXgene vér-DNS cső • 2,5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA adalékanyag
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 cső/doboz • 1000 cső/gyűjtőcsomagolás

II. Összefoglalás és magyarázat

A PAXgene vér-DNS cső teljes vér levételénél alkalmazható eszköz, a genomiális DNS zárt, légmentes rendszerben történő izolációjához. A vérvétel a szabványos flebotómiás protokoll szerint történik, K₂EDTA adalékanyagot tartalmazó légmentes csőbe. A teljes DNS-izoláció elvégezhető manuális vagy automatizált módszerekkel, például kiszással, mágneses gyöngyökkel vagy szilícium-dioxid membrán alapú technológiákkal.

III. Figyelmeztetések

A cső tartalma bőrizgató hatású.


- Belégzés esetén biztosítsa, hogy a cső tartalmát belélegző személy friss levegőhöz jusson.
- Bőrrel való érintkezés esetén azonnal mossa le az érintett bőrfelületet bő vízzel és szappannal, legalább tizenöt percig.
- Szemmel való érintkezés esetén azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, legalább 15 percig.
- Lenyelés esetén azonnal itasson nagy mennyiségű vizet a cső tartalmát lenyelő személlyel. Hívjon orvost.

IV. Minták levétele és vizsgálatra való előkészítése

A. A vérvételhez szükséges tartozékok (nem a PAXgene vér-DNS cső tartozékai)

1. Vervételi tű, úgy mint a BD Vacutainer® Eclipse™ vervételi tű vagy a BD Vacutainer Eclipse Signal™ vervételi tű. Lásd a rendelési tájékoztatót.
2. BD Vacutainer harangot kell alkalmazni a szabályos használat érdekében. Lásd a rendelési tájékoztatót.
3. Címkék a minták pozitív, ha szükséges
4. Alkoholos tampon a szűrés helyének tisztítására
5. Száraz, steril géz
6. Érzeszorító
7. Használt tű vagy tű és harang eldobására szolgáló edény

B. Mintavételi eljárás



Általános utasítások

AZ EXPOZÍCIÓ VESZÉLYÉNEK MINIMALIZÁLÁSA ÉRDEKÉBEN VISELJEN KESZTYŰT A VÉNASZÚRÁS ELVÉGÉZEKOR ÉS A VÉRMENTÁKKAL VALÓ MUNKA SORÁN.

1. Szerelje össze a tűt a harangban. Ellenőrizze, hogy a tű stabilan rögzül-e, megelőzve annak használat közbeni kilazulását.
2. Helyezze a csövet a harangba. Megjegyzés: ne szűrje át a dugót.
3. Keressen vénaszúráshoz alkalmas helyet.
4. **Használja az érleszorítót. Megfelelő antiszeptikus kezeléssel készítse el a vénaszúráshoz a TISZTÍTÁST KÖVETŐEN NE ÉRJEN HOZZÁ A VÉNASZÚRÁS HELYÉHEZ.**
5. Helyezze a páciens karját lefelé tartott pozícióba.
6. Távolítsa el a tűvédőt. A vénaszúrást LEFELÉ TARTOTT KARON VÉGEZZE EL ÚGY, HOGY A CSŐ DUGÓJA LEGYEN LEGFELÜL.
7. A dugó átszúrása során helyezze a csöveket a tartóba, hogy megakadályozza az oldalfal átszúrását, és az ennek köszönhetően kialakuló korai vákuumvesztést. Húzza rá a csövet a tűre, ekkor átszűrődik a dugó membránja.
8. **AZONNAL ENGEDJE KI AZ ÉRLESZORÍTÓT, AMINT A VÉR ÁRAMLANI KEZD A CSŐBE. AZ ELJÁRÁS SORÁN ÜGYELJEN ARRÁ, HOGY A CSŐ TARTALMA NE ÉRINTKEZZEN A DUGÓVAL VAGY A TŰ VÉGÉVEL.**

Megjegyzés: A tű hüvelyéből egyes esetekben vér szívároghat. Tartsa be az általános óvintézkedéseket az expozíció veszélyének minimalizálása érdekében. Amennyiben nem folyik vér a csőbe, vagy a vér folyása eláll a megfelelő mennyiségű minta levétele előtt, a mintavétel kielégítő befejezéséhez a következő lépéseket ajánlott megtenni:

- a. Nyomja a csövet előre, amíg a cső dugóját át nem szűrja. Amennyiben szükséges, tartsa a helyén a teljes vákuumszívás biztosítása érdekében.
 - b. Győződjön meg arról, hogy a kanül megfelelően van behelyezve a vénába.
9. Amikor az első cső megtelt a kívánt mennyiségű vérral, és a véráramlás is megszűnt, vegye le a csövet a harangról.
 10. Forgassa meg a csövet 8-szor.
 11. Húzza ki a tűt a vénából, majd szorítson száraz, steril tampont a szúráshelyére, amíg a vérzés meg nem szűnik.
 12. A véralvadást követően szükség szerint használjon kötszert.
 13. A vénaszúrást követően a dugó tetején vérmardványok lehetnek. A csövek kezelése közben tartsa be a megfelelő óvintézkedéseket a vérral való érintkezés megelőzése érdekében.
 14. A tűt és a tartót az intézmény hatályos előírásainak és irányelveinek megfelelően ártalmatlanítsa.
 15. A feltöltött PAXgene vér-DNS csövet szobahőmérsékleten (18-25 °C) tárolja. Lásd a vérminták DNS-stabilitására vonatkozó teljesítményjellemzőket szobahőmérsékleten (18-25 °C), 2-8 °C-on, vagy -20 °C-on.

A részletekért lásd az Eljárás a PAXgene vér-DNS-csövekbe vett minták lefagyasztására és kiolvasztására című részt (ha -70 °C/-80 °C tárolási hőmérséklet szükséges).

A visszaáramlás megakadályozása érdekében az alábbi technikákat kell alkalmazni:

- a. Helyezze a véradó karját lefelé tartott pozícióba.
- b. Úgy tartsa a csövet, hogy a dugó legyen legfelül.
- c. Amint a vér elkezd áramlani a csőbe, azonnal engedje ki az érleszorítót.
- d. Bizonyosodjon meg arról, hogy a vénaszúráshoz az adalékanyagok nem érintkeznek a dugóval vagy a tű végével.

C. Eljárás a PAXgene vér-DNS csövekbe vett minták lefagyasztására és kiolvasztására

1. Állítsa a PAXgene vér-DNS csövet egy állványra. **Ne fagyassza le az álló csöveket Styrofoam™ tálcán, mivel ez a csövek szétrepedését okozhatja.**
2. A PAXgene vér-DNS csövek -20 °C-on és annál alacsonyabb hőmérsékleten tárolhatók. Ha a csöveket -20 °C alatti hőmérsékleten kívánja tárolni, először fagyassza le őket -20 °C hőmérsékleten 24 órára, ezután helyezze át -70 °C vagy -80 °C hőmérsékletre.
3. A PAXgene vér-DNS csövek kiolvasztását állványon kell végezni, szobahőmérsékleten (18-25 °C), mintegy két órán keresztül. **A PAXgene vér-DNS-csővek kiolvasztása nem végezhető 25 °C feletti hőmérsékleten.**
4. Óvatosan forgassa meg a kiolvasztott PAXgene vér-DNS csöveket 10-szer.

Megjegyzés: A lefagyasztott PAXgene vér-DNS csövek ütés hatására eltörhetnek. A törés veszélyének csökkentése érdekében szállítás során a lefagyasztott csöveket úgy kell kezelni, mint az üvegből készült csöveket. A felhasználóknak maguknak kell validálniuk a PAXgene vér-DNS csövek lefagyasztási és szállítási protokollját.

D. Eljárás a minták előkészítésére és vizsgálatára


A vérmintákat a DNS-mintakinyerő készlethez mellékelt utasításoknak megfelelően kell feldolgozni. A példákat lásd a rendelési tájékoztatóban.

V. Teljesítményjellemzők

Miután a vér a csőbe került, a DNS 18-25 °C hőmérsékleten 14 napig marad stabil (1. ábra). A DNS-stabilitási vizsgálatok alapján a vér 18 °C-tól 25 °C-ig 14 napig, 2 °C-tól 8 °C-ig 28 napig, 35 °C-on 3 napig és -20 °C-on legalább 6 hónapig tárolható $\geq 12,5$ ng/ μ l DNS-koncentrációban és 1,7–1,9-es DNS-tisztaságban (A_{260}/A_{280}).

A fagyasztott minták legfrissebb stabilitási adatit honlapunkon találja meg: www.PreAnalytiX.com.

A DNS stabilitása vérmintákban 18–25 °C hőmérsékleten

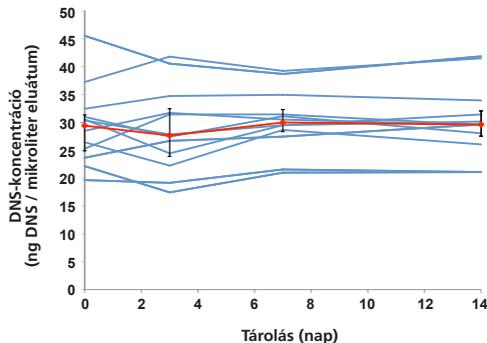

1. ábra

A vért 12 felnőtt véradótól vettük le, és 18-25 °C hőmérsékleten tároltuk a megadott számú napig, majd ezután végeztük el a teljes DNS tisztítását. A vért PAXgene vér-DNS csövekbe vettük le és tároltuk, majd a teljes DNS-t a QIAGEN® QIASymphony® DSP DNA Mini készlet és a QIAGEN QIASymphony automatizált eszköz segítségével tisztítottuk.

VI. Korlátozások

1. A levett vér térfogatának 2,5 ml-nek kell lennie a PAXgene vér-DNS csőben, de ez a térfogat a tengerszint feletti magasság, a környezeti hőmérséklet, a légnyomás, a cső kora, a vénás nyomás és a feltöltési eljárás függvényében változhat.


VII. Óvintézkedések

1. Alkalmazza az általános óvintézkedéseket. A vér fröccsenésétől, szivárgásától, valamint a hematogén kórokozótól való védelem érdekében viseljen kesztyűt, köpenyt, védőszemüveget, illetve egyéb egyéni védőfelszerelést, valamint használja a műszaki ellenőrzés által nyújtott lehetőségeket.
2. Minden biológiai mintát és vérvételnél használatos „éles” eszközt saját intézete előírásainak és irányelveinek megfelelően kell kezelni. Kellő figyelemmel végezzen minden (például szúrt sérülés által okozott) biológiai expozícióval járó beavatkozást, mivel az ilyen beavatkozások során szerzett sérülések útján terjedhet a hepatitis, a HIV (AIDS) és egyéb fertőző betegségek.
Használja a beépített tűvédőt, amennyiben a vérvételi eszköz rendelkezik ilyennel. A PreAnalytiX nem ajánlja a tűvédő visszahelyezését a használt tűkre. Ugyanakkor az intézményében érvényes előírások és eljárások ettől eltérőek lehetnek, és azokat szigorúan be kell tartani.
3. A vérvételi kémcsöveket a jóváhagyott biológiailag veszélyes hulladéktárolókban helyezze el.
4. Ne használja fel ismételten a PAXgene vér-DNS csöveket.
5. Ne használja fel a PAXgene vér-DNS csöveket a címkére nyomtatott lejárati dátum után.
6. A túlzott centrifugálási sebesség miatt (10 000 RCF felett) a PAXgene vér-DNS cső eltorzít, ami sérülést okozhat, és a vérmintának való kitettségét eredményezheti.
7. Ne fecskendőből juttassa a mintát a csőbe.

VIII. Tárolás

1. A fel nem használt PAXgene vér-DNS csöveket 18-25 °C hőmérsékleten kell tárolni. Korlátozott ideig elfogadható a maximum 40 °C hőmérséklet is. Ne használja a csöveket a lejárati időn túl.


IX. A BD Hemogard kupak eltávolításának menete



1. Fogja meg egyik kezével a PAXgene vér-DNS csövet hüvelykujját a BD Hemogard kupak alá helyezve. (A stabilitás növelése érdekében támassza a karját szilárd felületre). A másik kezével csavarja a BD Hemogard kupakot, amíg ezzel egy időben másik kezének hüvelykujjával nyomja azt felfelé, CSAK ADDIG, AMÍG A CSŐ DUGÓJA MEG NEM LAZUL.

2. A kupak emelése előtt mozdítsa el a hüvelykujját. NE használja hüvelykujját a kupak eltolása során. A vért tartalmazó cső esetében expozíciós veszély áll fenn. A kupak eltávolítása során jelentkező sérülés megelőzése érdekében fontos, hogy a kupak felfelé tolásához használt hüvelykujját levegye a csőről, amint a BD Hemogard kupak meglazul.
3. Emelje le a fedelet a csőről. Amennyiben a műanyag védőfelszín leválik a gumidugóról (ennek kicsi a valószínűsége), NE HELYEZZE VISSZA A KUPAKOT A CSŐRE. Óvatosan távolítsa el a csőből a gumidugót.

X. A BD Hemogard kupak visszahelyezésének menete



1. Helyezze a kupakot a csőre.
2. Csavarja és nyomja lefelé a dugót, amíg az nem ül tökéletesen a kémcsövön. A dugó teljes visszahelyezése szükséges, hogy az használat közben biztonságosan a kémcsövön maradjon.

Műszaki segítség

A PAXgene vér-DNS csővel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a BD műszaki szolgáltatások részlegéhez, amelynek elérhetőségeit a BD – Ügyfélszolgálat részénél ismertetjük.

Megrendelési információ

PAXgene termékek

PAXgene vér-DNS cső / 761165
Tartalom: 1000 db vérvételi cső.

BD termékek*

BD Vacutainer Eclipse vérvételi tű / 368609 CE
Tartalom: 21G 1¼" hüvelykes tű, 0,8 mm × 32 mm, 48 db/doboz, 480 db/gyűjtőcsomagolás

BD Vacutainer Eclipse vérvételi tű előre csatlakoztatott haranggal / 368650
Tartalom: 21G 1¼" hüvelykes tű, 0,8 mm × 32 mm, 100 db/doboz

BD Vacutainer Eclipse Signal vérvételi tű / 368835 CE
Tartalom: 21G 1¼" hüvelykes tű, 0,8 mm × 32 mm, 50 db/doboz, 400 db/gyűjtőcsomagolás

BD Vacutainer egyszer használatos harang / 364815
Tartalom: Gyűjtőcsomagolás kizárólag a 13 mm és 16 mm átmérő esetén, 1000 db/gyűjtőcsomagolás

** Ezek a katalógusszámok a PAXgene vér-DNS csővel használható, jellemző termékek számai.*

A BD vérvételi tartozékok megrendeléséhez:

Látogasson el a következő webhelyre: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>.

- Válassza ki az országot.
- Görgessen lefelé amíg eléri a BD Diagnostics - Preanalytical Systems feliratot.
- Társcsázza a számot.

QIAGEN termékek*

QIAGEN QIASymphony DSP DNS készlet / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)
Tartalom: Reagens patron, enzimtartó állvány, átszűrőfedél, ATE puffer, újrahasználható zárószett

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)
Tartalom: QIAamp Mini spin oszlopok, gyűjtőcsövek, AL puffer, ATL puffer, AW1 puffer, AW2 puffer, AE puffer, QIAGEN proteáz, proteáz oldószer

QIAGEN Gentra® Puregene® vér készlet / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)
Tartalom: VVT lizáló oldat, sejtlyálzó oldat, fehérjekicsapó oldat, DNS-hidratáló oldat, RNáz A oldat

** Ezek a katalógusszámok a PAXgene vér-DNS csővel használható jellemző DNS-előkészítő készletek számai.*

A QIAGEN DNS-előkészítő készletek megrendeléséhez:

Látogasson el a következő portálra: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>.

A PAXgene vér-DNS csövet az Egyesült Királyságban a BD gyártja a PreAnalytiX GmbH részére. A PAXgene és a PreAnalytiX a PreAnalytiX GmbH védjegyei; a QIAGEN, a QIASymphony, a QIAamp, a Gentra és a Puregene a QIAGEN NV védjegyei; a Styrofoam a The Dow Chemical Company védjegye; az összes többi védjegy a Becton, Dickinson and Company tulajdonában van.

(Folytatás)

BD – Ügyfélszolgálat

Argentína, Uruguay és Paraguay

Megrendelések: 011.4551.7100
E-mail: crc_argentina@bd.com

Ausztrália

Megrendelések: 1.800.656. 100
Fax: 1.800.656.110
E-mail: bd_anz@bd.com

Ausztria

Megrendelések: 43.1.7063660
Fax: 43.1.7063660-11

Belgium

Megrendelések: 32.53.720.556
Fax: 32.53.720.549

Brazília

Megrendelések: 0800.055.5654
E-mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Megrendelések: 800.268.5430
Fax: 800.565.0897
E-mail: custsvccan@bd.com

Dánia

Megrendelések: 45.43.43.45.66
Fax: 45.43.96.56.76
E-mail: bdcs_dk@europe.bd.com

Kelet-Európa

Megrendelések: 48.22.651.75.88
Fax: 48.22.651.75.89

Finnország

Megrendelések: 358.9.88.70.780
Fax: 358.9.88.70.7816
E-mail: bdorder_finland@europe.bd.com

Franciaország

Megrendelések: 33.476.689496
Fax: 33.476.683693
E-mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Németország

Megrendelések: 49.6221305553
Fax: 49.6221305379

Olaszország

Megrendelések: 39.02.48.240.516
Fax: 39.02.48.240.344
Műszaki: 39.02.48.240.264
E-mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Közel-Kelet és Afrika (EMA)

Megrendelések: 971.4.3379525
Fax: 971.4.03379551
E-mail: EMA_PAS@bd.com

Hollandia

Megrendelések: 31.20.6545.716
Fax: 31.20.5829.421
E-mail: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Új-Zéland

Megrendelések: 0800.572.468
Fax: 0800.572.469
E-mail: bd_anz@bd.com

Norvégia

Megrendelések: 47.73.59.12.00
Fax: 47.73.59.12.01

Spanyolország

Megrendelések: 34.902.27.17.27
Fax: 34.91.848.81.04
E-mail: servicio_de_clientes@bd.com

Svédország

Megrendelések: 46.8.775.51.60
Fax 46: 8.775.51.95
E-mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Svájc

Megrendelések: 41.61.4852222
Megrendelések: 41.61.4852200

Egyesült Királyság

Megrendelések: 44.1.865.781.666
Fax: 44.1.865.717.313
E-mail: bduk_customerservice@europe.bd.com

Amerikai Egyesült Államok

Megrendelések: 888.237.2762
Fax: 800.847.2220
Műszaki: 800.631.0174
E-mail: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Ügyfélszolgálat

Ausztrália

Megrendelések: 03.9840.9800
Fax: 03.9840.9888
Műszaki: 1.800.243.066

Ausztria

Megrendelések: 0800/28.10.10
Fax: 0800/28.10.19
Műszaki: 0800/28.10.11

Belgium

Megrendelések: 0800.79612
Fax: 0800.79611
Műszaki: 0800.79556

Kanada

Megrendelések: 800.572.9613
Fax: 800.713.5951
Műszaki: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Kína

Megrendelések: 0086.21.3865.3865
Fax: 0086.21.3865.3965
Műszaki: 800.988.0325 / 800.988.0327

Dánia

Megrendelések: 80.885945
Fax: 80.885944
Műszaki: 80.885942

Finnország

Megrendelések: 0800.914416
Fax: 0800.914415
Műszaki: 0800.914413

Franciaország

Megrendelések: 01.60.920.926
Fax: 01.60.920.925
Műszaki: 01.60.920.930
Ajánlatok: 01.60.920.928

Németország

Megrendelések: 02103.29.12000
Fax: 02103.29.22000
Műszaki: 02103.29.12400

Hong Kong

Megrendelések: 800.933.965
Fax: 800.930.439
Műszaki: 800.930.425

Írország

Megrendelések: 1800.555.049
Fax: 1800.555.048
Műszaki: 1800.555.061

Olaszország

Megrendelések: 02.33430411
Fax: 02.33430426
Műszaki: 800.787980

Japán

Telefon: 03.5547.0811
Fax: 03.5547.0818
Műszaki: 03.5547.0811

Dél-Korea

Megrendelések: 1544.7145
Fax: 1544.7146
Műszaki: 1544.7145

Luxemburg

Megrendelések: 8002.2076
Fax: 8002.2073
Műszaki: 8002.2067

Hollandia

Megrendelések: 0800.0229592
Fax: 0800.0229593
Műszaki: 0800.0229602

Norvégia

Megrendelések: 800.18859
Fax: 800.18817
Műszaki: 800.18712

Szingapúr

Megrendelések: 65.67775366
Fax: 65.67785177
Műszaki: 65.67775366

Spanyolország

Megrendelések: 91.630.7050
Fax: 91.630.5145
Műszaki: 91.630.7050

Svédország

Megrendelések: 020.790282
Fax: 020.790582
Műszaki: 020.798328

Svájc

Megrendelések: 055.254.22.11
Fax: 055.254.22.13
Műszaki: 055.254.22.12

Egyesült Királyság

Megrendelések: 01293.422.911
Fax: 01293.422.922
Műszaki: 01293.422.999

Amerikai Egyesült Államok

Megrendelések: 800.426.8157
Fax: 800.718.2056
Műszaki: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Sýnaglas fyrir blóð-DNA

IS - Íslenska

I. Notkunarsvið

Sýnaglósín fyrir blóð-DNA frá PAXgene eru ætluð til að safna, storkuverja, halda stöðugu, flytja og geyma bláæðaheiblóð í því skyni að vinna úr því hágæða DNA til notkunar við sameindagreiningaraðferðir sem þarfnað DNA.

Ekki hefur verið sýnt fram á virknieiginleika þessa búnaðar við sameindagreiningar almennt. Notendur verða að fullgilda vöruna fyrir þær sameindagreiningar sem þeir nota.

Eiginleikar vörunnar

PAXgene sýnaglós fyrir blóð-DNA • 2,5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA íblöndunarefni
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 sýnaglós/hillukassi • 1.000 sýnaglós/hulstur

II. Samantekt og skýringar

Sýnaglósín fyrir blóð-DNA frá PAXgene eru notuð til að safna heilblóði í því skyni að einangra erfaðmengis DNA í lokuðu, lofttæmdu kerfi. Blóðinu er safnað við venjubundna blóðtöku í lofttæmt sýnaglas sem inniheldur K₂EDTA íblöndunarefni. Einangrun DNA er gerð með handvirkum eða sjálfvirkum aðferðum á borð við útfellingu með salti, segulkúlum eða aðferðum sem byggja á kísilhimnum.

III. Varnaðarorð

Innihald þessa sýnaglass ertir húðina.


- Ef einhver andar að sér efninu skal flytja viðkomandi í ferskt loft.
- Ef efnið kemst í snertingu við húði skal þvo hana strax með mikilli sápu og vatni í a.m.k. 15 mínútur.
- Ef efnið kemst í snertingu við augu skal skola þau strax með miklu vatni í a.m.k. 15 mínútur.
- Ef efnið er gleypt skal strax drekka mikið vatn. Leitið lækniástoðar.

IV. Sýnataka og undirbúningur fyrir greiningu

A. Fylgibúnaður sem þarf fyrir blóðtöku (fylgir ekki með PAXgene sýnaglósunum fyrir blóð-DNA)

1. Blóðtökunálar eins og t.d. BD Vacutainer® Eclipse™ blóðtökunálar eða BD Vacutainer Eclipse Signal™ blóðtökunálar. Sjá pöntunarupplýsingar.
2. Nota verður BD Vacutainer nálahöldur til að tryggja rétta virkni. Sjá pöntunarupplýsingar.
3. Merkimiðar til að auðkenna sýnisgjafa, ef þörf krefur
4. Alkóhólgrísjá til að hreinsa stungustað
5. Þurr, smítsæfð grísjá
6. Stasi
7. Ílát til förgunar nála til að setja í notaðar nálar eða samfastar nálar og höldur

B. Aðferð við sýnatöku



Almennar leiðbeiningar

NOTIÐ HANSKA Á MEÐAN Á BLÁÆÐASTUNGU STENDUR OG BLÓÐTÖKUGLÖS ERU MEÐHÖNDLUD TIL AÐ LÁGMARKA HÆTTU Á SMITI.

1. Setjið nálin á hölduna. Gangið úr skugga um að nálin sé tryggilega fest svo hún skrófist ekki úr við notkun.
2. Setjið sýnaglasíð í hölduna. Athugið: Ekki gata tappann.
3. Veljið stað til bláæðastungu.
4. Setjið stasann á. Undirbúið stungustaðinn í bláæð með viðeigandi sótthreinsiefni. PREIFID EKKI Á STUNGUSTAÐNUM EFTIR HREINSUN.
5. Látið handlegg sjúklings liggja niður á við.
6. Fjarlægið nálarhlífina. Stingið á bláæðina MEÐ HANDLEGGINN NIÐUR Á VIÐ OG TAPPA SÝNAGLASSINS UPP.
7. Hafið sýnaglösin í miðri höldunni þegar tappinn er rofinn til að koma í veg fyrir að hliðin gatist og lofttæmið hverfi fyrir en ætlað er. Þrýstið sýnaglasinu á nálin þar til hettan á glasinu rofnar.
8. LOSIÐ STASANN UM LEIÐ OG BLÓÐ SÉST Í SÝNAGLASINU. INNIHALD SÝNAGLASSINS MÁ EKKI SNERTA TAPPANN EÐA ENDA NÁLARINNAR Á MEÐAN Á SÝNATÖKUNNI STENDUR.

Athugið: Blóð getur einstaka sinnum lekið úr nálarhlífinni. Viðhafið almennar varúðarráðstafanir til að lágmarka hættu á snertingu við blóð. Ef ekkert blóð streymir í sýnaglasíð eða ef blóð hættir að streyma áður en nægilegu magni sýnis hefur verið safnað er mælt með að eftirfarandi skref séu tekin til að ljúka sýnatöku á fullnægjandi hátt:

- a. Þrýstið sýnaglasinu fram þar til farið er í gegnum tappann á sýnaglasinu. Haldið sýnaglasinu kyrru til að tryggja að lofttæmið dragi að fullu.
 - b. Gangið úr skugga um að holnálin sé rétt staðsett í bláæð.
9. Þegar fyrsta sýnaglasíð hefur verið fyllt að settu rúmmáli og blóðflæði hættir skal taka glasið úr höldunni.
 10. Snúið 8 sinnum.
 11. Fjarlægið nálin úr bláæðinni um leið og þrýstingur er settur á stungustaðinn með þurri, sæfðri grísu þar til blæðing hættir.
 12. Þegar blóðið hefur storknað skal setja umbúðir á ef þarf.
 13. Eftir bláæðastungu kunna leifar af blóði að vera í efsta hluta tappans. Gerið viðeigandi ráðstafanir við meðferð sýnaglasa til að koma í veg fyrir snertingu við þetta blóð.
 14. Fargið nál og höldu í samræmi við reglur og aðferðir vinnustaðarins.
 15. Geymið fyllt PAXgene blóð-DNA sýnaglös við stofuhita (18-25°C). Sjá kaflann Virknieiginleikar varðandi stöðugleika DNA við stofuhita (18-25°C), 2-8°C, eða -20°C.

Sjá aðferð við að frysta og þýða PAXgene sýnaglösin fyrir blóð-DNA ef nauðsynlegt er að geyma sýnin við hitastig sem nemur -70°C / -80°C.

Notast skal við eftirfarandi aðferðir til að koma í veg fyrir hugsanlegt bakflæði:

- a. Látið handlegg blóðgjafans liggja niður á við.
- b. Haldið sýnaglasinu þannig að tappinn sé efst.
- c. Losið stasann um leið og blóð fer að flæða í sýnaglasíð.
- d. Tryggið að íblöndunarefni sýnaglassins snerti ekki tappann eða nálarendann á meðan á bláæðastungu stendur.

C. Aðferð við að frysta og þýða sýni sem safnað hefur verið í PAXgene blóð DNA sýnaglös

1. Látið PAXgene blóð DNA sýnaglösin standa upprétt í virgrind. Ekki má frysta sýnaglös upprétt í Styrofoam™ frauðplastbökkum þar sem sýnaglösin geta sprungið.
2. Geyma má PAXgene sýnaglös fyrir blóð-DNA við hitastig sem nemur -20°C og lægra. Ef geyma á sýnaglösin við hitastig lægra en -20°C, skal frysta þau fyrst við -20°C í 24 klukkustundir og færa þau svo í -70°C eða -80°C.

- Þýða skal PAXgene sýnaglös fyrir blóð-DNA í vírgrind við herbergishita (18-25°C) í um það bil tvær klukkustundir. **Ekki skal þýða PAXgene blóð-DNA sýnaglösin, við hitastig hærra en 25°C.**
- Snúið PAXgene blóð-DNA sýnaglösunum varlega í 10 skipti eftir að þau hafa verið þýdd.

Athugið: Frosin PAXgene blóð-DNA sýnaglös geta brotnað við högg. Til að draga úr hættu á að þau brotni við flutning skal meðhöndla frosin sýnaglös á sama hátt og sýnaglös úr gleri. Notendur verða að fullgilda eigin aðferðir við frystingu og flutning á PAXgene blóð-DNA sýnaglösunum.

D. Aðferð við undirbúning sýna fyrir greiningu


Öll blóðsýni skal vinna í samræmi við þær leiðbeiningar sem fylgja einangrunarsetti fyrir DNA. Sjá dæmi í pöntunarupplýsingum.

V. Virknieiginleikar

Eftir að blóð er sett í sýnaglasíð helst DNAið stöðugt í 14 daga við 18°C til 25°C (Mynd 1). Á grunni rannsókna á stöðugleika DNA má geyma blóð í sýnaglasinu í 14 daga við 18°C til 25°C, 28 daga við 2°C til 8°C, 3 daga við 35°C, eða í að lágmarki 6 mánuði við -20°C með styrk DNA ≥ 12.5 ng/ μ l og hreinleika DNA (A_{260}/A_{280}) sem nemur 1,7-1,9.

Nýjustu upplýsingar um stöðugleika frosinna sýna má finna á vefslóðinni www.PreAnalytiX.com.

Stöðugleiki DNA í blóðsýnum við 18-25°C

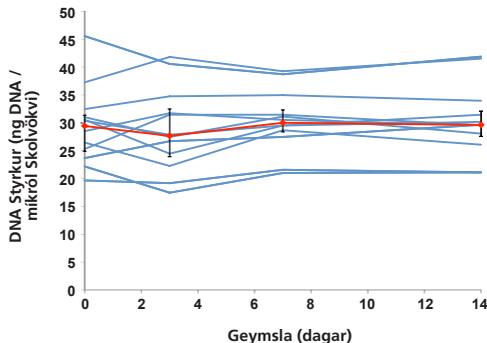

Mynd 1

Blóðið var fengið úr 12 fullorðnum blóðgjöfum og geymt við 18-25°C í tilgreindan dagafjölda og eftir það var allt DNA einangrað. Blóðinu var safnað og það geymt í PAXgene blóð-DNA sýnaglösunum og allt DNA einangrað með QIAGEN® QIAAsymphony® DSP DNA Mini Kit setti í sjálfvirka QIAGEN QIAAsymphony tækinu.

VI. Takmarkanir

- Magn blóðs sem tekið er ætti að vera 2,5 ml á hvert PAXgene blóð-DNA sýnaglas, en þetta magn kann að vera breytilegt eftir hæð yfir sjávarmáli, umhverfishita, loftþrýstingi, aldri sýnaglass, þrýstingi í bláæð og aðferð við fyllingu.

VII. Varúðarráðstafanir

- Viðhafið almennar varúðarráðstafanir. Notið hanska, hlífðarfatnað, augnhlífar, annan persónulegan hlífðarbúnað og verkstjórn til að verjast því að blóð slettist eða leki og mögulegri snertingu við smitefni í blóði.
- Meðhöndlið öll lífsýni, blóðsöfnunarvörur og beitt og oddhvöss áhöld í samræmi við stefnu og aðferðir á staðnum. Leitið viðeigandi læknishjálpar ef snerting verður við lífsýni (til dæmis í gegnum stungusár) þar sem sýni geta valdið lífrabólgu af völdum veiru, HIV (alnæmi) eða öðrum smitsjúkdómum.


Notið allar innbyggðar nálarhlífar fyrir notaðar nálar ef þær fylgja blóðtökubúnaðinum. PreAnalytix mælir ekki með því að notaðar nálar séu settar aftur í slíður. Hins vegar geta reglur og aðferðir á staðnum kveðið á um annað og þeim verður ávallt að fylgja.

3. Fargið öllum beittum og oddhvössum áhöldum í þar til gerð viðurkennd ílát fyrir hættuleg lífsýni.
4. Ekki má endurnýta PAXgene blóð-DNA sýnaglösin.
5. Notið PAXgene blóð-DNA sýnaglösin ekki eftir fyrningardagsetningu sem prentuð er á merkimiða þeirra.
6. Of mikill spunahraði (yfir 10.000 RCF) getur valdið því að PAXgene blóð-DNA sýnaglösin brotni, með mögulegri snertingu við blóð og hugsanlegum slysum á fólki.
7. Flytjið ekki sýni úr sprautu í sýnaglas.

VIII. Geymsla


1. Geyma skal tóm PAXgene blóð-DNA sýnaglös við 18°C til 25°C. Takmarkaður frávíkshiti allt að 40°C er leyfilegur. Notið sýnaglösin ekki eftir fyrningardagsetningu.

IX. Leiðbeiningar um hvernig á að fjarlægja BD Hemogard lokið



1. Takið um PAXgene blóð-DNA sýnaglasíð með annarri hönd og setjið þumalinn undir BD Hemogard lokið. (Látið handlegginn hvíla á stöðugum fleti til að auka stöðugleikann). Notið hina höndina til að snúa BD Hemogard lokinu og þrýsta því samtímis upp með þumlinum AÐEINS ÞAR TIL TAPPINN Á SÝNAGLASINU HEFUR VERIÐ LOSAÐUR.
2. Færið þumalinn frá áður en lokinu er lyft upp. EKKI nota þumalinn til að ýta lokinu af sýnaglasinu. Ef sýnaglasíð inniheldur blóð er hættu á snertingu við það. Til að draga úr hættu á slysi þegar lokið er tekið af er mikilvægt að þumallinn sem notaður er til að ýta lokinu upp sé færður frá um leið og BD Hemogard lokið losnar.
3. Lyftið lokinu af sýnaglasinu. Ef svo ólíklega vill til að plasthlífín losni frá gúmmítappanum MÁ EKKI SETJA LOKIÐ AFTUR Á. Takið gúmmítappann varlega úr glasinu.

X. Leiðbeiningar um hvernig á að setja BD Hemogard lokið aftur á



1. Setjið lokið yfir sýnaglasíð.
2. Snúið og ýtið niður þar til tappinn er kominn að fullu aftur á sinn stað. Ljúkið ísetningu tappans ef þarf til að lokið sé örugglega á sýnaglasinu á meðan það er meðhöndlað.

Tæknileg aðstoð

Ef þú hefur spurningar varðandi PAXgene blóð-DNA sýnaglösin, hafðu þá samband við BD tækniþjónustuna eins og gefið er upp í kaflanum BD – Þjónusta við viðskiptamenn.

Pöntunarupplýsingar

PAXgene vörur

PAXgene blóð-DNA sýnaglös / 761165

Innihald: 1.000 sýnaglös fyrir blóðtöku.

BD vörur*

BD Vacutainer Eclipse Blood blóðtökunál / 368609 CE

Innihald: 21G 1¼" tommu nál, 0,8 mm x 32 mm, 48/box, 480/askja

BD Vacutainer Eclipse blóðtökunál með áfastri höldu / 368650

Innihald: 21G 1¼" tommu nál, 0,8 mm x 32 mm, 100/box

BD Vacutainer Eclipse Signal blóðtökunál / 368835 CE

Innihald: 21G 1¼" tommu nál, 0,8 mm x 32 mm, 50/box, 400/askja

BD Vacutainer einnota halda / 364815

Innihald: Askja eingöngu fyrir 13 mm og 16 mm þvermál 1000/öskju

* Þessi vörulistanúmer sýna hefðbundnar vörur sem hægt er að nota með PAXgene blóð-DNA sýnaglös.

Til að panta BD blóðsöfnunarbúnað:

Farið á: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Veljið land • Skrunið niður á BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Hringið í númer

QIAGEN vörur*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Innihald: Hvarfefnahlýki, ensímrekki, stungulok, jafni ATE, endurnotkunarinnsigli

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Innihald: QIAamp Mini spin súlur, sýnatökuglös, jafni AL, jafni ATL, jafni AW1, jafni AW2, jafni AE, QIAGEN próteasi, próteasíleysir

QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Innihald: RBC sundrunarlausn, frumusundrunarlausn, prótín botnfellingarlausn, DNA vötnunarlausn, RNasa A lausn

* Þessi vörulistanúmer sýna hefðbundnar DNA undirbúningsbúnaður sem hægt er að nota með PAXgene blóð-DNA sýnaglös.

Til að panta QIAGEN DNA einangrunarsett:

Farið á: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

BD – Þjónusta við viðskiptamenn

Argentína, Úrúgvæ og Paragvæ

Pantanir: 011.4551.7100

Netfang: crc_argentina@bd.com

Ástralía

Pantanir: 1.800.656. 100

Fax: 1.800.656.110

Netfang: bd_anz@bd.com

Austurríki

Pantanir: 43.1.7063660

Fax: 43.1.7063660-11

Belgía

Pantanir: 32.53.720.556

Fax: 32.53.720.549

Brasilía

Pantanir: 0800.055.5654

Netfang: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Pantanir: 800.268.5430

Fax: 800.565.0897

Netfang: custsvccan@bd.com

Danmörk

Pantanir: 45.43.43.45.66

Fax: 45.43.96.56.76

Netfang: bdcg_dk@europe.bd.com

Austur Evrópa

Pantanir: 48.22.651.75.88

Fax: 48.22.651.75.89

Finnland

Pantanir: 358.9.88.70.780

Fax: 358.9.88.70.7816

Netfang: bdorder_finland@europe.bd.com

Frakkland

Pantanir: 33.476.689496

Fax: 33.476.683693

Netfang: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Þýskaland

Pantanir: 49.6221305553

Fax: 49.6221305379

Ítalía

Pantanir: 39.02.48.240.500

Fax: 39.02.48.240.344

Tækniástoð: 39.02.48.240.264

Netfang: ordni_medicale@europe.bd.com

Miðausturlönd & Afríka (EMA)

Pantanir: 971.4.3379525

Fax: 971.4.03379551

Netfang: EMA_PAS@bd.com

Holland

Pantanir: 31.20.6545.716

Fax: 31.20.5829.421

Netfang: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Nýja-Sjáland

Pantanir: 0800.572.468

Fax: 0800.572.469

Netfang: bd_anz@bd.com

Noregur:

Pantanir: 47.73.59.12.00

Fax: 47.73.59.12.01

Spánn

Pantanir: 34.902.27.17.27

Fax: 34.91.848.81.04

Netfang: servicio_de_clientes@bd.com

Svíþjóð

Pantanir: 46.8.775.51.60

Fax 46: 8.775.51.95

Netfang: bdorder_sweden@europe.bd.com

Sviss

Pantanir: 41.61.4852222

Pantanir: 41.61.4852200

Bretland

Pantanir: 44.1.865.781.666

Fax: 44.1.865.717.313

Netfang: bduk_customerservice@europe.bd.com

Bandaríkin

Pantanir: 888.237.2762

Fax: 800.847.2220

Tækniástoð: 800.631.0174

Netfang: Vacutainer_TechServices@bd.com

QIAGEN – Þjónusta við viðskiptamenn

Ástralía

Pantanir: 03.9840.9800
Fax: 03.9840.9888
Tækniástoð: 1.800.243.066

Austurríki

Pantanir: 0800/28.10.10
Fax: 0800/28.10.19
Tækniástoð: 0800/28.10.11

Belgía

Pantanir: 0800.79612
Fax: 0800.79611
Tækniástoð: 0800.79556

Kanada

Pantanir: 800.572.9613
Fax: 800.713.5951
Tækniástoð: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Kína

Pantanir: 0086.21.3865.3865
Fax: 0086.21.3865.3965
Tækniástoð: 800.988.0325 / 800.988.0327

Danmörk

Pantanir: 80.885945
Fax: 80.885944
Tækniástoð: 80.885942

Finnland

Pantanir: 0800.914416
Fax: 0800.914415
Tækniástoð: 0800.914413

Frakkland

Pantanir: 01.60.920.926
Fax: 01.60.920.925
Tækniástoð: 01.60.920.930
Tilboð: 01.60.920.928

Þýskaland

Pantanir: 02103.29.12000
Fax: 02103.29.22000
Tækniástoð: 02103.29.12400

Hong Kong

Pantanir: 800.933.965
Fax: 800.930.439
Tækniástoð: 800.930.425

Írland

Pantanir: 1800.555.049
Fax: 1800.555.048
Tækniástoð: 1800.555.061

Ítalía

Pantanir: 02.33430411
Fax: 02.33430426
Tækniástoð: 800.787980

Japan

Sími: 03.5547.0811
Fax: 03.5547.0818
Tækniástoð: 03.5547.0811

Kórea (Suður)

Pantanir: 1544.7145
Fax: 1544.7146
Tækniástoð: 1544.7145

Lúxemborg

Pantanir: 8002.2076
Fax: 8002.2073
Tækniástoð: 8002.2067

Holland

Pantanir: 0800.0229592
Fax: 0800.0229593
Tækniástoð: 0800.0229602

Noregur

Pantanir: 800.18859
Fax: 800.18817
Tækniástoð: 800.18712

Singapúr

Pantanir: 65.67775366
Fax: 65.67785177
Tækniástoð: 65.67775366

Spánn

Pantanir: 91.630.7050
Fax: 91.630.5145
Tækniástoð: 91.630.7050

Svíþjóð

Pantanir: 020.790282
Fax: 020.790582
Tækniástoð: 020.798328

Sviss

Pantanir: 055.254.22.11
Fax: 055.254.22.13
Tækniástoð: 055.254.22.12

Bretland

Pantanir: 01293.422.911
Fax: 01293.422.922
Tækniástoð: 01293.422.999

Bandaríkin

Pantanir: 800.426.8157
Fax: 800.718.2056
Tækniástoð: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Provetta Blood DNA

IT – Italiano

I. Uso previsto

La provetta PAXgene Blood DNA è predisposta per il prelievo, l'anticoagulazione, la stabilizzazione, il trasporto e la conservazione di un campione di sangue intero venoso per la preparazione di DNA di alta qualità da usare nei test diagnostici molecolari che necessitano di DNA.

Le prestazioni di queste provette non sono state determinate per dosaggi diagnostici molecolari in genere. Gli utilizzatori devono convalidare l'uso del prodotto per il loro specifico dosaggio diagnostico molecolare.

Caratteristiche del prodotto

Provetta PAXgene Blood DNA • 2,5 ml • 13 x 75 mm • Additivo K₂EDTA
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 provette per confezione • 1000 provette per scatola

II. Sommario e spiegazione

La provetta PAXgene Blood DNA fornisce uno strumento per il prelievo di sangue intero per l'isolamento del DNA genomico in un sistema sottovuoto chiuso. Il sangue viene raccolto secondo un protocollo di flebotomia standard in una provetta sottovuoto che contiene additivo K₂EDTA. L'isolamento completo del DNA viene eseguito con metodi manuali o automatici, tra cui precipitazione della soluzione, particelle magnetiche o membrana di silice.

III. Avvertenze

Il contenuto della provetta è irritante per la cute.


- Se il contenuto viene inalato, portare la persona all'aria aperta.
- In caso di contatto cutaneo, lavare immediatamente la cute con abbondante acqua e sapone per almeno 15 minuti.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua per almeno 15 minuti.
- In caso di ingestione, somministrare immediatamente grandi quantità di acqua. Rivolgersi al medico.

IV. Prelievo e preparazione dei campioni per le analisi

A. Accessori indispensabili per il prelievo di sangue (non inclusi nella confezione di provette PAXgene Blood DNA)

1. Ago per il prelievo di sangue, tra cui BD Vacutainer® Eclipse™ o BD Vacutainer Eclipse Signal™. Cfr. le Informazioni per effettuare gli ordini.
2. Utilizzare la camicia BD Vacutainer per garantire il corretto funzionamento. Cfr. le Informazioni per effettuare gli ordini.
3. Etichette per identificare con sicurezza i campioni dei donatori, se necessario.
4. Tamponi di alcool per detergere il sito del prelievo.
5. Garza sterile asciutta.
6. Laccio emostatico.
7. Contenitore per lo smaltimento di aghi o camicie usati

B. Procedura per il prelievo dei campioni



Istruzioni generali

INDOSSARE GUANTI DURANTE LA VENIPUNTURA E DURANTE LA MANIPOLAZIONE DELLE PROVETTE PER IL PRELIEVO DI SANGUE, PER RIDURRE AL MINIMO IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE.

1. Installare l'ago nella camicia. Assicurarsi che l'ago sia inserito correttamente affinché non si sfili durante l'uso.
2. Posizionare la provetta nella camicia. Nota: non forare il tappo.
3. Individuare la sede per la venipuntura.
4. **Applicare il laccio emostatico. Preparare la sede per la venipuntura con un disinfettante apposito. NON PALPARE LA ZONA DELLA VENIPUNTURA DOPO LA DISINFEZIONE.**
5. Il braccio del paziente deve essere rivolto verso il basso.
6. Rimuovere il tappo di protezione dell'ago. Eseguire la venipuntura CON IL BRACCIO DEL PAZIENTE RIVOLTO VERSO IL BASSO E IL TAPPO DELLA PROVETTA RIVOLTO IL PIÙ POSSIBILE VERSO L'ALTO.
7. Centrare le provette nella camicia all'atto della penetrazione del tappo, per impedire una penetrazione laterale e quindi una prematura perdita di vuoto. Spingere la provetta sull'ago perforando la membrana del tappo.
8. **RIMUOVERE IL LACCIO EMOSTATICO NEL MOMENTO IN CUI IL SANGUE FLUISCE NELLA PROVETTA. EVITARE CHE IL CONTENUTO DELLA PROVETTA ENTRI IN CONTATTO CON IL TAPPO O CON L'ESTREMITÀ DELL'AGO DURANTE LA PROCEDURA.**

Nota: a volte il sangue può fuoriuscire dalla guaina dell'ago. Seguire le precauzioni universali per ridurre al minimo il rischio di esposizione. Nel momento in cui il sangue smette di entrare nell'ultima provetta per completare la quantità necessaria di campione, si consigliano i successivi passaggi per un prelievo del tutto soddisfacente:

- a. Spingere la provetta in avanti finché il tappo non viene perforato. Se necessario, mantenere la provetta in posizione per garantire la completa azione aspirante del vuoto.
 - b. Confermare la corretta posizione dell'ago nella vena.
9. Dopo il riempimento della provetta fino al volume prestabilito ed il flusso di sangue s'interrompe, sfilarla dalla camicia.
 10. Capovolgere la provetta 8 volte.
 11. Rimuovere l'ago dalla vena e fare pressione nella sede della puntura con un tampone asciutto e sterile finché il flusso di sangue non si blocca.
 12. Non appena avviene la coagulazione, si può applicare un cerotto.
 13. Dopo la venipuntura, l'estremità del tappo potrebbe contenere residui di sangue. Manipolare con cautela le provette per evitare qualsiasi contatto con tale sangue.
 14. Smaltire l'ago e la camicia in conformità alle pratiche ed alle procedure del proprio istituto.
 15. Conservare le provette Blood DNA PAXgene a temperatura ambiente (18-25 °C). Consultare le Prestazioni metodologiche in riferimento alla stabilità del DNA nei campioni di sangue a temperatura ambiente (18-25 °C), 2-8 °C o -20 °C.

Se le provette devono essere conservate tra -70 °C e -80 °C, cfr. la Procedura per il congelamento e lo scongelamento dei campioni raccolti nelle provette PAXgene Blood DNA.

Per evitare eventuali reflussi, attenersi alla seguente procedura:

- a. Collocare il braccio del paziente rivolto verso il basso.
- b. Mantenere la provetta con la chiusura rivolta verso l'alto.

(Continua)

- c. Sciogliere il laccio emostatico non appena il sangue comincia a defluire nella provetta.
- d. Assicurarsi che gli additivi nella provetta non entrino in contatto con il tappo o la punta dell'ago durante la venipuntura.

C. Procedura per il congelamento e lo scongelamento dei campioni raccolti nelle provette PAXgene Blood DNA

1. Collocare la provetta PAXgene Blood DNA in posizione verticale in una rastrelliera. **Non congelare le provette verticali in un contenitore di polistirene Styrofoam™ in quanto potrebbero incrinarsi.**
2. Le provette PAXgene Blood DNA possono essere conservate a temperature pari o inferiori a -20 °C. Se le provette devono essere conservate a temperature inferiori a -20 °C, congelarle prima a -20 °C per 24 ore, quindi portarle a -70-80 °C.
3. Per scongelare le provette PAXgene Blood DNA lasciarle in una rastrelliera a temperatura ambiente (18-25 °C) per circa due ore. **Non scongelare le provette PAXgene Blood DNA a temperature superiori a 25 °C.**
4. Capovolgere delicatamente le provette PAXgene Blood DNA 10 volte.

Nota: le provette PAXgene Blood DNA congelate possono rompersi all'impatto con altri oggetti. Per ridurre al minimo il rischio di rotture durante il trasporto, le provette congelate devono essere trattate come se fossero di vetro. Il personale sanitario deve preparare un idoneo protocollo per le procedure di congelamento e trasporto per le provette PAXgene Blood DNA.

D. Procedura per la preparazione dei campioni da analizzare

T trattare i campioni di sangue attenendosi alle istruzioni fornite con il kit di preparazione del campione DNA. Per esempi, cfr. le Informazioni per effettuare gli ordini.

V. Prestazioni metodologiche

Una volta introdotto il sangue nella provetta, il DNA rimane stabile per 14 giorni a 18-25 °C (Figura 1). In base agli studi sulla stabilità del DNA, il sangue può essere conservato nella provetta per 14 giorni a 18-25 °C, 28 giorni a 2-8 °C, 3 giorni a 35 °C o almeno 6 mesi a -20 °C con concentrazione di DNA $\geq 12,5$ ng/ μ l e purezza del DNA (A_{260}/A_{280}) di 1,7-1,9.

Per aggiornamenti sui dati circa la stabilità dei campioni congelati, visitate il sito dedicato www.PreAnalytiX.com.

Stabilità del DNA nei campioni di sangue a 18-25 °C

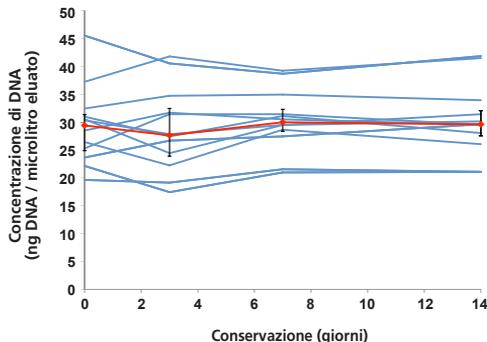


Figura 1

Il sangue è stato prelevato da 12 donatori adulti consenzienti e conservato a 18-25 °C per il numero indicato di giorni con successiva purificazione del DNA totale. Il sangue è stato prelevato e conservato nelle provette PAXgene Blood DNA e il DNA totale è stato purificato utilizzando il QIAGEN® QIASymphony® DSP DNA Mini Kit sullo strumento automatico QIAGEN QIASymphony.

(Continua)

VI. Limiti

1. Il volume di sangue prelevato per la provetta PAXgene Blood DNA è di 2,5 ml ma può variare in funzione dell'altitudine, della temperatura ambientale, della pressione barometrica, dell'età della provetta, della pressione venosa e della tecnica di riempimento.

VII. Precauzioni

1. Rispettare le precauzioni di carattere generale. Utilizzare guanti, camici, occhiali protettivi, altri dispositivi di protezione personale e gli opportuni controlli tecnici per proteggersi da spruzzi o fuoriuscite di sangue e dall'eventuale esposizione ai patogeni presenti nel sangue.
2. Trattare tutti i campioni biologici e i taglienti per il prelievo di sangue secondo le indicazioni e le procedure in vigore nel proprio istituto. Sottoporsi agli opportuni accertamenti medici in caso di esposizione a campioni biologici (ad es. punture da aghi), in quanto i campioni possono trasmettere epatite virale, HIV (AIDS) o altre malattie infettive.


Utilizzare le protezioni per gli aghi usati se incorporate nel dispositivo per il prelievo di sangue. PreAnalytiX sconsiglia il reincappucciamento degli aghi usati. Osservare sempre le indicazioni e le procedure in vigore nel proprio istituto, anche se di natura differente.

3. Smaltire le provette per il prelievo di sangue negli appositi contenitori per i materiali a rischio biologico.
4. Non riutilizzare le provette PAXgene Blood DNA.
5. Non utilizzare le provette PAXgene Blood DNA dopo la data di scadenza riportata sulle rispettive etichette.
6. Una eccessiva velocità di centrifugazione (oltre 10.000 giri) può causare la rottura della provetta PAXgene Blood DNA, con esposizione al sangue e lesioni.
7. Non trasferire i campioni da una siringa alla provetta.

VIII. Conservazione

1. Conservare le provette PAXgene Blood DNA a una temperatura compresa tra 18 e 25 °C. Sono consentite limitate escursioni termiche fino a 40 °C. Non utilizzare le provette dopo la data di scadenza.


IX. Istruzioni per la rimozione delle chiusure di sicurezza BD Hemogard



1. Afferrare la provetta PAXgene Blood DNA con una mano, tenendo il pollice sotto la chiusura di sicurezza BD Hemogard. (Per maggiore stabilità, appoggiare il braccio su una superficie solida). Con l'altra mano ruotare la chiusura di sicurezza BD Hemogard e simultaneamente con il pollice dell'altra mano esercitare una spinta verso l'alto SOLO FINO AD ALLENTARE IL TAPPO DELLA PROVETTA.
2. Allontanare il pollice prima di sfilare la chiusura. NON utilizzare il pollice per rimuovere la chiusura della provetta. Se la provetta contiene sangue, rappresenta un pericolo di esposizione. Per evitare di subire ferite durante la procedura di rimozione, è importante che il pollice utilizzato per rimuovere la chiusura della provetta venga allontanato senza toccare la provetta, non appena la chiusura di sicurezza BD Hemogard viene allentata.
3. Rimuovere la chiusura della provetta. Nell'improbabile eventualità che il tappo di protezione di plastica si separi dal tappo di gomma, NON RIASSEMBLARE LA CHIUSURA. Rimuovere con cura il tappo di gomma della provetta.

(Continua)

X. Istruzioni per il reinserimento delle chiusure di sicurezza BD Hemogard



1. Porre la chiusura sopra la provetta.
2. Ruotare e premere a fondo fino a riposizionare completamente il tappo. È necessario reinserire accuratamente il tappo affinché la chiusura rimanga ben fissa alla provetta durante le successive manipolazioni.

Assistenza tecnica

In caso di domande relative alla provetta PAXgene Blood DNA, contattare uno dei BD Technical Services Department elencati nella sezione BD – Servizio clienti.

Informazioni per effettuare gli ordini

Prodotti PAXgene

Provetta PAXgene Blood DNA / 761165

Contenuto: 1000 provette per il prelievo di sangue.

Prodotti BD*

Ago per il prelievo di sangue BD Vacutainer Eclipse / 368609 CE

Contenuto: Dimensione ago 21G 1¼", 0,8 mm x 32 mm, 48/confezione, 480/scatola

Ago per il prelievo di sangue BD Vacutainer Eclipse con camicia preassemblata / 368650

Contenuto: Dimensione ago 21G 1¼", 0,8 mm x 32 mm, 100/scatola

Ago per il prelievo di sangue BD Vacutainer Eclipse Signal / 368835 CE

Contenuto: Dimensione ago 21G 1¼", 0,8 mm x 32 mm, 50/confezione, 400/scatola

Camicia monouso BD Vacutainer / 364815

Contenuto: Scatola solo per diametri da 13 mm e 16 mm 1000/scatola

* I numeri di catalogo rappresentano prodotti standard utilizzabili con PAXgene Blood DNA Tube.

Per ordinare gli accessori BD per il prelievo di sangue:

Collegarsi al sito: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Selezionare il paese • Scorrere fino a BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Comporre il numero

Prodotti QIAGEN*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Contenuto: Cartuccia reagenti, cestello enzimi, coperchio di foratura, buffer ATE, set di chiusure riutilizzabile

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Contenuto: Colonnine rotanti QIAamp Mini, provette per il prelievo, buffer AL, buffer ATL, buffer AW1, buffer AW2, buffer AE, proteasi QIAGEN, solvente proteasi

QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Contenuto: Soluzioni di lisi RBC, soluzione di lisi cellulare, soluzione di precipitazione proteine, soluzione idratazione DNA, soluzione RNase A

* I numeri di catalogo rappresentano kit di preparazione standard del DNA utilizzabili con PAXgene Blood DNA Tube.

Per ordinare i kit di preparazione del DNA QIAGEN:

Collegarsi al sito: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

La provetta PAXgene Blood DNA è prodotta nel Regno Unito da BD per conto di PreAnalytiX GmbH. PAXgene e PreAnalytiX sono marchi di fabbrica di PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene sono marchi di fabbrica di QIAGEN NV; Styrofoam è un marchio di fabbrica di The Dow Chemical Company; tutti gli altri marchi sono di proprietà di Becton, Dickinson and Company.

(Continua)

BD – Servizio clienti

Argentina, Uruguay e Paraguay

Ordini: 011.4551.7100
E-mail: crc_argentina@bd.com

Australia

Ordini: 1.800.656. 100
Fax: 1.800.656.110
E-mail: bd_anz@bd.com

Austria

Ordini: 43.1.7063660
Fax: 43.1.7063660-11

Belgio

Ordini: 32.53.720.556
Fax: 32.53.720.549

Brasile

Ordini: 0800.055.5654
E-mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Canada

Ordini: 800.268.5430
Fax: 800.565.0897
E-mail: custsvccan@bd.com

Danimarca

Ordini: 45.43.43.45.66
Fax: 45.43.96.56.76
E-mail: bdcn_dk@europe.bd.com

Est Europa

Ordini: 48.22.651.75.88
Fax: 48.22.651.75.89

Finlandia

Ordini: 358.9.88.70.780
Fax: 358.9.88.70.7816
E-mail: bdorder_finland@europe.bd.com

Francia

Ordini: 33.476.689496
Fax: 33.476.683693
E-mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Germania

Ordini: 49.6221305553
Fax: 49.6221305379

Italia

Ordini: 39.02.48.240.500
Fax: 39.02.48.240.344
Ass. tecnica: 39.02.48.240.264
E-mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Medio Oriente e Africa (EMA)

Ordini: 971.4.3379525
Fax: 971.4.03379551
E-mail: EMA_PAS@bd.com

Paesi Bassi

Ordini: 31.20.6545.716
Fax: 31.20.5829.421
E-mail: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Nuova Zelanda

Ordini: 0800.572.468
Fax: 0800.572.469
E-mail: bd_anz@bd.com

Norvegia:

Ordini: 47.73.59.12.00
Fax: 47.73.59.12.01

Spagna

Ordini: 34.902.27.17.27
Fax: 34.91.848.81.04
E-mail: servicio_de_clientes@bd.com

Svezia

Ordini: 46.8.775.51.60
Fax 46: 8.775.51.95
E-mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Svizzera

Ordini: 41.61.4852222
Ordini: 41.61.4852200

Regno Unito

Ordini: 44.1.865.781.666
Fax: 44.1.865.717.313
E-mail: bduk_customerservice@europe.bd.com

Stati Uniti

Ordini: 888.237.2762
Fax: 800.847.2220
Ass. tecnica: 800.631.0174
E-mail: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Servizio clienti

Australia

Ordini: 03.9840.9800
Fax: 03.9840.9888
Ass. tecnica: 1.800.243.066

Austria

Ordini: 0800/28.10.10
Fax: 0800/28.10.19
Ass. tecnica: 0800/28.10.11

Belgio

Ordini: 0800.79612
Fax: 0800.79611
Ass. tecnica: 0800.79556

Canada

Ordini: 800.572.9613
Fax: 800.713.5951
Ass. tecnica: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Cina

Ordini: 0086.21.3865.3865
Fax: 0086.21.3865.3965
Ass. tecnica: 800.988.0325 / 800.988.0327

Danimarca

Ordini: 80.885945
Fax: 80.885944
Ass. tecnica: 80.885942

Finlandia

Ordini: 0800.914416
Fax: 0800.914415
Ass. tecnica: 0800.914413

Francia

Ordini: 01.60.920.926
Fax: 01.60.920.925
Ass. tecnica: 01.60.920.930
Offerte: 01.60.920.928

Germania

Ordini: 02103.29.12000
Fax: 02103.29.22000
Ass. tecnica: 02103.29.12400

Hong Kong

Ordini: 800.933.965
Fax: 800.930.439
Ass. tecnica: 800.930.425

Irlanda

Ordini: 1800.555.049
Fax: 1800.555.048
Ass. tecnica: 1800.555.061

Italia

Ordini: 02.33430411
Fax: 02.33430426
Ass. tecnica: 800.787980

Giappone

Telefono: 03.5547.0811
Fax: 03.5547.0818
Ass. tecnica: 03.5547.0811

Corea del Sud

Ordini: 1544.7145
Fax: 1544.7146
Ass. tecnica: 1544.7145

Lussemburgo

Ordini: 8002.2076
Fax: 8002.2073
Ass. tecnica: 8002.2067

Paesi Bassi

Ordini: 0800.0229592
Fax: 0800.0229593
Ass. tecnica: 0800.0229602

Norvegia

Ordini: 800.18859
Fax: 800.18817
Ass. tecnica: 800.18712

Singapore

Ordini: 65.67775366
Fax: 65.67785177
Ass. tecnica: 65.67775366

Spagna

Ordini: 91.630.7050
Fax: 91.630.5145
Ass. tecnica: 91.630.7050

Svezia

Ordini: 020.790282
Fax: 020.790582
Ass. tecnica: 020.798328

Svizzera

Ordini: 055.254.22.11
Fax: 055.254.22.13
Ass. tecnica: 055.254.22.12

Regno Unito

Ordini: 01293.422.911
Fax: 01293.422.922
Ass. tecnica: 01293.422.999

Stati Uniti

Ordini: 800.426.8157
Fax: 800.718.2056
Ass. tecnica: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

DNA 採血管

JA—日本語

I. 使用目的

パクスジーン DNA 採血管は、DNA を必要とする分子診断検査法に使用する高質な DNA の調製を目的に、全血検体の採取、抗凝固処理、安定化、輸送および保管に使用することが意図されています。

この装置の性能特性は、一般的な分子診断検査法に対して確立されていません。使用者は、特定の分子診断検査法におけるこの製品の使用について検証する必要があります。

製品の特徴

パクスジーン DNA 採血管・2.5 mL・13 x 75 mm・添加剤 K₂EDTA
761165・プラス・BD ヘモガード™・100 本/箱・1,000 本/ケース

II. 概要と説明

パクスジーン DNA 採血管は、全血を採取して密閉型真空システムでゲノム DNA を分離する手段を提供します。血液は K₂EDTA の添加剤が充填されている真空管に標準的な静脈穿刺プロトコルで採取します。完全な DNA の分離は、塩析析出、磁気ビーズ、シリカ膜ベースの技術など、手動または自動の方法で実行します。

III. 警告

この採血管の中身は皮膚刺激性があります。


- ・ 吸い込んだ人は新鮮な空気のある場所に移動させてください。
- ・ 皮膚に触れた場合は、ただちに十分な量の石鹸と水で最低 15 分間洗い流してください。
- ・ 目に触れた場合は、ただちに十分な量の水で最低 15 分間洗い流してください。
- ・ 飲み込んだ場合は、ただちに大量の水を飲ませ、医者の助言を仰いでください。

IV. 採血と分析の準備

A. 必要な採血関連用品 (パクスジーン DNA 採血管に同梱されていないもの)

1. BD バキュテイナ エクリプス™ 採血針や BD バキュテイナ エクリプス シグナル™ 採血針などの採血針。注文情報を参照してください。
2. 正しく機能することを保証するには、BD バキュテイナ 採血針ホルダーを使用する必要があります。注文情報を参照してください。
3. 検体のドナー同定 ID ラベル (必要に応じて)
4. 穿通部位消毒用アルコール消毒綿
5. 滅菌ガーゼ (湿っていないもの)
6. 止血帯
7. 針または針/ホルダー用針廃棄容器

B. 採血の手順



使用方法

血液との接触を最小限にするため、静脈穿刺中および採血管を取り扱う際は手袋を着用してください。

1. ホルダーに針をセットします。使用中に針が抜けないよう、針がしっかりと取り付けられていることを確認します。

(続き)

- 2.ホルダーに採血管をセットします。注意：栓に穴を開けないでください。
3. 静脈穿刺部位を選択します。
4. **止血帯を装着します。静脈穿刺部位を適切な消毒薬で消毒します。消毒後に静脈穿刺部位を触診しないでください。**
5. 患者の腕を下向きに置いてください。
6. 針の保護カバーを外します。腕を下に向け、栓が一番上にくる状態で静脈穿刺を行います。
7. 側壁穿通およびそれに起因する早期真空損失を防ぐため、栓を貫通する際は採血管をホルダーの中心にセットします。採血管を針に押し付け、栓のダイアフラムを貫通させます。
8. 血液が採血管に流れ込んだらすぐに、止血帯を外します。手技中に採血管の中身が栓や針の先端に絶対に触れないようにしてください。

注意：針のスリーブから血液が漏出することがあります。血液との接触を最小限にするため、万全の予防措置を講じてください。採血管に血液が流れ込まない場合または十分な血液検体採取する前に血液の流入が停止した場合、必要量を採血するため、以下の手順に従うことが推奨されます。

- a. 栓が貫通するまで、採血管を押します。必要であれば、採血管を適切な位置で支え、採血量分の陰圧がかけられていることを確認します。
- b. 針が静脈内の正しい位置にあることを確認します。
9. 採血管が採血量分まで満たされ、血液の流入が止まった時点で、ホルダーから採血管を取り外してください。
10. 8 回逆さまに動かしてください。
11. 静脈から針を抜き、出血が止まるまで滅菌綿棒で穿刺部位を圧迫します。
12. 凝固が発生したら、必要に応じて絆創膏を貼ります。
13. 静脈穿刺後、栓の上に残留血液が付着していることがあります。採血管を取り扱う際は、血液との接触を避けるため、適切な予防策を講じてください。
14. 各施設の方針および手順に従って針とホルダーを廃棄してください。
15. 採血済のパクスジーン DNA 採血管は室温（18～25° C）で保管してください。血液検体のDNAの安定性の性能特性については、室温（18～25° C）、2～8° C、または-20° Cで参照してください。

-70° C / -80° C で保管したい場合は、「パクスジーン DNA 採血管での検体の冷凍および解凍手順」の詳細を参照してください。

次の方法で逆流を防ぐことができます。

- a. 献血者の腕を下向きに置いてください。
- b. 栓が最上部にゆるやかに採血管を持ってください。
- c. 血液が採血管に流れ込んだらすぐに、止血帯を外します。
- d. 静脈穿刺中に採血管の添加剤が栓や針の先端に触れないように注意してください。

C. パクスジーン DNA 採血管での検体の冷凍および解凍手順

1. パクスジーン DNA 採血管をワイヤーラックに真っ直ぐに立てます。**採血管が割れるおそれがあるため、発泡スチロール製のスタイロフォーム™ トレーで真っ直ぐに立てた採血管は凍結しないでください。**
2. パクスジーン DNA 採血管は -20° C 以下で保管することができます。採血管を -20° C 以下で保管する場合、まず -20° C で 24 時間冷凍してから -70° C または -80° C へと移します。
3. パクスジーン DNA 採血管はワイヤーラックで約 2 時間ほど、周囲温度（18～25° C）で解凍します。**パクスジーン DNA 採血管は 25° C を上回る温度で解凍しないでください。**
4. 解凍したパクスジーン DNA 採血管を注意深く 10 回逆さまに動かします。

注意：冷凍したパクスジーン DNA 採血管は、衝撃により破損することがあります。輸送中の破損リスクを低減するため、冷凍した採血管はガラス製の採血管と同様に取り扱う必要があります。使用者は、パクスジーン DNA 採血管の冷凍および輸送プロトコルを自身で検証する必要があります。

D. 分析用検体の調製手順

血液検体は DNA サンプル調精キットに記載されている指示に従って処理してください。その例については、注文情報を参照してください。

V. 性能特性

血液での採血後、DNA は 18~25° C で 14 日間 (図 1) 安定した状態が保たれます。DNA の安定性試験によると、DNA 濃度 ≥ 12.5 ng/ μ l および純度 (A_{260}/A_{280}) 1.7 から 1.9 の血液は、18~25° C で 14 日間、2° C~8° C で 28 日間、35° C で 3 日間、または -20° C で最低 6 ヶ月間保管することができます。冷凍した検体の安定性に関する最新データは、www.PreAnalytiX.com で参照することができます。

18~25° C での血液検体の DNA 安定性

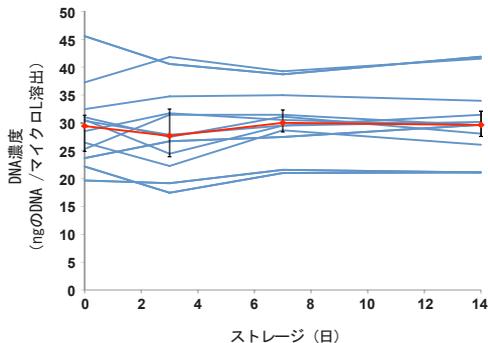


図 1

血液は同意した 12 人の成人献血者から採取し、表示されている日数の間 18~25° C で保管した後、トータル DNA 精製を行いました。血液はパクスジーン DNA 採血管に回収および保管され、トータル DNA は QIAGEN QIASymphony 自動核酸抽出装置で QIAGEN® QIASymphony® DSP DNA Mini Kit を使用して精製されました。

VI. 限界

1. 採血量はパクスジーン DNA 採血管 1 本あたり 2.5 mL ですが、高度、周囲温度、気圧、採血管の寿命、静脈圧、充填法によって異なる場合があります。

VII. 使用上の注意

1. 万全の予防策を講じてください。血液飛散、血液漏出、起こり得る血液由来病原体暴露から保護するため、手袋、ガウン、保護眼鏡、その他の個人用保護具、工学制御を使用してください。
2. 各施設の方針および手順にしたがって、すべての生体試料および採血セットに使用する「鋭利な器具」を取り扱ってください。万が一、生体試料へ暴露した場合（例えば、穿刺による傷害）は、ウイルス性肝炎、HIV（エイズ）、またはその他の感染症に感染するおそれがあるため、適切な治療を受けてください。

採血セットに内蔵されている場合、針受を使用してください。PreAnalytiX は、使用済み針を再度針受に戻すことを推奨していません。ただし、各施設の方針や手順によって異なる場合がありますので、各施設の方針や手順を優先してください。


3. 廃棄用に使用が許可されているバイオハザード用容器に採血管をすべて廃棄してください。
4. パクスジーン DNA 採血管を再利用しないでください。
5. 採血管のラベルに印刷されている有効期限を過ぎたパクスジーン DNA 採血管は使用しないでください。
6. 過度の遠心分離速度 (10,000 RCF 超) は、パクスジーン DNA 採血管の破損や血液暴露、けがにつながるおそれがあります。
7. 注射器から採血管に検体を注入しないでください。

VIII. 保管方法

1. 未使用のパクスジーン DNA 採血管は 18~25° C で保管してください。温度逸脱制限は、最高 40° C です。有効期限を過ぎた採血管は使用しないでください。

(続き)

IX. BD ヘモガード キャップの取り外し方法




1. BD ヘモガード キャップの下に親指をあてて、片方の手でバクスジーン DNA 採血管を握ります。(安定性を向上させるため、腕を硬い場所に置きます)。親指でキャップを押し上げながら、もう一方の手で栓がゆるむところまで BD ヘモガード キャップを回します。

2. キャップを持ち上げる前に、親指をキャップから離します。キャップを親指で押し上げて外さないでください。採血管内に血液が残っている場合、血液との接触リスクがあります。キャップを取り外す際のけがを防ぐため、BD ヘモガード キャップがゆるんだらすぐに採血管から外れるように親指を使ってキャップを上へ押し上げることが重要です。

3. キャップを持ち上げて採血管から外します。プラスチックカバーがゴム栓から万が一外れてしまった場合、ゴム栓に再度プラスチックカバーをかぶせず、ゴム栓を採血管から慎重に取り外してください。

X. BD ヘモガード キャップの再栓方法



1. 採血管にキャップをかぶせます。

2. 栓がしっかりとハマるまで、キャップを回し、押し下げます。処理中、採血管にキャップがしっかりとハマった状態に保つために栓をきちんと取り付けする必要があります。

テクニカルサポート

バクスジーン DNA 採血管についてのご質問は、BD-カスタマーサービスのセクションに記載されている BD テクニカルサービスにお問い合わせください。

注文情報

バクスジーン 製品

バクスジーン DNA 採血管 / 761165

内容：採血管 1,000 本

BD 製品*

BD バキュテイナ エクリプス 採血針 / 368609 CE

内容：21G 1¼ インチ針、0.8 mm x 32 mm、48 本/箱、480 本/ケース

BD バキュテイナ エクリプス 採血針 (ホルダー付き) / 368650

内容：21G 1¼ インチ針、0.8 mm x 32 mm、100 本/ケース

BD バキュテイナ エクリプス シグナル採血針 / 368835 CE

内容：21G 1¼ インチ針、0.8 mm x 32 mm、50 本/箱、400 本/ケース

BD バキュテイナ使い捨てホルダー / 364815

内容：直径 13 mm および 16 mm の採血管用 1000 個/ケース

* これらのカタログ番号はバクスジーン DNA 採血管で使用できる代表的な製品を示しています。

BD 採血関連用品の注文方法

ウェブサイト <http://www.bd.com/support/contact/international.asp> を開きます。

・国を選択します。・BD Diagnostics - Preanalytical Systems (採血製品) までスクロールダウンします。・掲載されている番号に電話をおかけください。

QIAGEN 製品*

QIAGEN QIAasyphony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

内容：試薬カートリッジ、酵素ラック、穿孔蓋、バッファ ATE、再利用シールセット

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

内容：QIAamp Mini スピンカラム、採血管、バッファ AL、バッファ ATL、バッファ AW1、バッファ AW2、バッファ AE、QIAGEN プロテアーゼ、プロテアーゼ溶媒

(続き)

QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

内容：赤血球溶解液、細胞溶解液、タンパク質沈殿液、DNA 水和溶液、RNase A 溶液

* これらのカタログ番号はパクスジーン DNA 採血管で使用できる代表的な DNA 調製キットを示しています。

QIAGEN DNA 調製キットの注文方法

ウェブサイト <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

パクスジーン DNA 採血管は、BD が PreAnalytiX GmbH のために英国で製造しています。パクスジーン (PAXgene) とプレアナリティクス (PreAnalytiX) は PreAnalytiX GmbH の商標です。QIAGEN、QIAsymphony、QIAamp、Gentra、Puregene は QIAGEN NV の商標です。スタイロフォーム (Styrofoam) は The Dow Chemical Company の商標です。その他すべての商標は Becton, Dickinson and Company に帰属します。

BD-カスタマーサービス

アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ

注文用電話番号：011.4551.7100

電子メール：crc_argentina@bd.com

オーストラリア

注文用電話番号：1.800.656.100

ファックス：1.800.656.110

電子メール：bd_anz@bd.com

オーストリア

注文用電話番号：43.1.7063660

ファックス：43.1.7063660-11

ベルギー

注文用電話番号：32.53.720.556

ファックス：32.53.720.549

ブラジル

注文用電話番号：0800.055.5654

電子メール：consultoria_vacutainer@bd.com

カナダ

注文用電話番号：800.268.5430

ファックス：800.565.0897

電子メール：custsvccan@bd.com

デンマーク

注文用電話番号：45.43.43.45.66

ファックス：45.43.96.56.76

電子メール：bdcs_dk@europe.bd.com

東ヨーロッパ

注文用電話番号：48.22.651.75.88

ファックス：48.22.651.75.89

フィンランド

注文用電話番号：358.9.88.70.780

ファックス：358.9.88.70.7816

電子メール：bdorder_finland@europe.bd.com

フランス

注文用電話番号：33.476.689496

ファックス：33.476.683693

電子メール：BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

ドイツ

注文用電話番号：49.6221305553

ファックス：49.6221305379

イタリア

注文用電話番号：39.02.48.240.500

ファックス：39.02.48.240.344

テクニカル：39.02.48.240.264

電子メール：ordini_medicale@europe.bd.com

中東・アフリカ (EMA)

注文用電話番号：971.4.3379525

ファックス：971.4.03379551

電子メール：EMA_PAS@bd.com

オランダ

注文用電話番号：31.20.6545.716

ファックス：31.20.5829.421

電子メール：vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

ニュージーランド

注文用電話番号：0800.572.468

ファックス：0800.572.469

電子メール：bd_anz@bd.com

ノルウェー

注文用電話番号：47.73.59.12.00

ファックス：47.73.59.12.01

スペイン

注文用電話番号：34.902.27.17.27

ファックス：34.91.848.81.04

電子メール：servicio_de_clientes@bd.com

スウェーデン

注文用電話番号：46.8.775.51.60

ファックス：8.775.51.95

電子メール：bdorder_sweden@europe.bd.com

スイス

注文用電話番号：41.61.4852222

注文用電話番号：41.61.4852200

英国

注文用電話番号：44.1.865.781.666

ファックス：44.1.865.717.313

電子メール：bduk_customerservice@europe.bd.com

米国

注文用電話番号：888.237.2762

ファックス：800.847.2220

テクニカル：800.631.0174

電子メール：www.bd.com/vacutainer/contact/

(続き)

QIAGEN—カスタマーサービス

オーストラリア

注文用電話番号：03.9840.9800
ファックス：03.9840.9888
テクニカル：1.800.243.066

オーストリア

注文用電話番号：0800/28.10.10
ファックス：0800/28.10.19
テクニカル：0800/28.10.11

ベルギー

注文用電話番号：0800.79612
ファックス：0800.79611
テクニカル：0800.79556

カナダ

注文用電話番号：800.572.9613
ファックス：800.713.5951
テクニカル：800.DNA.PREP
(800.362.7737)

中国

注文用電話番号：0086.21.3865.3865
ファックス：0086.21.3865.3965
テクニカル：800.988.0325 / 800.988.0327

デンマーク

注文用電話番号：80.885945
ファックス：80.885944
テクニカル：80.885942

フィンランド

注文用電話番号：0800.914416
ファックス：0800.914415
テクニカル：0800.914413

フランス

注文用電話番号：01.60.920.926
ファックス：01.60.920.925
テクニカル：01.60.920.930
オファー：01.60.920.928

ドイツ

注文用電話番号：02103.29.12000
ファックス：02103.29.22000
テクニカル：02103.29.12400

香港

注文用電話番号：800.933.965
ファックス：800.930.439
テクニカル：800.930.425

アイルランド

注文用電話番号：1800.555.049
ファックス：1800.555.048
テクニカル：1800.555.061

イタリア

注文用電話番号：02.33430411
ファックス：02.33430426
テクニカル：800.787980

日本

注文用電話番号：03.5547.0811
ファックス：03.5547.0818
テクニカル：03.5547.0811

韓国

注文用電話番号：1544.7145
ファックス：1544.7146
テクニカル：1544.7145

ルクセンブルグ

注文用電話番号：8002.2076
ファックス：8002.2073
テクニカル：8002.2067

オランダ

注文用電話番号：0800.0229592
ファックス：0800.0229593
テクニカル：0800.0229602

ノルウェー

注文用電話番号：800.18859
ファックス：800.18817
テクニカル：800.18712

シンガポール

注文用電話番号：65.67775366
ファックス：65.67785177
テクニカル：65.67775366

スペイン

注文用電話番号：91.630.7050
ファックス：91.630.5145
テクニカル：91.630.7050

スウェーデン

注文用電話番号：020.790282
ファックス：020.790582
テクニカル：020.798328

スイス

注文用電話番号：055.254.22.11
ファックス：055.254.22.13
テクニカル：055.254.22.12

英国

注文用電話番号：01293.422.911
ファックス：01293.422.922
テクニカル：01293.422.999

米国

注文用電話番号：800.426.8157
ファックス：800.718.2056
テクニカル：800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Қан ДНҚ түтікшесі

КК – Қазақша

I. Пайдалану мақсаты

РАХgene қан ДНҚ түтікшесі ДНҚ талап ететін молекулалық диагностика сынағы әдістерінде пайдалану мақсатында жоғары сапалы ДНҚ дайындау үшін күре тамырдың тұтас қан үлгісін жинауға, ұйымауын қамтамасыз етуге, тұрақтандыруға, тасымалдауға және сақтауға арналған.

Аталмыш құрылғының жұмыс сипаттамалары, жалпы алғанда, молекулалық диагностикалық талдаулар үшін анықталмаған. Пайдаланушылар өнім өздерінің нақты молекулалық диагностикалық талдауы үшін пайдаланылатынын тексеруі керек.

Өнімнің мүмкіндіктері

РАХgene қан ДНҚ түтікшесі • 2,5 мл • 13 x 75 мм • К₂ЭДТҚ қоспасы
761165 • Плюс • BD HemoGuard™ • 100 түтікше/картон қорап • 1000 түтікше/құты

II. Қысқаша шолу және сипаттама

РАХgene қан ДНҚ түтікшесі жабық, тартылған жүйеде геномды ДНҚ айыру үшін тұтас қан жинайтын құралмен қамтамасыз етеді. Қан ішінде К₂ЭДТҚ қоспасы бар вакуумды түтікшедегі қалыпты флеботомиялық хаттама бойынша жиналады. ДНҚ толығымен ажырату тұнба тұзын шығару, магнитті микротасымалдағыштар немесе силикон мембрана негізіндегі технологиялар сияқты механикалық немесе автоматтанған әдістердің көмегімен орындалады.

III. Ескертулер

Бұл түтікшенің ішіндегілер теріні тітіркендіреді.


- Ингаляциядан кейін, зардап шегушіні таза ауаға шығарыңыз.
- Теріге тиген кезде, дереу теріні сабындап мол сумен кем дегенде 15 мин бойы жуыңыз.
- Көзге тиген кезде, дереу мол сумен кем дегенде 15 мин бойы жуыңыз.
- Жұтқан кезде, мол мөлшерде су беріңіз. Дәрігерге көрініңіз.

IV. Үлгі жинау және талдауға дайындық

A. Қан жинауға арналған талап етілген қосымша құралдар (РАХgene қан ДНҚ түтікшесімен бірге келмейді)

1. BD Vacutainer® Eclipse™ немесе BD Vacutainer Eclipse Signal™ қан жинау инелері. "Тапсырыс беру туралы ақпарат" бөлімін қараңыз.
2. Тиісті түрде жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, BD Vacutainer ине ұстағышын қолдану керек. "Тапсырыс беру туралы ақпарат" бөлімін қараңыз.
3. Қажет болса, позитивті донор идентификациясына арналған жапсырмалар
4. Жергілікті тазартуға арналған спиртке малынған тампон
5. Құрғақ стерильді дәке
6. Бұрау
7. Пайдаланылған ине немесе ине/ұстағыш жинағына арналған ине тастау құтқысы

B. Үлгі жинау процедурасы



Жалпы нұсқаулар

ҚАУІПТІ АЗАЙТУ ҮШІН ТАМЫРҒА ЕНГІЗГЕНДЕ ЖӘНЕ ҚАН ЖИНАУ ТҮТІКШЕЛЕРІН ӨНДЕГЕН КЕЗДЕ ҚОЛҒАП КИІҢІЗ.

1. Инені ұстағышқа орналастырыңыз. Пайдалану кезінде иненің ажырамауын қамтамасыз ету үшін, иненің мықты орналасқанына көз жеткізіңіз.
2. Түтікшені ұстағышқа орналастырыңыз. Ескертпе: Тығынды теспеніз.
3. Тамырға енгізетін аймақты таңдаңыз.
4. **Бұрауды байлаңыз. Тамырға енгізетін аймақты тиісті антисептикпен дайындаңыз. ТАЗАРТУДАН КЕЙІН ТАМЫР ТЕСІЛГЕН АЙМАҚТЫ САУСАҚПЕН ТҮРТПЕҢІЗ.**
5. Емделушінің қолын төмен қараған қалыпта орналастырыңыз.
6. Иненің қақпағын алып тастаңыз. Тамырға енгізуді ҚОЛ ТӨМЕН ҚАРАҒАН КҮЙДЕ ЖӘНЕ ТҮТІКШЕ ТЫҒЫНЫН ЖОҒАРЫ ҚАРАТЫП орындаңыз.
7. Бүйірден енудің алдын алу және вакуумның ерте жоғалуын болдырмау үшін тығынға енгенде, түтікшелерді ұстағыштың ортаға келтіріңіз. Диафрагма тығынын тесе отырып, түтікшені инеге қарай итеріңіз.
8. ТҮТІКШЕДЕ ҚАН ПАЙДА БОЛЫСЫМЕН, БҰРАУДЫ АЛЫП ТАСТАҢЫЗ. ПРОЦЕДУРА КЕЗІНДЕ ТҮТІКШЕНІҢ ІШІНДЕГІНІ ТЫҒЫН НЕМЕСЕ ИНЕНІҢ ҰШЫНА ТИГІЗБЕҢІЗ.

Ескертпе: Кей кезде қан ине жалғастырғышынан ағып кетуі мүмкін. Қауіпті азайту үшін Әмбебап сақтық шараларын қолданыңыз. Жеткілікті үлгі жиналардан бұрын түтікшеге қан ақпаса немесе ағуын тоқтатса, қанағаттанарлық жинауды аяқтау үшін келесі қадамдарды орындау ұсынылады:

- a. Түтікше тығыны енгенше, түтікшені алға қарай итеріңіз. Егер қажет болса, толық вакуум тартуын қамтамасыз ету үшін орнында ұстаңыз.
 - b. Тамырда иненің дұрыс орналасуын растаңыз.
9. Түтікше көрсетілген көлеммен толғанда және қан ағу тоқтағанда, оны ұстағыштан алып тастаңыз.
 10. 8 рет аударыңыз.
 11. Қанау тоқтағанша, құрғақ стерильді дәкемен аймақты саусақпен басып тұрып, инені тамырдан алыңыз.
 12. Ұйыған соң, керек болса, таңып қойыңыз.
 13. Тамырға енгізгеннен кейін, тығынның төбесінде қалдық қан болуы мүмкін. Сол қанмен жанаспау үшін түтікшелерді өңдеу кезінде тиісті сақтық шараларын қолданыңыз.
 14. Ине мен ұстағыштарды мекемеңіздің саясаты мен нұсқаулықтарына сәйкес тастаңыз.
 15. Толтырылған PAXgene қан ДНҚ түтікшесін бөлме температурасында (18–25°C) сақтаңыз. Бөлме температурасындағы (18–25°C), 2–8°C, немесе –20°C немесе температурадағы қан сынамаларындағы ДНҚ тұрақтылығының жұмысқа қабілеттілік сипаттамаларын қараңыз.

Егер –70°C / –80°C сақтау температурасы керек болса, толық мәліметтерді «PAXgene қан ДНҚ түтікшелеріндегі үлгілерді мұздату және еріту процедурасы» бөлімінен қараңыз.

Мүмкін кері ағудың алдын алу үшін келесі әдістер пайдалануы тиіс:

- a. Донордың қолын төмен қараған қалыпта орналастырыңыз.
- b. Түтікті тығынын жоғары көтеріп ұстаңыз.
- c. Қан түтікшеге аға бастағанда, бұрауды босатыңыз.
- d. Тамырға енгізу кезінде, түтікшедегі қоспалар тығынға немесе иненің ұшына тимеуін қадағалаңыз.

C. PAXgene қан ДНҚ түтікшелеріндегі жиналған қан үлгісін мұздату және еріту процедурасы

1. PAXgene қан ДНҚ түтікшесін сым сөреге тігінен қойыңыз. Түтікшелер шытынатуын тудыруы мүмкін болғандықтан, түтікшелерді Styrofoam™ науасында тігінен мұздатпаңыз.
2. PAXgene қан ДНҚ түтікшелері -20°C және одан төменгі температурада сақталады. Егер түтікшелерді -20°C төменгі температурада сақталса, алдымен оларды -20°C температурада 24 сағат мұздатыңыз, содан кейін оларды -20°C , -70°C немесе -80°C -қа ауыстырыңыз.
3. PAXgene қан ДНҚ түтікшелерін ($18-25^{\circ}\text{C}$) бөлме температурасында шамамен екі сағат бойы сым сөреде ерітіңіз. PAXgene қан ДНҚ түтікшелерін 25°C жоғары температурада ерітпеңіз.
4. Еріген PAXgene қан ДНҚ түтікшелерін 10 рет мқият айналдырып, ауыстырыңыз.

Ескертпе: Мұздаған PAXgene қан ДНҚ түтікшелері соққыдан сынады. Тасымалдау кезінде сыну қаупін азайту үшін мұздатылған түтікшелер шыны түтікшелер сияқты қаралуы қажет. Пайдаланушылар PAXgene қан ДНҚ түтікшелеріне арналған өздерінің мұздатылған және тасымалданған хаттамаларын тексеруі қажет.

D. Талдауға арналған үлгілерді дайындау процедурасы


Қан үлгілері ДНҚ үлгілерін дайындау жинағымен бірге берілген нұсқауларға сәйкес өңделеді. Мысалдарды «Тапсырыс беру туралы ақпарат» бөлімінен қараңыз.

V. Жұмыс сипаттамалары

Қан түтікшеге енгізілгеннен кейін, ДНҚ $18-25^{\circ}\text{C}$ температурада 14 күн бойы тұрақтылығын сақтайды (1-сурет). ДНҚ тұрақтылығына жүргізілген зерттеулер негізінде, қанды түтікшеде 14 күн бойы $18-25^{\circ}\text{C}$, 28 күн бойы $2-8^{\circ}\text{C}$, 3 күн бойы 35°C немесе кемінде 6 ай бойы -20°C температурада $\geq 12,5$ нг/мкл ДНҚ концентрациясымен және 1,7–1,9 ДНҚ тазалығымен (A_{260}/A_{280}) сақтауға болады.

Мұздатылған үлгілердің тұрақтылығы туралы ең соңғы деректерді www.PreAnalytiX.com сайтынан қараңыз.

18–25°C температурадағы қан үлгілеріндегі ДНҚ тұрақтылығы

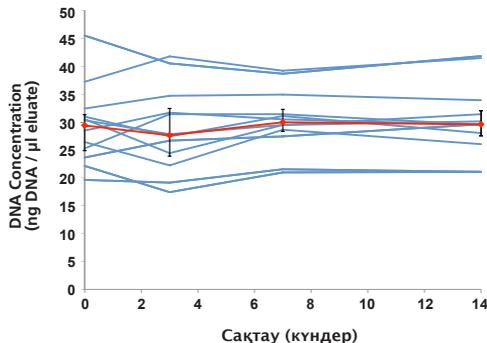

1-сурет

Қан алынып, PAXgene қан ДНҚ түтікшелерінде сақталды және QIAGEN QIASymphony автоматты құралындағы QIAGEN® QIASymphony® DSP ДНҚ шағын жинағының көмегімен толық ДНҚ тазартылды. Қан алынып, PAXgene қан ДНҚ түтікшелерінде сақталды және QIAGEN QIASymphony автоматты құралындағы QIAGEN® QIASymphony® DSP ДНҚ шағын жинағының көмегімен толық ДНҚ тазартылды.

VI. Шектеулер

1. Алынған қан мөлшері әрбір PAXgene қан ДНҚ түтікшесінде 2,5 мл болуы қажет, бірақ бұл көлем биіктік, қоршаған орта температурасы, барометрлік қысым, түтікшенің сақталу мерзімі, қан тамыры қысымы және толтыру әдісіне қарай әртүрлі болуы мүмкін.


VII. Сақтық шаралары

1. Әмбебап сақтық шараларын қолданыңыз. Қан шашырауы, қан ағуы және қан арқылы берілетін патогендердің ықтимал зақымынан қорғану үшін қолғаптар, халаттар, көз қорғанысы, басқа қорғаныс жабдықтарын және техникалық бақылау құралдарын пайдаланыңыз.
2. Барлық биологиялық және «өткір» қан жинау жинақтарын мекемеңіздің саясаттары мен процедураларына сәйкес пайдаланыңыз. Биологиялық үлгілердің (мысалға, тесілу арқылы жарақаттану) қандай да бір әсер етуі жағдайында тиісті медициналық көмек алыңыз, өйткені олар вирусты гепатит, ВИЧ инфекциясы (СПИД) және басқа жұқпалы ауруларды таратуы мүмкін.
Егер қан жинау құрылғысы біреуін ғана қамтамасыз етсе, қондырылған ине қорғағышын пайдаланыңыз. PreAnalytiX пайдаланылған инелерді қайтадан қаптауға кеңес бермейді. Дегенмен, мекемеңіздің саясаттары мен процедуралары басқаша болуы мүмкін және әрқашан орындалуы керек.
3. Тастауға рұқсат берілген биоқауіпті құтылардағы барлық қан жинау түтікшелерін тастаңыз.
4. PAXgene қан ДНҚ түтікшелерін қайта пайдаланбаңыз.
5. Түтікше жапсырмасындағы қолдану мерзімі өткеннен кейін PAXgene қан ДНҚ түтікшелерін пайдаланбаңыз.
6. Шамадан тыс центрифугалық жылдамдық (10 000 RCF аса) PAXgene Қан ДНҚ түтікше сынуына, қанмен жанасуға және мүмкін жарақаттардың туындауы мүмкін.
7. Үлгіні шприцтен түтікшеге ауыстырмаңыз.

VIII. Сақтау


1. Пайдаланбаған PAXgene қан ДНҚ түтікшелерін 18–25°C температурасында сақтаңыз. 40°C дейінгі шектеулі қозғалыс температурасына рұқсат етіледі. Түтікшелерді жарамдылық мерзімінен кейін пайдаланбаңыз.

IX. BD Гемогард қақпағын ашу нұсқаулары



1. Бас бармақты BD Гемогард қақпағы астына қоя отырып, PAXgene Қан ДНҚ түтікшесін бір қолмен ұстаңыз. (Қосымша тұрақтылық үшін қолды қатты жерге қойыңыз). **ТЕК ТҮТІКШЕ ТЫҒЫНЫ БОСАҒАНША, бас бармағыңызбен бір уақытта итеріп жатқанда, екінші қолмен BD Гемогард қақпағын айналдырыңыз**
2. Қақпақты көтермес бұрын, бас бармақты алыңыз. Түтікшенің қақпағын итеру үшін бас бармақты **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**. Егер түтікшеде қан болса, жанасу қаупі бар. Қақпақты ашу кезінде жарақаттың алдын алуға көмектесу үшін BD Гемогард қақпағы босатылысымен, қақпақты жоғары қарай итерген бас бармақ түтікше жанасуынан алынғаны маңызды.
3. Түтікше қақпағын көтеріп алыңыз. Пластик қорғанышты резина тығыннан ажырату сияқты сирек кездесетін жағдайда, **ҚАҚПАҚТЫ ҚАЙТА ОРНАЛАСТЫРМАҢЫЗ**. Резеңке тығынды түтікшеден абайлап алыңыз.

X. BD Гемогард қақпағын қайта салу нұсқаулары



1. Қақпақты түтікшенің үстіне қойыңыз.
2. Тығын толығымен орныққанша, мықты айналдырып, итеріңіз. Тығынның толық қайта салынуы өңдеу кезінде түтікті қауіпсіз қалдыру мақсатында қақпақ үшін қажет.

Техникалық қолдау

Егер PAXgene қан ДНҚ түтікшесіне қатысты қандай да бір сұрағыңыз болса, «BD – Тұтынушыға қызмет көрсету» бөліміндегі BD Техникалық қызмет көрсету бөлімдерінің біреуімен хабарласыңыз.

Тапсырыс беру туралы ақпарат

PAXgene өнімдері

PAXgene қан ДНҚ түтікшесі / 761165

Жинақтың құрамы: 1 000 қан жинау түтікшесі.

BD өнімдері*

BD Vacutainer Eclipse қан жинау инесі / 368609 CE

Жинақтың құрамы: 21G 1¼" дюймдік ине, 0,8 мм x 32 мм, 48/қорап, 480/құты

BD Vacutainer Eclipse тіркелген ұстағышты қан жинау инесі / 368650

Жинақтың құрамы: 21G 1¼" дюймдік ине, 0,8 мм x 32 мм, 100/құты

BD Vacutainer Eclipse Signal Қан жинау инесі / 368835 CE

Жинақтың құрамы: 21G 1¼" дюймдік ине, 0,8 мм x 32 мм, 50/қорап, 400/құты

BD Vacutainer бір рет пайдалануға арналған ұстағышы / 364815

Жинақтың құрамы: 13 мм and 16 мм диаметрге арналған құты 1000/құты

* Мына каталог нөмірлері PAXgene қан ДНҚ түтікшесімен бірге пайдаланылатын әдеттегі өнімдерді көрсетеді.

BD қан жинау қосымша құралдарына тапсырыс беру үшін:

Мына торапқа өтіңіз: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Елді таңдаңыз • BD диагностикалары – Преаналитикалық жүйелерге түсіңіз • Нөмірді теріңіз

QIAGEN өнімдері*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Жинақтың құрамы: Реагент картриджі, ферментті тірек, тесік қақпақ, АТЕ буфері, көп қолданысты тығыздағыш жинағы

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Жинақтың құрамы: QIAamp шағын спин-бағандар, жинағыш түтікшелер, AL буфері, ATL буфері, AW1 буфері, AW2 буфері, AE буфері, QIAGEN протеиназ еріткіші

QIAGEN Gentra® Puregene® қан жинағы / 158422 (3 мл) / 158445 (30 мл) / 158467 (120 мл) / 158389 (1000 мл)

Жинақтың құрамы: RBC лизис сұйығы, жасуша лизисі сұйығы, тұнбаның протеинді сұйығы, ДНК гидратация сұйығы, RNase A сұйығы

* Бұл каталог нөмірлері PAXgene қан ДНҚ түтікшесімен бірге пайдаланылатын әдеттегі ДНҚ дайындау жинақтарын көрсетеді.

QIAGEN DNA дайындық жинақтарына тапсырыс беру үшін:

Мына торапқа өтіңіз: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

PAXgene қан ДНҚ түтікшесін PreAnalytiX GmbH компаниясы үшін BD Ұлыбританияда жасаған. PAXgene және PreAnalytiX — PreAnalytiX GmbH компаниясының сауда белгілері; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene — QIAGEN NV компаниясының сауда белгілері; Styrofoam — The Dow Chemical Company компаниясының сауда белгісі; басқа барлық сауда белгілер — Weston, Dickinson and Company компаниясының меншігі.

(Жалғасы)

BD – Тұтынушыға қызмет көрсету

Аргентина, Уругвай және Парагвай

Тапсырыстар: 011.4551.7100

Электрондық пошта: crc_argentina@bd.com

Австралия

Тапсырыстар: 1.800.656.100

Факс: 1.800.656.110

Электрондық пошта: bd_anz@bd.com

Австрия

Тапсырыстар: 43.1.7063660

Факс: 43.1.7063660-11

Бельгия

Тапсырыстар: 32.53.720.556

Факс: 32.53.720.549

Бразилия

Тапсырыстар: 0800.055.5654

Электрондық пошта: consultoria_vacutainer@bd.com

Канада

Тапсырыстар: 800.268.5430

Факс: 800.565.0897

Электрондық пошта: custsvccan@bd.com

Дания

Тапсырыстар: 45.43.43.45.66

Факс: 45.43.96.56.76

Электрондық пошта: bdcs_dk@europe.bd.com

Шығыс Еуропа

Тапсырыстар: 48.22.651.75.88

Факс: 48.22.651.75.89

Финляндия

Тапсырыстар: 358.9.88.70.780

Факс: 358.9.88.70.7816

Электрондық пошта: bdorder_finland@europe.bd.com

Франция

Тапсырыстар: 33.476.689496

Факс: 33.476.683693

Электрондық пошта: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Германия

Тапсырыстар: 49.6221305553

Факс: 49.6221305379

Италия

Тапсырыстар: 39.02.48.240.500

Факс: 39.02.48.240.344

Техникалық: 39.02.48.240.264

Электрондық пошта: ordini_medicale@europe.bd.com

Таяу Шығыс және Африка (ЕТША)

Тапсырыстар: 971.4.3379525

Факс: 971.4.03379551

Электрондық пошта: EMA_PAS@bd.com

Нидерланд

Тапсырыстар: 31.20.6545.716

Факс: 31.20.5829.421

Электрондық пошта: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Жаңа Зеландия

Тапсырыстар: 0800.572.468

Факс: 0800.572.469

Электрондық пошта: bd_anz@bd.com

Норвегия:

Тапсырыстар: 47.73.59.12.00

Факс: 47.73.59.12.01

Испания

Тапсырыстар: 34.902.27.17.27

Факс: 34.91.848.81.04

Электрондық пошта: servicio_de_clientes@bd.com

Швеция

Тапсырыстар: 46.8.775.51.60

Факс 46: 8.775.51.95

Электрондық пошта: bdorder_sweden@europe.bd.com

Швейцария

Тапсырыстар: 41.61.4852222

Тапсырыстар: 41.61.4852200

Ұлыбритания

Тапсырыстар: 44.1.865.781.666

Факс: 44.1.865.717.313

Электрондық пошта:

bduk_customerservice@europe.bd.com

АҚШ

Тапсырыстар: 888.237.2762

Факс: 800.847.2220

Техникалық: 800.631.0174

Электрондық пошта: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Тұтынушыға қызмет көрсету

Австралия

Тапсырыстар: 03.9840.9800

Факс: 03.9840.9888

Техникалық: 1.800.243.066

Австрия

Тапсырыстар: 0800/28.10.10

Факс: 0800/28.10.19

Техникалық: 0800/28.10.11

Бельгия

Тапсырыстар: 0800.79612

Факс: 0800.79611

Техникалық: 0800.79556

Канада

Тапсырыстар: 800.572.9613

Факс: 800.713.5951

Техникалық: 800.DNA.PREP

(800.362.7737)

Қытай

Тапсырыстар: 0086.21.3865.3865

Факс: 0086.21.3865.3965

Техникалық: 800.988.0325 / 800.988.0327

Дания

Тапсырыстар: 80.885945

Факс: 80.885944

Техникалық: 80.885942

Финляндия

Тапсырыстар: 0800.914416

Факс: 0800.914415

Техникалық: 0800.914413

Франция

Тапсырыстар: 01.60.920.926

Факс: 01.60.920.925

Техникалық: 01.60.920.930

Ұсыныстар: 01.60.920.928

Германия

Тапсырыстар: 02103.29.12000

Факс: 02103.29.22000

Техникалық: 02103.29.12400

Гонконг

Тапсырыстар: 800.933.965

Факс: 800.930.439

Техникалық: 800.930.425

Ирландия

Тапсырыстар: 1800.555.049

Факс: 1800.555.048

Техникалық: 1800.555.061

Италия

Тапсырыстар: 02.33430411

Факс: 02.33430426

Техникалық: 800.787980

Жапония

Телефон: 03.5547.0811

Факс: 03.5547.0818

Техникалық: 03.5547.0811

Корея (Оңтүстік)

Тапсырыстар: 1544.7145

Факс: 1544.7146

Техникалық: 1544.7145

Люксембург

Тапсырыстар: 8002.2076

Факс: 8002.2073

Техникалық: 8002.2067

Нидерланд

Тапсырыстар: 0800.0229592

Факс: 0800.0229593

Техникалық: 0800.0229602

Норвегия

Тапсырыстар: 800.18859

Факс: 800.18817

Техникалық: 800.18712

Сингапур

Тапсырыстар: 65.67775366

Факс: 65.67785177

Техникалық: 65.67775366

Испания

Тапсырыстар: 91.630.7050

Факс: 91.630.5145

Техникалық: 91.630.7050

Швеция

Тапсырыстар: 020.790282

Факс: 020.790582

Техникалық: 020.798328

Швейцария

Тапсырыстар: 055.254.22.11

Факс: 055.254.22.13

Техникалық: 055.254.22.12

Ұлыбритания

Тапсырыстар: 01293.422.911

Факс: 01293.422.922

Техникалық: 01293.422.999

АҚШ

Тапсырыстар: 800.426.8157

Факс: 800.718.2056

Техникалық: 800.DNA.PREP

(800.362.7737)

혈액 DNA 튜브

KO - 한국어

I. 용도

PAXgene 혈액 DNA 튜브는 DNA가 필요한 분자 진단 검사법에 사용되는 고품질 DNA 준비를 위한 정맥 전혈 샘플을 수집, 항응고, 안정화, 이동 및 보관하는 용도로 사용됩니다.

본 장치의 성능 특성은 일반적으로 분자 진단 분석에 대해 확립되지 않았습니다. 사용자는 본인의 특정 분자 진단 분석을 위한 제품 용도를 확인해야 합니다.

제품 특징

PAXgene 혈액 DNA 튜브 • 2.5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA 첨가제
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 튜브/유통용 상자 • 1,000 튜브/케이스

II. 요약 및 설명

PAXgene 혈액 DNA 튜브는 밀봉된 진공 시스템에 유전체 DNA를 분리하는 데 필요한 전혈을 채취하기 위한 수단을 제공합니다. 혈액은 표준 정맥 절개 프로토콜에 따라 K₂EDTA의 첨가제가 함유된 진공 튜브에 채워집니다. DNA의 완전한 분리는 염색 침전, 자기 구술 또는 실리카막 기반 기법과 같은 수동 및 자동 기법을 사용하여 수행됩니다.

III. 경고

튜브의 내용물은 피부에 자극을 줍니다.


- 흡입한 경우 깨끗한 공기가 있는 곳으로 이동해야 합니다.
- 피부에 접촉한 경우 즉시 다량의 비누와 물로 15분 이상 피부를 씻으십시오.
- 눈에 들어간 경우 즉시 다량의 비누와 물로 15분 이상 눈을 씻으십시오.
- 삼켰을 경우 즉시 다량의 물을 섭취하고 의사의 진료를 받아야 합니다.

IV. 분석을 위한 검체 수집 및 준비

A. 필수 채혈 부속품(PAXgene 혈액 DNA 튜브에 미포함)

1. BD Vacutainer® Eclipse™ 채혈 바늘 또는 BD Vacutainer Eclipse Signal™ 채혈 바늘 등의 채혈 바늘 주문 정보를 참조하십시오.
2. 적절한 기능을 위해 BD Vacutainer 바늘 홀더를 사용해야 합니다. 주문 정보를 참조하십시오.
3. 양성 기준자 샘플 식별 라벨(필요 시).
4. 부위 세척을 위한 알코올 스포.
5. 건조된 멸균 거즈.
6. 지혈대.
7. 사용한 바늘 또는 바늘/홀더 조합을 위한 바늘 폐기 용기.

B. 검체 수집 절차



일반적인 지침

정맥 천자 시 그리고 체혈 튜브 취급 시 노출 위험을 최소화하기 위해 장갑을 착용하십시오.

1. 바늘을 홀더에 조립합니다. 사용 중 바늘이 빠져나오지 않도록 바늘이 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
2. 튜브를 홀더에 넣습니다. 참고: 마개에 구멍을 뚫지 마십시오.
3. 정맥 천자 부위를 선택합니다.
4. 지혈대를 배치합니다. 적절한 속도로 정맥 천자 부위를 준비합니다. 세척 후 정맥 천자 부위를 만지지 마십시오.
5. 환자의 팔을 하향 자세로 놓습니다.
6. 바늘 보호덮개를 제거합니다. 팔을 하향으로 튜브 마개는 맨 위로 하여 정맥 천자를 실시합니다.
7. 마개를 관통할 때 튜브를 홀더 중심에 두어 축적 침투와 그에 따른 조기 진공 손실을 방지합니다. 튜브를 바늘에 밀어 넣어 마개 가로막을 뚫습니다.
8. 튜브에 혈액이 나타나면 바로 지혈대를 제거합니다. 시술 중 튜브의 내용물이 마개나 바늘 끝에 닿지 않도록 하십시오.

참고: 혈액이 가끔 바늘 슬리브에서 누출될 수 있습니다. 보편적인 사전주의사항을 실행하여 노출 위험을 최소화하십시오. 튜브에 혈액이 흐르지 않거나 적절한 검체가 수집되기 전에 혈액이 흐름을 멈춘 경우, 성공적인 수집을 완료하기 위해 다음과 같은 단계를 제안합니다.

- a. 튜브 마개가 뚫릴 때까지 튜브를 앞으로 밀니다. 필요한 경우 안전한 진공 체혈을 위해 적절한 고정시킵니다.
- b. 정맥 내 바늘의 정확한 위치를 확인하십시오.

9. 튜브가 명시된 체혈량까지 채워지고 혈액 흐름이 멈추면, 튜브를 홀더에서 제거합니다.

10. 8회 뒤집습니다.

11. 정맥에서 바늘을 제거합니다. 이때 피가 멈출 때까지 건조된 멸균 스왑으로 천자 부위를 누릅니다.

12. 일단 응고가 일어나면 바람직한 경우 봉대를 사용합니다.

13. 정맥 천자 후 마개 상단에 잔류 혈액이 있을 수 있습니다. 튜브를 취급할 때 적절한 사전주의조치를 취하여 혈액과의 접촉을 피하십시오.

14. 해당 시설의 정책 및 지침에 따라 바늘과 홀더를 버리십시오.

15. 혈액이 채워진 PAXgene 혈액 DNA 튜브는 실내 온도(18-25° C)에서 보관하십시오. 실내 온도(18-25° C), 2-8° C 또는 -20° C 에서의 혈액 샘플 내 DNA 안정성은 성능 특성을 참조하십시오.

-70° C/-80° C 의 보관 온도가 바람직한 경우, 세부 정보는 PAXgene 혈액 DNA 튜브의 검체 냉동 및 해동에 대한 절차를 참조하십시오.

역류 가능성을 방지하기 위해 다음과 같은 기법을 사용할 수 있습니다.

- a. 기증자의 팔을 하향 자세로 놓습니다.
- b. 튜브는 마개의 가장 윗 부분을 잡습니다.
- c. 혈액이 튜브로 흐르기 시작하면 바로 지혈대를 짭니다.
- d. 정맥 천자 시 튜브 첨가제가 마개나 바늘 끝에 닿지 않도록 합니다.

C. PAXgene 혈액 DNA 튜브에 수집된 검체의 냉동 및 해동 절차

1. PAXgene 혈액 DNA 튜브를 선 겹이에 똑바로 세웁니다. styrofoamStyrofoam™ 트레이에서는 튜브를 수직으로 냉동시키지 마십시오. 튜브에 균열이 생길 수 있습니다.
2. PAXgene 혈액 DNA 튜브는 -20° C 이하에서 보관할 수 있습니다. 튜브를 -20° C 이하에서 보관할 경우, 먼저 -20° C에서 24시간 냉동시킨 다음 -70° C 또는 -80° C로 온도를 낮춰 보관하십시오.
3. 선 겹이에 있는 PAXgene 혈액 DNA 튜브를 주위 온도(18-25° C)에서 약 2시간 동안 해동시킵니다. PAXgene 혈액 DNA 튜브를 25° C 이상의 온도에서 해동시키지 마십시오.
4. 해동된 PAXgene 혈액 DNA 튜브를 조심스럽게 10회 뒤집습니다.

참고: 냉동된 PAXgene 혈액 DNA 튜브는 충격을 받으면 파손됩니다. 배송 중 파손 위험을 감소시키려면 냉동된 튜브를 유리 튜브와 같은 방식으로 취급해야 합니다. 사용자는 PAXgene DNA 튜브에 대한 자체 냉동 및 배송 프로토콜을 확인해야 합니다.

D. 분석을 위한 검체 준비 절차

혈액 샘플은 DNA 샘플 준비 키트와 함께 제공된 지침에 따라 처리되어야 합니다. 예는 주문 정보를 참조하십시오.

V. 성능 특성

혈액이 튜브에 삽입된 후, DNA는 18° C-25° C에서 14일 동안 안정적으로 유지됩니다(그림 1). DNA 안정성 연구에 근거했을 때 혈액은 18° C-25° C에서 14일 동안, 2° C-8° C에서 28일 동안, 35° C에서 3일 동안 또는 -20° C에서 최소 6개월 동안 보관에서 DNA 농도 $\geq 12.5 \text{ ng}/\mu\text{l}$ 및 DNA 순도 1.7-1.9의 (A_{260}/A_{280})인 상태로 보관할 수 있습니다.

냉동된 검체의 안정성에 대한 최신 데이터는 www.PreAnalytix.com을 방문하십시오.

18-25° C 에서의 혈액 내 DNA 안정성

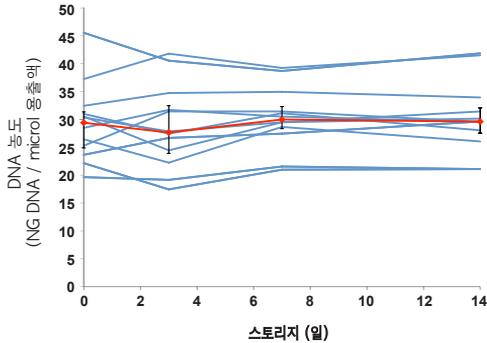


그림 1

혈액은 시험에 동위한 12명의 성인 기증자에서 채혈하여 전체 DNA 정제 후 지정된 날짜 동안 18-25° C 에서 보관하였습니다. 혈액은 PAXgene 혈액 DNA 튜브에 채취 및 보관하였고 전체 DNA는 QIAGEN® QIAasympomy® DSP DNA Mini 키트를 사용하여 QIAGEN QIAasympomy 자동화 기기에서 정제되었습니다.

VI. 한계

1. 채혈된 혈액의 양은 PAXgene 혈액 DNA 튜브 당 2.5 ml여야 하지만 이러한 용량은 고도, 주위 온도, 기압, 튜브 수명, 정맥압 및 채혈 기술에 따라 달라질 수 있습니다.

VII. 사전주의사항

1. 보편적인 사전주의사항을 실행하십시오. 장갑, 가운, 눈 보호 장치, 기타 개인 보호 장비 및 엔지니어링 제어방법을 사용하여 혈액이 튀는 것, 혈액 누출 및 혈액매개 병원균에 대한 잠재적 노출로부터 보호하십시오.
2. 모든 생물학적 샘플과 채혈 세트는 귀하 시설의 방침과 절차에 의거하여 "정확하게" 취급하십시오. 생물학적 샘플은 바이러시스 감염, HIV(에이즈) 또는 기타 감염성 질병을 전파할 수 있으므로 이러한 샘플에 노출되는 경우(예: 천자 상해를 통해) 적절한 치료를 받으십시오.


내장된 바늘 보호기가 채혈 세트에 제공되는 경우 이 보호기를 활용하십시오. PreAnalytix는 사용된 바늘을 다시 넣는 것을 권장하지 않습니다. 하지만 해당 시설의 정책 및 절차가 다를 수 있으니 항상 이를 따라야 합니다.

3. 모든 채혈 튜브는 승인된 생물유해물질용 폐기 용기에 폐기하십시오.
4. PAXgene 혈액 DNA 튜브를 재사용하지 마십시오.
5. 튜브 라벨에 인쇄된 유효기간이 지난 PAXgene 혈액 DNA 튜브는 사용하지 마십시오.
6. 과도한 원심 분리 속도(10,000 RCF 초과)는 PAXgene 혈액 DNA 튜브 파손, 혈액 노출 및 상해를 일으킬 수 있습니다.
7. 샘플을 주사기에서 튜브로 옮기지 마십시오.

VIII. 보관

1. 미사용 PAXgene 혈액 DNA 튜브는 18° C - 25° C 에서 보관하십시오. 일탈 온도 제한은 최대 40° C까지 허용됩니다. 유효기간이 지난 튜브는 사용하지 마십시오.


IX. BD Hemogard 마개 제거 지침



1. 한 손으로 PAXgene 혈액 DNA 튜브를 잡고 엄지를 BD Hemogard 마개 아래에 놓습니다. (딱딱한 표면에 팔을 놓으면 보다 안정적입니다). 튜브 마개가 느슨해질 때까지 엄지로 마개를 위로 밀어 올리는 동시에 다른 손으로는 BD Hemogard 마개를 들립니다.
2. 마개를 옮기 전에 엄지를 떼어 냅니다. 마개를 튜브에서 떼는 데 엄지를 사용하지 마십시오. 튜브에 혈액이 함유되어 있는 경우 노출 위험이 존재합니다. 마개를 제거하는 동안 손상을 예방하려면 BD Hemogard 마개가 느슨해질 때 바로 마개를 위로 올리는 데 사용한 엄지가 튜브와 접촉하지 않도록 떼는 것이 중요합니다.
3. 마개를 튜브에서 들어 올립니다. 예기치 못하게 플라스틱 덮개가 고무 마개에서 분리되는 경우, 마개를 다시 조립하지 마십시오. 고무 마개를 튜브에서 조심스럽게 제거하십시오.

(계속)

X. BD Hemogard 마개 재삽입 지침



1. 튜브 위에 마개를 다시 놓습니다.
2. 마개가 완전하게 다시 장착될 때까지 마개를 돌려서 아래로 단단히 누릅니다. 워급 중 마개가 튜브에 단단히 유지되려면 마개를 완전하게 재삽입해야 합니다.

기술 지원

PAXgene 혈액 DNA 튜브와 관련된 문의 사항은 BD - 고객 서비스 웹에 기재된 BD 기술 서비스팀에 문의하십시오.

주문 정보

PAXgene 제품

PAXgene 혈액 DNA 튜브/761165
내용물: 채혈 튜브 1,000개.

BD 제품*

BD Vacutainer Eclipse 채혈 바늘/368609 CE
내용물: 21G 1 $\frac{1}{4}$ " 인치 바늘, 0.8 mm x 32 mm, 48개/박스, 480개/케이스
사전 부착된 홀더가 있는 BD Vacutainer Eclipse 채혈 바늘/368650
내용물: 21G 1 $\frac{1}{4}$ " 인치 바늘, 0.8 mm x 32 mm, 100개/케이스
BD Vacutainer Eclipse Signal 채혈 바늘/368835 CE
내용물: 21G 1 $\frac{1}{4}$ " 인치 바늘, 0.8 mm x 32 mm, 50개/박스, 400개/케이스
BD Vacutainer 일회용 홀더/364815
내용물: 13 mm 및 16 mm 직경 1000개/케이스 전용 케이스

* 본 카탈로그 번호는 PAXgene 혈액 DNA 튜브와 함께 사용될 수 있는 일반적인 제품을 나타냅니다.

BD 채혈 부속품 주문 방법:

다음 주소 방문: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>
• 국가 선택 • 아래로 스크롤 하여 BD 진단법 - 분석 전 시스템으로 이동 • 해당 번호로 전화

QIAGEN 제품*

QIAGEN QIAAsymphony DSP DNA 키트/937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)
내용물: 시약 카트리지, 효소 거치대, 뿔쪽한 부분이 있는 뚜껑, 완충 ATE, 재사용 가능 밀봉 세트
QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)
내용물: QIAamp Mini 스핀 필름, 채혈 튜브, 완충 AL, 완충 ATL, 완충 AW1, 완충 AW2, 완충 AE, QIAGEN 프로테아제, 프로테아제 용액
QIAGEN Gentra® Puregene® 혈액 키트/158422(3 ml)/158445(30 ml)/158467(120 ml)/158389(1000 ml)
내용물: RBC 용해 용액, 세포 용해 용액, 단백질 침전 용액, DNA 수화 용액, RNase A 용액
* 본 카탈로그 번호는 PAXgene 혈액 DNA 튜브와 함께 사용될 수 있는 일반적인 DNA 준비 키트를 나타냅니다.

QIAGEN DNA 준비 키트 주문 방법:

다음 주소 방문: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

PAXgene 혈액 DNA 튜브는 PreAnalytX GmbH용으로 BD가 영국에서 제조합니다. PAXgene 및 PreAnalytX는 PreAnalytX GmbH의 상표입니다. QIAGEN, QIAAsymphony, QIAamp, Gentra, Puregene는 QIAGEN NV의 상표입니다. Styrofoam은 Dow Chemical Company의 상표입니다. 기타 모든 상표는 Becton, Dickinson and Company의 소유입니다.

(계속)

BD - 고객 서비스

아르헨티나, 우르과이 및 파라과이

주문: 011.4551.7100

이메일: crc_argentina@bd.com

호주

주문: 1.800.656.100

팩스: 1.800.656.110

이메일: bd_anz@bd.com

오스트리아

주문: 43.1.7063660

팩스: 43.1.7063660-11

벨기에

주문: 32.53.720.556

팩스: 32.53.720.549

브라질

주문: 0800.055.5654

이메일: consultoria_vacutainer@bd.com

캐나다

주문: 800.268.5430

팩스: 800.565.0897

이메일: custsvccan@bd.com

덴마크

주문: 45.43.43.45.66

팩스: 45.43.96.56.76

이메일: bdcs_dk@europe.bd.com

동유럽

주문: 48.22.651.75.88

팩스: 48.22.651.75.89

핀란드

주문: 358.9.88.70.780

팩스: 358.9.88.70.7816

이메일: bdorder_finland@europe.bd.com

프랑스

주문: 33.476.689496

팩스: 33.476.683693

이메일: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

독일

주문: 49.6221305553

팩스: 49.6221305379

이탈리아

주문: 39.02.48.240.500

팩스: 39.02.48.240.344

기술 서비스: 39.02.48.240.264

이메일: ordini_medicale@europe.bd.com

중동 및 아프리카(EMA)

주문: 971.4.3379525

팩스: 971.4.03379551

이메일: EMA_PAS@bd.com

네덜란드

주문: 31.20.6545.716

팩스: 31.20.5829.421

이메일: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

뉴질랜드

주문: 0800.572.468

팩스: 0800.572.469

이메일: bd_anz@bd.com

노르웨이:

주문: 47.73.59.12.00

팩스: 47.73.59.12.01

스페인

주문: 34.902.27.17.27

팩스: 34.91.848.81.04

이메일: servicio_de_clientes@bd.com

스웨덴

주문: 46.8.775.51.60

팩스: 46.8.775.51.95

이메일: bdorder_sweden@europe.bd.com

스위스

주문: 41.61.4852222

주문: 41.61.4852200

영국

주문: 44.1.865.781.666

팩스: 44.1.865.717.313

이메일: bduk_customerservice@europe.bd.com

미국

주문: 888.237.2762

팩스: 800.847.2220

기술 서비스: 800.631.0174

이메일: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN - 고객 서비스

호주

주문: 03.9840.9800

팩스: 03.9840.9888

기술 서비스: 1.800.243.066

오스트리아

주문: 0800/28.10.10

팩스: 0800/28.10.19

기술 서비스: 0800/28.10.11

벨기에

주문: 0800.79612

팩스: 0800.79611

기술 서비스: 0800.79556

캐나다

주문: 800.572.9613

팩스: 800.713.5951

기술 서비스: 800.DNA.PREP

(800.362.7737)

중국

주문: 0086.21.3865.3865

팩스: 0086.21.3865.3965

기술 서비스: 800.988.0325 / 800.988.0327

덴마크

주문: 80.885945

팩스: 80.885944

기술 서비스: 80.885942

핀란드

주문: 0800.914416

팩스: 0800.914415

기술 서비스: 0800.914413

프랑스

주문: 01.60.920.926

팩스: 01.60.920.925

기술 서비스: 01.60.920.930

제품: 01.60.920.928

독일

주문: 02103.29.12000

팩스: 02103.29.22000

기술 서비스: 02103.29.12400

홍콩

주문: 800.933.965

팩스: 800.930.439

기술 서비스: 800.930.425

아일랜드

주문: 1800.555.049

팩스: 1800.555.048

기술 서비스: 1800.555.061

이탈리아

주문: 02.33430411

팩스: 02.33430426

기술 서비스: 800.787980

일본

전화: 03.5547.0811

팩스: 03.5547.0818

기술 서비스: 03.5547.0811

대한민국

주문: 1544.7145

팩스: 1544.7146

기술 서비스: 1544.7145

룩셈부르크

주문: 8002.2076

팩스: 8002.2073

기술 서비스: 8002.2067

네덜란드

주문: 0800.0229592

팩스: 0800.0229593

기술 서비스: 0800.0229602

노르웨이

주문: 800.18859

팩스: 800.18817

기술 서비스: 800.18712

싱가포르

주문: 65.67775366

팩스: 65.67785177

기술 서비스: 65.67775366

스페인

주문: 91.630.7050

팩스: 91.630.5145

기술 서비스: 91.630.7050

스웨덴

주문: 020.790282

팩스: 020.790582

기술 서비스: 020.798328

스위스

주문: 055.254.22.11

팩스: 055.254.22.13

기술 서비스: 055.254.22.12

영국

주문: 01293.422.911

팩스: 01293.422.922

기술 서비스: 01293.422.999

미국

주문: 800.426.8157

팩스: 800.718.2056

기술 서비스: 800.DNA.PREP

(800.362.7737)

Kraujo DNR mėgintuvėlis

LT – Lietuvių k.

I. Paskirtis

„PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlis naudojamas veniniam visos sudėties kraujo mėginiui paimti, antikoaguliuoti, stabilizuoti, transportuoti ir laikyti, norint paruošti aukštos kokybės DNR, naudojamą su molekulinės diagnostikos tyrimų metodais, kuriems reikalinga DNR.

Šio įtaiso veikimo charakteristikos nebuvo bendrai įvertintos atliekant molekulinės diagnostikos tyrimus. Naudotojai turi apčiuoti produkto naudojimą atliekant specifinį molekulinės diagnostikos tyrimą.

Produkto savybės

„PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlis • 2,5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA priedo 761165 • „Plus“ • „BD Hemogard™“ • 100 mėgintuvėlių lentynos dėžutėje • 1 000 mėgintuvėlių dėžėje

II. Santrauka ir paaiškinimas

„PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlis suteikia priemonės visos sudėties kraujo mėginiui imti, norint išskirti genomą DNR uždaroje vakuuminėje sistemoje. Kraujas imamas į vakuuminį mėgintuvėlį, kuriame yra K₂EDTA priedo, taikant standartinį flebotomijos protokolą. Visiškas DNR išskyrimas atliekamas naudojant neautomatinius arba automatinius metodus, pvz., nusodinimą druska, magnetines granules arba silicio dioksido membranos pagrindu sukurtas technologijas.

III. Įspėjimai

Šio mėgintuvėlio turinys dirgina odą.


- Įkvėpusį nukentėjusįjį perneškite į gryną orą.
- Patekus ant odos nedelsiant plaukite odą dideliu muilo ir vandens kiekiu bent 15 minučių.
- Patekus į akis nedelsiant plaukite dideliu vandens kiekiu bent 15 minučių.
- Prarijus nedelsiant duokite gerti didelį vandens kiekį. Kreipkitės pagalbos į medikus.

IV. Mėginių ėmimas ir ruošimas analizei

A. Reikalingi kraujo ėmimo reikmenys (nepridėti su „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėliu)

1. Kraujo ėmimo adata, pvz., „BD Vacutainer® Eclipse™“ kraujo ėmimo adata arba „BD Vacutainer Eclipse Signal™“ kraujo ėmimo adata. Žr. „Užsakymo informacija“.
2. Norint užtikrinti tinkamą veikimą, reikia naudoti „BD Vacutainer“ adatos laikiklį. Žr. „Užsakymo informacija“.
3. Teigiamo donoro mėginių identifikavimo etiketės (jei reikia).
4. Alkoholiu suvilgytas tamponas vietai dezinfekuoti.
5. Sausa sterili marlė.
6. Turniketas.
7. Adatų utilizavimo konteineris panaudotai adatai ar adatos / laikiklio deriniui.

B. Mėginių ėmimo procedūra



(tęsinys)

Bendrosios instrukcijos

KAD SUMAŽINTUMĖTE SĄLYČIO PAVOJŲ, ATLIKDAMI VENOS PUNKCIJĄ IR TVARKYDAMI KRAUJO ĖMIMO MĖGINTUVĒLIUS MŪVĖKITE PIRŠTINES.

1. Adatą įstatykite į laikiklį. Kad naudojama adata neatsisuktų, būtina ją tvirtai įstatyti.
2. Mėgintuvėlį įdėkite į laikiklį. Pastaba: nepradurkite kamštelio.
3. Pasirinkite venos punkcijos vietą.
4. **Uždėkite turniketą. Tinkamu antiseptiku paruoškite venos punkcijos vietą. DEZINFEKAVĘ VENOS PUNKCIJOS SRITĮ, JOS NESPAUDYKITE.**
5. Nuleiskite paciento ranką žemyn.
6. Nuimkite adatos apsaugą. Atlikite venos punkciją ESANT NULEISTAI RANKAI IR VIRŠUN NUKREIPTU MĖGINTUVĒLIO KAMŠTELIU.
7. Kai perduriate kamštelį, mėgintuvėlius sucentruokite laikiklyje, kad išvengtumėte šoninės sienos pradūrimo ir pirmalaikio vakuumo netekimo. Mėgintuvėlį užstumkite ant adatos perdurdami kamštelio diafragmą.
8. KAI TIK MĖGINTUVĒLYJE PASIRODO KRAUJO, NUIMKITE TURNIKETĄ. PROCEDŪROS METU NELEISKITE MĖGINTUVĒLIO TURINIUI LIESTIS SU KAMŠTELIU AR ADATOS GALU.

Pastaba: kraujo gali atsitiktinai ištekti iš adatos movos. Norėdami sumažinti sąlyčio pavojų, laikykitės universaliųjų atsargumo priemonių. Jeigu į mėgintuvėlį neteka kraujas arba kraujas nustoja tekėti prieš paimant reikiamą mėginio kiekį, kad paėmimas būtų patenkinamai užbaigtas, siūloma atlikti toliau nurodytus veiksmus.

- a. Stumkite mėgintuvėlį pirmyn, kol bus pradurtas mėgintuvėlio kamštelis. Jeigu reikia, laikykite, kad būtų užtikrintas visiškas pritraukimas vakuumu.
 - b. Patikrinkite, ar teisinga adatos padėtis venoje.
9. Kai mėgintuvėlis prisipildo iki nurodyto tūrio ir kraujas nustoja tekėti, ištraukite mėgintuvėlį iš laikiklio.
 10. Apverskite 8 kartus.
 11. Ištraukite adatą iš venos, spausdami punkcijos vietą sausu steriliu tamponu, kol nustos kraujuoti.
 12. Jei reikia, užkrešėjus užklijuokite pleistrą.
 13. Po venos punkcijos ant kamštelio viršaus gali likti kraujo. Tvarkydami mėgintuvėlius imkitės reikiamų atsargumo priemonių, kad išvengtumėte sąlyčio su šiuo krauju.
 14. Adatą ir laikiklį išmeskite laikydamiesi savo įstaigos taisyklių ir rekomendacijų.
 15. Užpildytą „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlį laikykite kambario temperatūroje (18-25°C). Skyriuje „Veikimo charakteristikos“ pateikta informacijos apie DNR stabilumą kraujo mėginiuose kambario temperatūroje (18-25°C), 2-8°C temperatūroje ar -20°C temperatūroje.

Jei reikia išsamios informacijos apie procedūrą, kai norima laikymo temperatūra yra -70°C / -80°C, žr. mėginių užšaldymo ir atšildymo procedūrą „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėliuose.

Toliau pateiktos metodikos, kurias reikia naudoti norint išvengti galimo grįžtamojo tekėjimo:

- a. Nuleiskite donoro ranką žemyn.
- b. Laikykite mėgintuvėlį su dangteliu viršuje.
- c. Atleiskite turniketą, kai tik kraujas pradės tekėti į mėgintuvėlį.
- d. Pasirūpinkite, kad atliekant venos punkciją mėgintuvėlio priedai nesiliestų prie kamštelio arba adatos galiuko.

C. Mėginių, surinktų „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėliuose, užšaldymo ir atšildymo procedūra

1. Pastatykite stačią „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlį į vielinį stovėlį. **Neužšaldykite stačių mėgintuvėlių putplasčio „Styrofoam™“ dėkle, nes mėgintuvėliai gali suskilti.**

2. „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlius galima laikyti -20°C ir žemesnėje temperatūroje. Jei mėgintuvėliai bus laikomi žemesnėje nei -20°C temperatūroje, pirmiausia juos užšaldykite -20°C temperatūroje ir palaikykite 24 val., tada perneškite į -70°C arba -80°C temperatūros aplinką.
3. Atšildykite „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlius vieniame stovelyje aplinkos temperatūroje (18-25°C) per maždaug dvi valandas. **Neatšildykite „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlių aukštesnėje nei 25°C temperatūroje.**
4. Atsargiai apverskite atšildytus „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlius 10 kartų.

Pastaba: užšaldyti „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėliai sutrenkti gali sudužti. Kad sumažėtų sudužimo rizika siuntimo metu, su užšaldytais mėgintuvėliais reikia elgtis kaip su stikliniais mėgintuvėliais. Naudotojai turi patvirtinti jų nuosavą „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlių užšaldymo ir siuntimo protokolą.

D. Mėginio paruošimo analizei procedūra


Kraujo mėginius reikia apdoroti pagal DNR mėginio paruošimo rinkinyje pateiktas instrukcijas. Pavyzdžių ieškokite skyrelyje „Užsakymo informacija“.

V. Veikimo charakteristikos

Įpylus kraujo į mėgintuvėlį DNR lieka stabili 14 dienų 18-25°C temperatūroje (1 pav.). Remiantis DNR stabilumo tyrimais, kraują mėgintuvėlyje galima laikyti 14 dienų 18-25°C temperatūroje, 28 dienas 2-8°C temperatūroje, 3 dienas 35°C temperatūroje arba mažiausiai 6 mėnesius -20°C temperatūroje, kai DNR koncentracija yra $\geq 12,5$ ng/ μ l, o DNR grynumas (A_{260}/A_{280}) iš 1,7–1,9.

Norėdami gauti naujausius duomenis apie užšaldytų mėginių stabilumą, eikite į www.PreAnalytiX.com.

DNR stabilumas kraujo mėginiuose 18-25°C temperatūroje

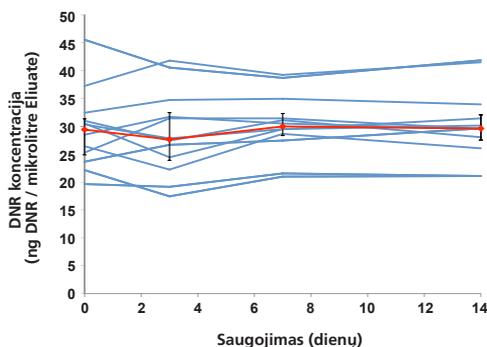

1 pav.

Kraujas buvo paimtas iš 12 sutikimo formą pasirašiusių suaugusiųjų donorų ir laikytas 18-25°C temperatūroje nurodytą laikotarpį, po kurio buvo atliktas visos DNR gryninimas. Kraujas buvo surinktas ir laikomas „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėliuose ir visa DNR buvo išgryninta naudojant „QIAGEN® QIAAsymphony® DSP“ DNR mažąjį rinkinį automatizuotame prietaise „QIAGEN QIAAsymphony“.

VI. Apribojimai

1. Paimto kraujo kiekis turi būti 2,5 ml viename „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlyje, bet šis tūris gali skirtis atsižvelgiant į aukštį, aplinkos temperatūrą, barometrinį slėgį, mėgintuvėlio naudojimo laikotarpį, veninį kraujospūdį ir užpildymo techniką.


VII. Atsargumo priemonės

1. Taikykite universaliąsias atsargumo priemones. Kad apsaugotumėte nuo apsitaisymo krauju, išsiliejusio kraujo ir galimo sąlyčio su kraujo patogenais, mūvėkite pirštines, dėvėkite akių apsaugą ir kitą asmens apsaugos įrangą bei naudokite inžinerines kontrolės priemones.
2. Visus biologinius mėginius ir kraujo ėmimo rinkinių aštrius komponentus naudokite laikydamiesi įstaigoje taikomų taisyklių ir procedūrų. Sąlyčio su biologiniais mėginiais atveju (pavyzdžiui, įsidūre) kreipkitės atitinkamos pagalbos į gydytojus, nes mėginiai gali pernešti virusinį hepatitą, ŽIV (AIDS) arba kitas infekcines ligas.
Naudokite pridėtą adatos apsaugą, jeigu pateikta kraujo ėmimo rinkinyje. „PreAnalytiX“ nerekomenduoja pakartotinai uždengti panaudotų adatų. Tačiau jūsų įstaigos taisyklės bei procedūros gali skirtis ir jų būtina visuomet laikytis.
3. Visus kraujo ėmimo mėgintuvėlius meskite į patvirtintas biologiškai pavojingų atliekų talpyklas, skirtas šioms atliekoms šalinti.
4. „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlių nenaudokite pakartotinai.
5. Nenaudokite „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlių galiojimo laikui, išspausdintam ant mėgintuvėlio etiketės, pasibaigus.
6. Dėl didelio centrifugavimo greičio (didesne nei 10 000 RCF) gali sudužti „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlis, atsirasti sąlytis su krauju ir galima susižeisti.
7. Mėginio neperpilkite iš švirkšto į mėgintuvėlį.

VIII. Laikymas


1. Nepanaudotus „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlius laikykite 18-25°C temperatūroje. Galimas ribotas laikotarpis 40°C temperatūroje. Galiojimo laikui pasibaigus, mėgintuvėlių naudoti negalima.

IX. „BD Hemogard“ dangtelio nuėmimo instrukcijos



1. „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlį suimkite viena ranka, nykštį pakišdami po „BD Hemogard“ dangteliu. (Papildomam stabilumui užtikrinti ranką padėkite ant kieto paviršiaus.) Kita ranka sukite „BD Hemogard“ dangtelį, tuo pačiu metu stumdami kitos rankos nykščiu, TIK KOL MĖGINTUVĖLIO KAMŠTELIS ATSILAISVINS.
2. Prieš nuimdami dangtelį, nykštį patraukite. NENAUDOKITE nykščio mėgintuvėlio dangteliui nustumti. Jeigu mėgintuvėlyje yra kraujo, kyla sąlyčio pavojus. Norint išvengti sužalojimų nuimant dangtelį, svarbu, kad nykštys, kuriuo aukštyn stumiamas dangtelis, nesiliestų su mėgintuvėliu, kai tik atsilaisvina „BD Hemogard“ dangtelis.
3. Nuimkite mėgintuvėlio dangtelį. Jeigu plastikinė apsauga atsiskirtų nuo guminio kamštelio, DANGTELIO NESURINKITE IŠ NAUJO. Nuo mėgintuvėlio atsargiai nuimkite guminį kamštelį.

X. „BD Hemogard“ dangtelio pakartotino uždėjimo instrukcijos



1. Vėl uždėkite dangtelį ant mėgintuvėlio.
2. Sukite ir tvirtai spauskite žemyn, kol kamštelis visiškai užsimaus. Būtina visiškai įkišti kamštelį, kad naudojant dangtelis būtų tvirtai uždėtas ant mėgintuvėlio.

Techninis aptarnavimas

Jei turite bet kokių klausimų apie „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlį, kreipkitės į vieną iš BD techninio aptarnavimo skyrių, nurodytų BD klientų aptarnavimo skyrelyje.

Užsakymo informacija

„PAXgene“ produktai

„PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlis / 761165

Turiny: 1 000 kraujo ėmimo mėgintuvėlių.

BD produktai*

„BD Vacutainer Eclipse“ kraujo ėmimo adata / 368609 CE

Turiny: 21G 1¼ col. adata, 0,8 mm x 32 mm, 48 vnt. dėžutėje, 480 vnt. dėžėje

„BD Vacutainer Eclipse“ kraujo ėmimo adata su iš anksto pritvirtintu laikikliu / 368650

Turiny: 21G 1¼ col. adata, 0,8 mm x 32 mm, 100 vnt. dėžėje

„BD Vacutainer Eclipse Signal“ kraujo ėmimo adata / 368835 CE

Turiny: 21G 1¼ col. adata, 0,8 mm x 32 mm, 50 vnt. dėžutėje, 400 vnt. dėžėje

„BD Vacutainer“ vienkartinis laikiklis / 364815

Turiny: dėžė skirta tik 13 mm ir 16 mm skersmens įtaisams, 1 000 vnt. dėžėje

* Šie katalogo numeriai reiškia įprastus produktus, kuriuos galima naudoti su „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėliu.

Norėdami užsisakyti BD kraujo ėmimo reikmenų:

Apsilankykite svetainėje: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Pasirinkite šalį. • Slinkite žemyn iki „BD Diagnostics“ – „Preanalytical Systems“. • Surinkite numerį.

QIAGEN produktai*

„QIAGEN QIASymphony DSP“ DNR rinkinys / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Turiny: reagentų kasetė, fermentų dėklas, praduriamas dangtelis, buferinis tirpalas ATE, pakartotinio naudojimo sandariklio rinkinys

„QIAGEN QIAamp® DSP“ DNR kraujo ėmimo mini rinkinys / 61104 (50)

Turiny: „QIAamp Mini spin“ kolonėlės, ėmimo mėgintuvėliai, buferinis tirpalas AL, buferinis tirpalas ATL, buferinis tirpalas AW1, buferinis tirpalas AW2, buferinis tirpalas AE, QIAGEN proteazė, proteazės tirpiklis

„QIAGEN Gentra® Puregene®“ kraujo ėmimo rinkinys / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1 000 ml)

Turiny: RBC lizavimo tirpalas, ląstelių lizavimo tirpalas, baltymų nusodinimo tirpalas, DNR hidratavimo tirpalas, RNazės A tirpalas

* Šie katalogo numeriai reiškia įprastus DNR paruošimo rinkinius, kuriuos galima naudoti su „PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėliu.

Norėdami užsisakyti QIAGEN DNR paruošimo rinkinius:

Apsilankykite svetainėje: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

„PAXgene“ kraujo DNR mėgintuvėlį BD įmonė gamina JK įmonei „PreAnalytiX GmbH“. „PAXgene“ ir „PreAnalytiX“ yra „PreAnalytiX GmbH“ prekių ženklai; QIAGEN, „QIASymphony“, „QIAamp“, „Gentra“, „Puregene“ yra QIAGEN NV prekių ženklai; „Styrofoam“ yra „The Dow Chemical Company“ prekės ženklas; visi kiti prekių ženklai yra „Becton, Dickinson and Company“ nuosavybė.

(tęsinys)

BD klientų aptarnavimo tarnyba

Argentina, Urugvajus ir Paragvajus

Užsakymai: 011.4551.7100

El. paštas: crc_argentina@bd.com

Australija

Užsakymai: 1.800.656. 100

Faks.: 1.800.656.110

El. paštas: bd_anz@bd.com

Austrija

Užsakymai: 43.1.7063660

Faks.: 43.1.7063660-11

Belgija

Užsakymai: 32.53.720.556

Faks.: 32.53.720.549

Brazilija

Užsakymai: 0800.055.5654

El. paštas: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Užsakymai: 800.268.5430

Faks.: 800.565.0897

El. paštas: custsvccan@bd.com

Danija

Užsakymai: 45.43.43.45.66

Faks.: 45.43.96.56.76

El. paštas: bdcs_dk@europe.bd.com

Rytų Europa

Užsakymai: 48.22.651.75.88

Faks.: 48.22.651.75.89

Suomija

Užsakymai: 358.9.88.70.780

Faks.: 358.9.88.70.7816

El. paštas: bdorder_finland@europe.bd.com

Prancūzija

Užsakymai: 33.476.689496

Faks.: 33.476.683693

El. paštas: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Vokietija

Užsakymai: 49.6221305553

Faks.: 49.6221305379

Italija

Užsakymai: 39.02.48.240.500

Faks.: 39.02.48.240.344

Techninės priežiūros tarnyba: 39.02.48.240.264

El. paštas: ordini_medicale@europe.bd.com

Viduriniai Rytai ir Afrika (EMA)

Užsakymai: 971.4.3379525

Faks.: 971.4.03379551

El. paštas: EMA_PAS@bd.com

Nyderlandai

Užsakymai: 31.20.6545.716

Faks.: 31.20.5829.421

El. paštas: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Naujoji Zelandija

Užsakymai: 0800.572.468

Faks.: 0800.572.469

El. paštas: bd_anz@bd.com

Norvegija

Užsakymai: 47.73.59.12.00

Faks.: 47.73.59.12.01

Ispanija

Užsakymai: 34.902.27.17.27

Faks.: 34.91.848.81.04

El. paštas: servicio_de_clientes@bd.com

Švedija

Užsakymai: 46.8.775.51.60

Faks.: 46.8.775.51.95

El. paštas: bdorder_sweden@europe.bd.com

Šveicarija

Užsakymai: 41.61.4852222

Užsakymai: 41.61.4852200

JK

Užsakymai: 44.1.865.781.666

Faks.: 44.1.865.717.313

El. paštas: bduk_customerservice@europe.bd.com

JAV

Užsakymai: 888.237.2762

Faks.: 800.847.2220

Techninės priežiūros tarnyba: 800.631.0174

El. paštas: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN klientų aptarnavimo tarnyba

Australija

Užsakymai: 03.9840.9800

Faks.: 03.9840.9888

Techninės priežiūros tarnyba: 1.800.243.066

Austrija

Užsakymai: 0800/28.10.10

Faks.: 0800/28.10.19

Techninės priežiūros tarnyba: 0800/28.10.11

Belgija

Užsakymai: 0800.79612

Faks.: 0800.79611

Techninės priežiūros tarnyba: 0800.79556

Kanada

Užsakymai: 800.572.9613

Faks.: 800.713.5951

Techninės priežiūros tarnyba: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Kinija

Užsakymai: 0086.21.3865.3865

Faks.: 0086.21.3865.3965

Techninės priežiūros tarnyba: 800.988.0325 /
800.988.0327

Danija

Užsakymai: 80.885945

Faks.: 80.885944

Techninės priežiūros tarnyba: 80.885942

Suomija

Užsakymai: 0800.914416

Faks.: 0800.914415

Techninės priežiūros tarnyba: 0800.914413

Prancūzija

Užsakymai: 01.60.920.926

Faks.: 01.60.920.925

Techninės priežiūros tarnyba: 01.60.920.930
Pasiūlymai: 01.60.920.928

Vokietija

Užsakymai: 02103.29.12000

Faks.: 02103.29.22000

Techninės priežiūros tarnyba: 02103.29.12400

Honkongas

Užsakymai: 800.933.965

Faks.: 800.930.439

Techninės priežiūros tarnyba: 800.930.425

Airija

Užsakymai: 1800.555.049

Faks.: 1800.555.048

Techninės priežiūros tarnyba: 1800.555.061

Italija

Užsakymai: 02.33430411

Faks.: 02.33430426

Techninės priežiūros tarnyba: 800.787980

Japonija

Telefonas: 03.5547.0811

Faks.: 03.5547.0818

Techninės priežiūros tarnyba: 03.5547.0811

Korėja (Pietų)

Užsakymai: 1544.7145

Faks.: 1544.7146

Techninės priežiūros tarnyba: 1544.7145

Liuksemburgas

Užsakymai: 8002.2076

Faks.: 8002.2073

Techninės priežiūros tarnyba: 8002.2067

Nyderlandai

Užsakymai: 0800.0229592

Faks.: 0800.0229593

Techninės priežiūros tarnyba: 0800.0229602

Norvegija

Užsakymai: 800.18859

Faks.: 800.18817

Techninės priežiūros tarnyba: 800.18712

Singapūras

Užsakymai: 65.67775366

Faks.: 65.67785177

Techninės priežiūros tarnyba: 65.67775366

Ispanija

Užsakymai: 91.630.7050

Faks.: 91.630.5145

Techninės priežiūros tarnyba: 91.630.7050

Švedija

Užsakymai: 020.790282

Faks.: 020.790582

Techninės priežiūros tarnyba: 020.798328

Šveicarija

Užsakymai: 055.254.22.11

Faks.: 055.254.22.13

Techninės priežiūros tarnyba: 055.254.22.12

JK

Užsakymai: 01293.422.911

Faks.: 01293.422.922

Techninės priežiūros tarnyba: 01293.422.999

JAV

Užsakymai: 800.426.8157

Faks.: 800.718.2056

Techninės priežiūros tarnyba: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Asiņu DNS stobriņš

LV – Latviski

I. Paredzētais lietojums

PAXgene asiņu DNS stobriņš ir paredzēts venozā pilnasiņu parauga savākšanai, koagulācijai, transportēšanai un glabāšanai, kā arī augstas kvalitātes DNS sagatavošanai, kuru izmanto molekulārās diagnostikas testos, kuros nepieciešams DNS.

Šīs ierīces veikspējas rādītāji nav noteikti molekulārās diagnostikas izmeklējumiem kopumā. Lietotājam nepieciešams veikt to specifiskā molekulārās diagnostikas izmeklējuma validāciju.

Izstrādājuma īpašības

PAXgene asiņu DNS stobriņš • 2,5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA piedeva
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 stobriņi/uzglabāšanas kastītē • 1000 stobriņi/kastē

II. Kopsavilkums un paskaidrojumi

PAXgene asiņu DNS stobriņš nodrošina veidu, kā slēgtā, vakuumētā sistēmā genoma DNS izolācijai savākt pilnasinis. Ievērojot standarta flebotomijas protokolu, asinis tiek savāktas vakuumētā stobriņā, kas satur K₂EDTA piedevas. Pilnīga DNS izolācija tiek veikta, izmantojot manuālas vai automātiskas metodes, piemēram, sāļu izgulsnēšanu, magnētiskās lodītes vai tehnoloģijas, kuru pamatā ir silīcija membrāna.

III. Brīdinājumi

Šī stobriņa saturs kairina ādu.


- Ja cilvēks ir ieeļļojies ar vielām, pārvietojiet cietušo svaigā gaisā.
- Pēc saskares ar ādu nekavējoties sazīpējiet ādu ar ziepēm un skalojiet ar ūdeni vismaz 15 minūtes.
- Pēc nokļūšanas acīs nekavējoties skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes.
- Norīšanas gadījumā cietušajam nekavējoties jādzer ūdens lielā daudzumā. Meklējiet medicīnisko palīdzību.

IV. Paraugu savākšana un sagatavošana analīzei

A. Nepieciešamie asiņu savākšanas piederumi (netiek piegādāti kopā ar PAXgene asiņu DNS stobriņu)

1. Asins savākšanas adata, piemēram, BD Vacutainer® Eclipse™ asiņu savākšanas adata vai BD Vacutainer Eclipse Signal™ asiņu savākšanas adata. Skatiet informāciju par pasūtīšanu.
2. Lai nodrošinātu pareizu darbību, ir jālieto adatas turētājs. Skatiet informāciju par pasūtīšanu.
3. Etiķetes drošai pacientu asiņu paraugu identificēšanai, ja nepieciešams.
4. Spirtā samitrināts tampons asiņu ņemšanas vietas notīrīšanai.
5. Sausa sterila marle.
6. Žņaugis.
7. Adatu izmešanas konteiners izlietotām adatām vai adatām/turētāja kombinācijai.

B. Paraugu ņemšanas procedūra



(turpinājums)

Vispārīgi norādījumi

VEICOT VĒNAS PUNKCIJU UN APSTRĀDĀJOT ASIŅU SAVĀKŠANAS STOBRIŅUS, VALKĀJIET CIMDUS, LAI SAMAZINĀTU SASKARES RISKU.

1. Ievietojiet adatu turētājā. Pārliecinieties, ka adata ir cieši nostiprināta, lai adatas lietošanas laikā tā neatvienotos.
2. Ievietojiet stobriņu turētājā. Piezīme. Neduriet aizbāzņi caurumus.
3. Izvēlieties vēnas punkcijas vietu.
4. **Uzlieciet žņaugu. Sagatavojiet vēnas punkcijas vietu ar piemērotu antiseptiķi. PĒC VĒNAS PUNKCIJAS VIETAS NOTĪRĪŠANAS NEAIZTIECIET TO.**
5. Novietojiet pacienta roku lejup.
6. Noņemiet adatas apvalku. Veiciet vēnas punkciju, nodrošinot, lai ROKA BŪTU NOVĪTOTA LEJUP UN STOBRIŅĀ AIZBĀZŅIS ATRASTOS AUGSTĀKAJĀ POZĪCIJĀ.
7. Aizbāžņa iespiešanas laikā centrējiet stobriņu turētājā, lai sānu sienīgas netiktu iespiestas un nenotiktu priekšlaicīgs vakuuma zudums. Uzspiediet stobriņu uz adatas, izdurot caurumu aizbāžņa gumijas uzmvā.
8. **TIKLĪD ASINIS SĀK IEPLŪST STOBRIŅĀ, NOŅEMĪET ŽŅAUGU. NODROŠINIET, LAI PROCEDŪRAS LAIKĀ STOBRIŅĀ SATURS NESASKARTOS AR AIZBĀZŅI VAI ADATAS GALU.**

Piezīme. Reizēm asinis var noplūst no adatas uzmvavas. Lai mazinātu pakļaušanas iedarbībai risku, ievērojiet vispārpieņemtos piesardzības pasākumus. Ja asinis neieplūst stobriņā vai asinis beidz plūst, pirms tiek iegūts atbilstošs paraugs, ieteicams izpildīt tālāk norādītās darbības, tādējādi iegūstot apmierinošu paraugu.

- a. Stumiet stobriņu uz priekšu, līdz stobriņa aizbāznis ir iespiests. Ja nepieciešams, turiet to, lai garantētu pilnīgu vakuuma iesūkņšanu.
 - b. Pārbaudiet, vai adata ir pareizi ievietota vēnā.
9. Kad stobriņš ir uzpildīts līdz norādītajam tilpumam un asiņu plūsma tiek pārtraukta, izņemiet stobriņu no turētāja.
 10. Stobriņu apgrieziet 8 reizes.
 11. Izņemiet adatu no vēnas, ar sterilu tamponu spiediet uz punkcijas vietas, līdz asiņošana ir pārtraukta.
 12. Kad asinis ir sarecējušas, uzlieciet pārsēju (ja vēlams).
 13. Pēc vēnas punkcijas uz aizbāžņa virsuses var būt asiņu atliekas. Strādājot ar stobriņiem, esiet piesardzīgs, lai izvairītos no saskares ar šīm asinīm.
 14. Izmetiet adatu un turētāju atbilstoši iestādes politikai un vadlīnijām.
 15. Uzglabājiet piepildīto PAXgene asiņu DNS stobriņu istabas temperatūrā (18-25°C). Skatiet sadaļu "Veiktspējas raksturojums", lai noskaidrotu DNS stabilitāti asiņu paraugos istabas temperatūrā (18-25°C), 2-8°C, vai -20°C temperatūrā.

Skatiet sadaļu "Procedūra paraugu sasaldēšanai un atkausēšanai PAXgene asiņu DNA stobriņos", lai uzzinātu vairāk, ja vēlaties uzglabāt -70°C/-80°C temperatūrā.

Lai novērstu iespējamo pretplūsmu, jālieto tālāk minētie paņēmieni.

- a. Novietojiet pacienta roku lejup.
- b. Turiet stobriņu ar aizbāzņi uz augšu.
- c. Tiklīdz asiņu sāk ieplūst stobriņā, noņemiet žņaugu.
- d. Nodrošiniet, lai vēnas punkcijas laikā stobriņa piedevas nesaskartos ar aizbāzņi vai adatas galu.

(turpinājums)

C. Procedūra paraugu sasaldēšanai un atkausēšanai PAXgene asiņu DNS stobriņos

1. Ievietojiet PAXgene asiņu DNS stobriņu stāvus stieplu statīvā. **Nesasaldējiet stobriņus stāvus putuplasta Styrofoam™ paplātē, jo tas var izraisīt stobriņu pārplīšanu.**
2. PAXgene asiņu DNS stobriņus var uzglabāt pie -20°C un zemākas temperatūras. Ja stobriņi ir jāglabā temperatūrā, kas zemāka nekā -20°C , vispirms 24 stundas sasaldējiet tos pie -20°C , tad pārvietojiet -70°C vai -80°C temperatūrā.
3. Atkausējiet PAXgene asiņu DNS stobriņus stieplu statīvā istabas temperatūrā ($18\text{--}25^{\circ}\text{C}$) aptuveni divas stundas. Neatkausējiet PAXgene asiņu DNS stobriņus temperatūrā, kas augstāka nekā 25°C .
4. Atkausētos PAXgene asiņu DNS stobriņus uzmanīgi apgrieziet otrādi 10 reizes.

Piezīme. Sasaldētie PAXgene asiņu DNS stobriņi pēc trieciena saplīst. Lai samazinātu saplīšanas risku transportējot, ar sasaldētajiem stobriņiem jāapietas tāpat, kā ar stikla stobriņiem. Lietotājiem ir pašiem jāvaldīd savs PAXgene asiņu DNS stobriņu sasaldēšanas un pārsūtīšanas protokols.

D. Procedūra paraugu sagatavošanai analīzei


Asins paraugi ir jāapstrādā saskaņā ar norādījumiem, kas pievienoti DNS paraugu sagatavošanas komplektiem. Piemērus skatiet pasūtīšanas informācijā.

V. Veikspējas raksturojums

Kad asiņu ir caurulītē, DNS ir stabils 14 dienas, ja tas tiek glabāts $18\text{--}25^{\circ}\text{C}$ temperatūrā (1. attēls). Saskaņā ar pētījumiem par DNS stabilitāti asinis var tikt glabātas stobriņā 14 dienas $18\text{--}25^{\circ}\text{C}$ temperatūrā, 28 dienas, ja tās tiek glabātas $2\text{--}8^{\circ}\text{C}$ temperatūrā, 3 dienas, ja tās tiek glabātas 35°C temperatūrā, vai, minimums, 6 mēnešus, ja tās tiek glabātas -20°C temperatūrā (pie $\geq 12,5$ ng/ μl DNS koncentrācijas un 1,7–1,9 DNS tīrības (A_{260}/A_{280})).

Visjaunākos datus par sasaldētu paraugu stabilitāti skatiet www.PreAnalytiX.com.

DNS stabilitāte asins paraugos pie $18\text{--}25^{\circ}\text{C}$

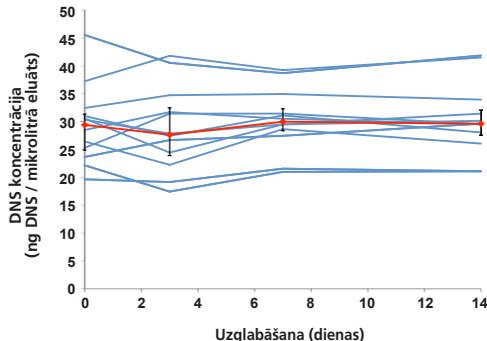

1. attēls

Asins paraugi tika savākti no 12 donoriem ar paraugu dublikātiem un uzglabāti pie $18\text{--}25^{\circ}\text{C}$ norādīto laiku, pēc tam tika veikta pilnīga DNS attīrīšana. Asins paraugi tika savākti un uzglabāti PAXgene asiņu DNS stobriņos, kopējā DNS tika attīrīta, izmantojot QIAGEN® QIASymphony® DSP DNS mini komplektu un QIAGEN QIASymphony automatizēto instrumentu.

VI. Ierobežojumi

1. Savākto asiņu tilpumam ir jābūt 2,5 ml vienā PAXgene asiņu DNS stobriņā, bet šis tilpums var mainīties atkarībā no augstuma virs jūras līmeņa, apkārtējās vides temperatūras, atmosfēras spiediena, stobriņa vecuma, spiediena vēnā un uzpildes tehnikas.

(turpinājums)


VII. Piesardzības brīdinājumi

1. Ievērojiet vispārējos piesardzības pasākumus. Lietojiet cimdus, halātus, acu aizsargus, citus personīgos aizsarglīdzekļus un konstrukcijā paredzētos aizsarglīdzekļos, lai pasargātos no asiņu izšļakstīšanās, asiņu iztecēšanas un potenciālas saskares ar patogēniem, kas atrodas asinīs.
2. Rīkojieties ar visiem bioloģiskajiem paraugiem un asiņu savākšanā lietotajiem asajiem priekšmetiem atbilstoši jūsu iestādes rīcības politikai un procedūrām. Ja esat nākuši saskarē ar bioloģiskajiem paraugiem (piem., saduroties), vērsieties pēc atbilstošas medicīniskās palīdzības, jo ar bioloģiskajiem paraugiem var tikt pārnēsāts vīrusu hepatīts, HIV (AIDS) un citas infekcijas slimības.
Izmantojiet visus asiņu ņemšanas ierīcē esošos adatas aizsegšanas līdzekļus. PreAnalytiX neiesaka uzlikt lietotām adatām apvalku. Tomēr iestādes politikas un procedūras var būt atšķirīgas un tās ir jāievēro vienmēr.
3. Izmetiet visus asiņu ņemšanas stobriņus attiecīgos bīstamo bioloģisko materiālu konteineros.
4. Neizmantojiet atkārtoti PAXgene asiņu DNS stobriņus.
5. Nelietojiet PAXgene asiņu DNS stobriņus pēc derīguma termiņa beigu datuma, kas uzdrukāts uz stobriņa etiķetes.
6. Pārmērīgs centrifugēšanas ātrums (virs 10 000 RCF) var izsaukt PAXgene asiņu DNS stobriņu plīšanu, saskari ar asinīm un iespējamu traumu.
7. Nepārnēsiet paraugu stobriņā no šļirces.

VIII. Glabāšana

1. Nelietotus PAXgene asiņu DNS stobriņus uzglabājiet 18–25°C temperatūrā. Pieļaujama ierobežota temperatūras paaugstināšanās līdz 40°C. Neizmantojiet stobriņus pēc derīguma termiņa beigām.

IX. Norādījumi par BD Hemogard noslēdzēja izņemšanu



1. Satveriet PAXgene asiņu DNS stobriņu ar vienu roku, novietojot īkšķi zem BD Hemogard noslēdzēja. (Lai palielinātu stabilitāti, novietojiet roku uz cietas virsmas.) Ar otru roku grieziet BD Hemogard noslēdzēju, vienlaikus stumjot uz augšu ar otras rokas īkšķi TIKAI TIK ILGI, KAMĒR AIZBĀZNIS IR ATBRĪVOTS.
2. Pirms noslēdzēja pacelšanas noņemiet īkšķi. **NELIETOJĒT** īkšķi, lai nostumtu noslēdzēju no stobriņa. Ja stobriņā ir asinis, pastāv pakļaušanas iedarbībai risks. Lai noslēdzēja izņemšanas laikā nerastos traumu gūšanas risks, īkšķis, kas tika izmantots stumšanai augšup uz noslēdzēja, tiek noņemts no stobriņa, tiklīdz BD Hemogard noslēdzējs tiek atlaists.
3. Noņemiet noslēdzēju no stobriņa. Maz ticams, ka plastmasas aizsargs varētu atdalīties no gumijas aizbāžņa, ja tomēr tā notiek, **NEIZJAUCIET NOSLĒDZĒJU**. Uzmanīgi noņemiet gumijas noslēdzēju no stobriņa.

X. Norādījumi par BD Hemogard noslēdzēja atkārtotu ievietošanu



1. Uzlieciet noslēdzēju uz stobriņa.
2. Pagrieziet un stumiet to stingri, līdz aizbāznis ir pilnībā uzlikts. Aizbāznis jāuzliek pilnībā, lai nodrošinātu, ka lietošanas laikā noslēdzējs droši turas uz stobriņa.

Tehniskā palīdzība

Ja rodas kādi jautājumi par PAXgene asiņu DNS stobriņu, sazinieties ar vienu no BD Tehnisko pakalpojumu departamentiem, kas norādīti sadaļā BD — Klientu serviss.

Informācija par pasūtīšanu

PAXgene izstrādājumi

PAXgene asiņu DNS stobriņš/761165

Saturs 1000 asiņu savākšanas stobriņi

BD izstrādājumi*

BD Vacutainer Eclipse asiņu savākšanas adata/368609 CE

Saturs 21G 1¼" collas adata, 0,8 mm x 32 mm, 48/kastītē, 480/kastē

BD Vacutainer Eclipse asiņu savākšanas adata ar iepriekš pievienotu turētāju/368650 NA/368609 CE

Saturs 21G 1¼" collas adata, 0,8 mm x 32 mm, 100/kastē

BD Vacutainer Eclipse asiņu savākšanas adata/368835 CE

Saturs 21G 1¼" collas adata, 0,8 mm x 32 mm, 50/kastītē, 400/kastē

BD Vacutainer vienreiz lietojamais turētājs/364815

Saturs Kaste tikai 13 mm un 16 mm diametram, 1000/kastē

* Šie kataloga numuri attiecas uz parastajiem izstrādājumiem, kurus iespējams lietot ar PAXgene asiņu DNS stobriņiem.

BD asiņu savākšanas piederumu pasūtīšana

Dodieties uz: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

• Izvēlieties valsti • Ritiniet uz leju līdz "BD Diagnostics - Preanalytical Systems" • Zvaniet uz numuru

QIAGEN izstrādājumi*

QIAGEN QIASymphony DSP DNS komplekts/937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Saturs: Reagenta kārtidžs, enzīmu statīvs, caurduršanas vāks, buferēts ATE, atkārtotas noslēgšanas komplekts.

QIAGEN QIAamp® DSP DNS komplekts/61104 (50)

Saturs: QIAamp Mini griešanas kolonnas, savākšanas stobriņi, buferēts AL, buferēts ATL, buferēts AW1, buferēts AW2, buferēts AE, QIAGEN proteāze, proteāzes šķīdinātājs.

QIAGEN Gentra® Puregene® asiņu komplekts/158422 (3 ml)/158445 (30 ml)/158467 (120 ml)/158389 (1000 ml)

Saturs: RBC līzes šķīdums, šūnu līzes šķīdums, proteīnu precipitācijas šķīdums, DNS hidrācijas šķīdums, RNāzes A šķīdums.

* Šie kataloga numuri attiecas uz parastajiem DNS sagatavošanas komplektiem, kurus iespējams lietot ar PAXgene asiņu DNS stobriņiem.

QIAGEN DNS sagatavošanas komplektu pasūtīšana

Dodieties uz: <http://www.qiagen.com/contact/qiagenworldwide.aspx>

BD — Klientu serviss

Argentīna, Urugvaja un Paragvaja

Pasūtījumi: 011.4551.7100

E-pasts: crc_argentina@bd.com

Austrālija

Pasūtījumi: 1.800.656.100

Fakss: 1.800.656.110

E-pasts: bd_anz@bd.com

Austrija

Pasūtījumi: 43.1.7063660

Fakss: 43.1.7063660-11

Beļģija

Pasūtījumi: 32.53.720.556

Fakss: 32.53.720.549

Brazīlija

Pasūtījumi: 0800.055.5654

E-pasts: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanāda

Pasūtījumi: 800.268.5430

Fakss: 800.565.0897

E-pasts: custsvccan@bd.com

Dānija

Pasūtījumi: 45.43.43.45.66

Fakss: 45.43.96.56.76

E-pasts: bdcg_dk@europe.bd.com

Austrumeiropa

Pasūtījumi: 48.22.651.75.88

Fakss: 48.22.651.75.89

Somija

Pasūtījumi: 358.9.88.70.780

Fakss: 358.9.88.70.7816

E-pasts: bdorder_finland@europe.bd.com

Francija

Pasūtījumi: 33.476.689496

Fakss: 33.476.683693

E-pasts: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Vācija

Pasūtījumi: 49.6221305553

Fakss: 49.6221305379

Itālija

Pasūtījumi: 39.02.48.240.500

Fakss: 39.02.48.240.344

Tehniskie p.: 39.02.48.240.264

E-pasts: ordini_medicale@europe.bd.com

Vidējie Austrumi un Āfrika

Pasūtījumi: 971.4.3379525

Fakss: 971.4.03379551

E-pasts: EMA_PAS@bd.com

Nīderlande

Pasūtījumi: 31.20.6545.716

Fakss: 31.20.5829.421

E-pasts: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Jaunzēlande

Pasūtījumi: 0800.572.468

Fakss: 0800.572.469

E-pasts: bd_anz@bd.com

Norvēģija

Pasūtījumi: 47.73.59.12.00

Fakss: 47.73.59.12.01

Spānija

Pasūtījumi: 34.902.27.17.27

Fakss: 34.91.848.81.04

E-pasts: servicio_de_clientes@bd.com

Zviedrija

Pasūtījumi: 46.8.775.51.60

Fakss: 46.8.775.51.95

E-pasts: bdorder_sweden@europe.bd.com

Šveice

Pasūtījumi: 41.61.4852222

Pasūtījumi: 41.61.4852200

Apvienotā Karaliste

Pasūtījumi: 44.1.865.781.666

Fakss: 44.1.865.717.313

E-pasts: bduk_customerservice@europe.bd.com

ASV

Pasūtījumi: 888.237.2762

Fakss: 800.847.2220

Tehniskie p.: 800.631.0174

E-pasts: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN — Klientu serviss

Austrālija

Pasūtījumi: 03.9840.9800
Fakss: 03.9840.9888
Tehniskie p.: 1.800.243.066

Austrija

Pasūtījumi: 0800/28.10.10
Fakss: 0800/28.10.19
Tehniskie p.: 0800/28.10.11

Beļģija

Pasūtījumi: 0800.79612
Fakss: 0800.79611
Tehniskie p.: 0800.79556

Kanāda

Pasūtījumi: 800.572.9613
Fakss: 800.713.5951
Tehniskie p.: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Ķīna

Pasūtījumi: 0086.21.3865.3865
Fakss: 0086.21.3865.3965
Tehniskie p.: 800.988.0325 / 800.988.0327

Dānija

Pasūtījumi: 80.885945
Fakss: 80.885944
Tehniskie p.: 80.885942

Somija

Pasūtījumi: 0800.914416
Fakss: 0800.914415
Tehniskie p.: 0800.914413

Francija

Pasūtījumi: 01.60.920.926
Fakss: 01.60.920.925
Tehniskie p.: 01.60.920.930
Piedāvājumi: 01.60.920.928

Vācija

Pasūtījumi: 02103.29.12000
Fakss: 02103.29.22000
Tehniskie p.: 02103.29.12400

Honkonga

Pasūtījumi: 800.933.965
Fakss: 800.930.439
Tehniskie p.: 800.930.425

Īrija

Pasūtījumi: 1800.555.049
Fakss: 1800.555.048
Tehniskie p.: 1800.555.061

Itālija

Pasūtījumi: 02.33430411
Fakss: 02.33430426
Tehniskie p.: 800.787980

Japāna

Tālrunis: 03.5547.0811
Fakss: 03.5547.0818
Tehniskie p.: 03.5547.0811

Dienvīdkoreja

Pasūtījumi: 1544.7145
Fakss: 1544.7146
Tehniskie p.: 1544.7145

Luksemburga

Pasūtījumi: 8002.2076
Fakss: 8002.2073
Tehniskie p.: 8002.2067

Nīderlande

Pasūtījumi: 0800.0229592
Fakss: 0800.0229593
Tehniskie p.: 0800.0229602

Norvēģija

Pasūtījumi: 800.18859
Fakss: 800.18817
Tehniskie p.: 800.18712

Singapūra

Pasūtījumi: 65.67775366
Fakss: 65.67785177
Tehniskie p.: 65.67775366

Spānija

Pasūtījumi: 91.630.7050
Fakss: 91.630.5145
Tehniskie p.: 91.630.7050

Zviedrija

Pasūtījumi: 020.790282
Fakss: 020.790582
Tehniskie p.: 020.798328

Šveice

Pasūtījumi: 055.254.22.11
Fakss: 055.254.22.13
Tehniskie p.: 055.254.22.12

Apvienotā Karaliste

Pasūtījumi: 01293.422.911
Fakss: 01293.422.922
Tehniskie p.: 01293.422.999

ASV

Pasūtījumi: 800.426.8157
Fakss: 800.718.2056
Tehniskie p.: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Blood DNA Tube

NL – Nederlands

I. Bestemd gebruik

De PAXgene Blood DNA Tube is een bloedbuisje voor afname, ontstolling, stabilisatie, vervoer en opslag van een veneus volbloedmonster voor bereiding van DNA van hoge kwaliteit voor gebruik in testmethoden voor moleculaire diagnostiek waarbij DNA is vereist.

De resultaatkenmerken van dit product zijn niet vastgesteld voor moleculaire diagnostische testen in het algemeen. Gebruikers moeten het gebruik van dit product valideren voor de door hen gebruikte specifieke moleculaire diagnostische test.

Productkenmerken

PAXgene Blood DNA Tube • 2,5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA-additief
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 buisjes/verpakking • 1000 buisjes/doos

II. Overzicht en uitleg

De PAXgene Blood DNA Tube biedt een middel voor de afname van volbloed voor de isolatie van genomisch DNA in een gesloten vacuümsysteem. Volgens een standaard flebotomieprotocol wordt er bloed afgenomen in een vacuümbuisje dat K₂EDTA-additief bevat. Volledige isolatie van DNA wordt uitgevoerd door middel van handmatige of automatische methoden zoals precipitatie door uitzouten of op magnetische kralen of silica-membranen gebaseerde technologieën.

III. Waarschuwingen

De inhoud van dit buisje is irriterend voor de huid.


- Na inademen de getroffene naar de frisse lucht brengen.
- Na aanraking met de huid deze onmiddellijk ten minste 15 minuten met overvloedig water en zeep spoelen.
- Na aanraking met de ogen deze onmiddellijk ten minste 15 minuten met overvloedig water spoelen.
- Na inslikken onmiddellijk een grote hoeveelheid water laten drinken. Raadpleeg een arts.

IV. Monsterafname en voorbereiding voor analyse

A. Benodigde accessoires voor bloedafname (niet inbegrepen bij de PAXgene Blood DNA Tube)

1. Een bloedafnamenaald zoals de BD Vacutainer® Eclipse™ bloedafnamenaald of de BD Vacutainer Eclipse Signal™ bloedafnamenaald. Zie bestelinformatie.
2. Een BD Vacutainer naaldhouder moet worden gebruikt om de juiste werking te garanderen. Zie bestelinformatie.
3. Etiketten voor positieve donoridentificatie van de monsters, indien vereist
4. Alcoholdoekje om de punctieplaats te reinigen
5. Droog steriel gaas
6. Tourniquet
7. Geschikte afvalbak voor gebruikte naald of naald/houdercombinatie

B. Procedure voor monsterafname



Algemene instructies

DRAAG HANDSCHOENEN BIJ HET UITVOEREN VAN EEN VENAPUNCTIE EN HET HANTEREN VAN BLOEDAFNAMEBUIJSJES OM BLOOTSTELLINGSRISICO TE MINIMALISEREN.

1. Plaats de naald in de houder. Controleer of de naald goed vastzit om zeker te zijn dat deze niet losraakt tijdens het gebruik.
2. Plaats het buisje in de houder. NB: Prik de dop niet door.
3. Kies de venapunctieplaats.
4. **Breng de tourniquet aan. Bereid de venapunctieplaats voor met een geschikt antisepticum. RAAK HET VENAPUNCTIEGEBIED NIET MEER AAN NADAT U DIT HEBT GEREINIGD.**
5. Plaats de arm van de patiënt in een neerwaartse positie.
6. Verwijder het naaldkapje. Voer de venapunctie uit MET DE ARM OMLAAG EN HET BUISJE MET DE DOP NAAR BOVEN GERICHT.
7. Plaats buisjes midden in de houder bij het doorprikken van de dop om te voorkomen dat de zijwand wordt doorgepriktd waardoor voortijdig verlies van het vacuüm optreedt. Duw het buisje op de naald en doorboor het membraan van de dop.
8. VERWIJDER DE TOURNIQUET ZODRA ER BLOED IN HET BUISJE VERSCHIJNT. LAAT TIJDENS DE INGREEP DE INHOUD VAN HET BUISJE NIET IN CONTACT KOMEN MET DE DOP OF HET UITEINDE VAN DE NAALD.

NB: Incidenteel kan er bloed uit de naaldhuls lekken. Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen om blootstellingsrisico te minimaliseren. Als er geen bloed in het buisje stroomt of de bloedstroom stopt voordat voldoende bloed voor een monster is afgenomen, voer dan de volgende stappen uit om de afname naar tevredenheid te voltooien:

- a. Duw het buisje naar voren tot de dop van het buisje is doorgepriktd. Houd het buisje zo nodig op zijn plaats om te zorgen voor een volledige afname onder invloed van het vacuüm.
 - b. Controleer of de naaldcanule in de juiste positie in de vene is geplaatst.
9. Wanneer het buisje is gevuld tot het aangegeven volume en de bloedstroom stopt, verwijdert u het buisje uit de houder.
 10. Keer het buisje 8 maal om.
 11. Verwijder de naald uit de vene en oefen druk uit op de punctieplaats met een droog en steriel gaasje tot de bloeding stopt.
 12. Zodra er stolling is opgetreden, kan desgewenst een pleister worden aangebracht.
 13. Na venapunctie kan er bloed zijn achtergebleven op de bovenzijde van de dop. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen wanneer u buisjes hanteert om contact met dit bloed te voorkomen.
 14. Gooi de naald en houder weg volgens het beleid en de richtlijnen van de instelling.
 15. Bewaar de gevulde PAXgene Blood DNA Tube bij kamertemperatuur (18-25°C). Zie de prestatiekenmerken voor DNA-stabiliteit in bloedmonsters bij kamertemperatuur (18-25°C), 2-8°C of -20°C.

Zie Procedure voor invriezen en ontdooien van in de PAXgene Blood DNA Tubes afgenomen monsters voor details als een bewaar temperatuur van -70°C/-80°C gewenst is.

(vervolg)

De volgende technieken dienen te worden gebruikt om mogelijke terugvloeiing te voorkomen:

- Plaats de arm van de donor in een neerwaartse positie.
- Houd het buisje met de dop naar boven.
- Maak de tourniquet los zodra het bloed in het buisje begint te vloeien.
- Zorg er tijdens de venapunctie voor dat de additieven in het buisje niet in contact komen met de dop of het uiteinde van de naald.

C. Procedure voor invriezen en ontdooien van in de PAXgene Blood DNA Tubes afgenomen monsters

- Zet de PAXgene Blood DNA Tube rechtop in een draadrek. **De buisjes niet rechtop in een piepschuim Styrofoam™ bak zetten, aangezien de buisjes hierdoor kunnen barsten.**
- De PAXgene Blood DNA Tubes kunnen bij -20°C en lager worden bewaard. Als de buisjes bij temperaturen onder -20°C moeten worden bewaard, dient u ze eerst 24 uur bij -20°C in te vriezen en ze daarna te verplaatsen naar -70°C of -80°C.
- Ontdooi de PAXgene Blood DNA Tubes ongeveer twee uur lang in een draadrek bij kamertemperatuur (18-25°C). **Ontdooi de PAXgene Blood DNA Tubes niet bij temperaturen boven 25°C.**
- Keer de ontdooide PAXgene Blood DNA Tubes voorzichtig 10 keer om.

NB: De bevroren PAXgene Blood DNA Tubes kunnen gemakkelijk breken als ertegen wordt gestoten. Om het risico van breken tijdens verzenden te verminderen dienen bevroren buisjes op dezelfde wijze te worden behandeld als glazen buisjes. Gebruikers moeten hun eigen protocol voor invriezen en verzenden valideren voor de PAXgene Blood DNA Tubes.

D. Procedure voor het voorbereiden van monsters voor analyse


De bloedmonsters moeten volgens de met de DNA-monstervoorbereidingsset meegeleverde aanwijzingen worden verwerkt. Zie bestelinformatie voor voorbeelden.

V. Resultaatkenmerken

Nadat er bloed in de buis is gebracht, blijft het DNA 14 dagen stabiel bij 18°C tot 25°C (afbeelding 1). DNA-stabiliteitsonderzoeken hebben uitgewezen dat bloed gedurende 14 dagen in de buis kan worden bewaard bij 18°C tot 25°C, gedurende 28 dagen bij 2°C tot 8°C, gedurende 3 dagen bij 35°C of gedurende minimaal 6 maanden bij -20°C, met een DNA-concentratie van $\geq 12,5$ ng/ μ l en DNA-zuiverheid (A_{260}/A_{280}) van 1,7-1,9.

Ga voor de meest recente gegevens over de stabiliteit van ingevroren monsters naar www.PreAnalytix.com.

DNA-stabiliteit in bloedmonsters bij 18-25°C

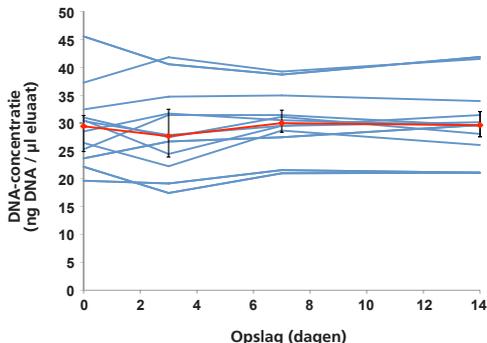

Afbeelding 1

Bij 12 volwassen donors, die hiervoor toestemming hadden gegeven, werd bloed afgenomen en het aangegeven aantal dagen bij 18-25°C bewaard, gevolgd door totale DNA-zuivering. Het bloed werd afgenomen en bewaard in PAXgene Blood DNA Tubes en het totale DNA werd gezuiverd met behulp van de QIAGEN® QIA Symphony® DSP DNA Mini Kit op de QIAGEN QIA Symphony extractieautomaat.

VI. Beperkingen

1. De hoeveelheid afgenomen bloed dient 2,5 ml per PAXgene Blood DNA Tube te zijn, maar dit volume kan variëren met hoogte, omgevingstemperatuur, barometrische druk, leeftijd van het buisje, veneuze druk en vultechniek.

VII. Voorzorgsmaatregelen

1. Neem universele voorzorgsmaatregelen. Handschoenen, laboratoriumjas, oogbescherming, andere persoonlijke beschermende uitrusting dragen en maatregelen nemen om uzelf te beschermen tegen bloedspetters, bloedlekkage en mogelijke blootstelling aan pathogenen in bloed.
2. Alle biologische monsters en bij de afname van bloed gebruikte scherpe instrumenten volgens het beleid en de procedures van uw instelling behandelen. Het gepaste medische advies inwinnen in het geval van blootstelling aan biologische monsters (bijvoorbeeld via punctieletsel) daar ze virale hepatitis, HIV (AIDS) of andere besmettelijke ziekten kunnen overdragen.


Eventuele veiligheidsvoorzieningen gebruiken indien het bloedafnamesysteem daarmee is uitgerust. PreAnalytiX beveelt niet aan om kapjes terug te zetten op gebruikte naalden. Het beleid en de procedures van uw instelling kunnen echter verschillen en moeten altijd worden gevolgd.

3. Alle bloedafnamebuisjes in goedgekeurde containers voor biologisch gevaarlijke materialen weggooien.
4. De PAXgene Blood DNA Tubes niet opnieuw gebruiken.
5. De PAXgene Blood DNA Tubes niet gebruiken nadat de op het etiket van het buisje gedrukte vervaldatum verstreken is.
6. Bovenmatige centrifugeersnelheden (hoger dan 10.000 RCF) kunnen breken van de PAXgene Blood DNA Tube, blootstelling aan bloed en mogelijk letsel veroorzaken.
7. Monsters niet van een spuit naar een buisje overdragen.

VIII. Opslag

1. Bewaar de ongebruikte PAXgene Blood DNA Tubes bij 18°C tot 25°C. Beperkte temperatuurstijgingen tot 40°C zijn toegestaan. Gebruik de buisjes niet na de uiterste gebruiksdatum.


IX. Instructies voor verwijdering van de BD Hemogard veiligheidsdop



1. Pak de PAXgene Blood DNA Tube met één hand vast en plaats uw duim onder de BD Hemogard veiligheidsdop. (Plaats uw arm op een stevig oppervlak voor extra stabiliteit). Draai met uw andere hand de BD Hemogard veiligheidsdop los en duw tegelijkertijd met de duim van de ene hand TOT DE DOP VAN HET BUISJE LOSKOMT.
2. Haal uw duim weg bij de dop voordat u de dop eraf tilt. Gebruik uw duim NIET om de dop van het buisje te duwen. Als het buisje bloed bevat, is er blootstellingsgevaar aanwezig. Om letsel te helpen voorkomen tijdens verwijdering van de veiligheidsdop, is het belangrijk om de duim waarmee de dop omhoog wordt gedrukt weg te halen van het buisje zodra de BD Hemogard veiligheidsdop wordt losgemaakt.
3. Til de veiligheidsdop van het buisje. In het onwaarschijnlijke geval dat de kunststof afscherming losraakt van de rubber dop, DE VEILIGHEIDSDOP NIET OPNIEUW IN ELKAAR ZETTEN. Verwijder de rubber dop voorzichtig van het buisje.

(vervolg)

X. Instructies voor opnieuw in het buisje aanbrengen van de BD Hemogard veiligheidsdop



1. Plaats de dop terug op het buisje.
2. Duw de dop met een draaiende beweging krachtig naar beneden tot de dop weer volledig op zijn plaats zit. De dop moet volledig in het buisje worden aangebracht om te garanderen dat deze goed blijft zitten tijdens het hanteren.

Technische ondersteuning

Mocht u vragen hebben over de PAXgene Blood DNA Tube, neem dan contact op met een van de technische serviceafdelingen van BD in het gedeelte BD – Klantenservice.

Bestelinformatie.

PAXgene producten

PAXgene Blood DNA Tube/761165

Inhoud: 1000 bloedafnamebuisjes.

BD-producten*

BD Vacutainer Eclipse bloedafnamenaald/368609 CE

Inhoud: 21G 31,75 mm naald, 0,8 mm x 32 mm, 48/verpakking, 480/doos

BD Vacutainer Eclipse bloedafnamenaald met voorbevestigde houder/368650

Inhoud: 21G 31,75 mm naald, 0,8 mm x 32 mm, 100/doos

BD Vacutainer Eclipse Signal bloedafnamenaald/368835 CE

Inhoud: 21G 31,75 mm naald, 0,8 mm x 32 mm, 50/verpakking, 400/doos

BD Vacutainer houder voor eenmalig gebruik/364815

Inhoud: Doos alleen voor 13 mm en 16 mm diameter 1000/doos

* Deze catalogusnummers vertegenwoordigen typische producten die gebruikt kunnen worden met de PAXgene Blood DNA Tube.

Zo bestelt u BD bloedafnameaccessoires:

Ga naar: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Kies land • Schuif naar beneden voor BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Bel het nummer

QIAGEN-producten*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit/937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Inhoud: Reagenscartridge, enzymrek, doorprikdeksel, buffer ATE, sealset voor hergebruik

QQIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Inhoud: QIAamp mini spin kolommen, verzamelbuisjes, buffer AL, buffer ATL, buffer AW1, buffer AW2, buffer AE, QIAGEN-protease, proteaseoplosmiddel

QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit/158422 (3 ml)/158445 (30 ml)/158467 (120 ml)/158389 (1000 ml)

Inhoud: Lysisoplossing voor erythrocyten, cellysoplossing, eiwitprecipitatie-oplossing, DNA-hydratieoplossing, RNase A-oplossing

* Deze catalogusnummers vertegenwoordigen typische kits voor DNA-bereiding die gebruikt kunnen worden met de PAXgene Blood DNA Tube.

(vervolg)

Zo bestelt u BD bloedafnameaccessoires:

Ga naar: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

De PAXgene Blood DNA Tube wordt door BD in het Verenigd Koninkrijk vervaardigd voor PreAnalytiX GmbH. PAXgene en PreAnalytiX zijn handelsmerken van PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra en Puregene zijn handelsmerken van QIAGEN NV; Styrofoam is een handelsmerk van The Dow Chemical Company; alle andere handelsmerken zijn het eigendom van Becton, Dickinson and Company.

BD – Klantenservice

Argentinië, Uruguay en Paraguay

Bestellingen: 011.4551.7100
E-mail: crc_argentina@bd.com

Australië

Bestellingen: 1.800.656.100
Fax: 1.800.656.110
E-mail: bd_anz@bd.com

Oostenrijk

Bestellingen: 43.1.7063660
Fax: 43.1.7063660-11

België

Bestellingen: 32.53.720.556
Fax: 32.53.720.549

Brazilië

Bestellingen: 0800.055.5654
E-mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Canada

Bestellingen: 800.268.5430
Fax: 800.565.0897
E-mail: custsvccan@bd.com

Denemarken

Bestellingen: 45.43.43.45.66
Fax: 45.43.96.56.76
E-mail: bdcs_dk@europe.bd.com

Oost-Europa

Bestellingen: 48.22.651.75.88
Fax: 48.22.651.75.89

Finland

Bestellingen: 358.9.88.70.780
Fax: 358.9.88.70.7816
E-mail: bdorder_finland@europe.bd.com

Frankrijk

Bestellingen: 33.476.689496
Fax: 33.476.683693
E-mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Duitsland

Bestellingen: 49.6221305553
Fax: 49.6221305379

Italië

Bestellingen: 39.02.48.240.500
Fax: 39.02.48.240.344
Technisch: 39.02.48.240.264
E-mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Midden-Oosten en Afrika (EMA)

Bestellingen: 971.4.3379525
Fax: 971.4.03379551
E-mail: EMA_PAS@bd.com

Nederland

Bestellingen: 31.20.6545.716
Fax: 31.20.5829.421
E-mail: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Nieuw-Zeeland

Bestellingen: 0800.572.468
Fax: 0800.572.469
E-mail: bd_anz@bd.com

Noorwegen:

Bestellingen: 47.73.59.12.00
Fax: 47.73.59.12.01

Spanje

Bestellingen: 34.902.27.17.27
Fax: 34.91.848.81.04
E-mail: servicio_de_clientes@bd.com

Zweden

Bestellingen: 46.8.775.51.60
Fax 46: 8.775.51.95
E-mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Zwitserland

Bestellingen: 41.61.4852222
Bestellingen: 41.61.4852200

VK

Bestellingen: 44.1.865.781.666
Fax: 44.1.865.717.313
E-mail: bduk_customerservice@europe.bd.com

VS

Bestellingen: 888.237.2762
Fax: 800.847.2220
Technisch: 800.631.0174
E-mail: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Klantenservice

Australië

Bestellingen: 03.9840.9800
Fax: 03.9840.9888
Technisch: 1.800.243.066

Oostenrijk

Bestellingen: 0800/28.10.10
Fax: 0800/28.10.19
Technisch: 0800/28.10.11

België

Bestellingen: 0800.79612
Fax: 0800.79611
Technisch: 0800.79556

Canada

Bestellingen: 800.572.9613
Fax: 800.713.5951
Technisch: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

China

Bestellingen: 0086.21.3865.3865
Fax: 0086.21.3865.3965
Technisch: 800.988.0325 / 800.988.0327

Denemarken

Bestellingen: 80.885945
Fax: 80.885944
Technisch: 80.885942

Finland

Bestellingen: 0800.914416
Fax: 0800.914415
Technisch: 0800.914413

Frankrijk

Bestellingen: 01.60.920.926
Fax: 01.60.920.925
Technisch: 01.60.920.930
Aanbiedingen: 01.60.920.928

Duitsland

Bestellingen: 02103.29.12000
Fax: 02103.29.22000
Technisch: 02103.29.12400

Hong Kong

Bestellingen: 800.933.965
Fax: 800.930.439
Technisch: 800.930.425

Ierland

Bestellingen: 1800.555.049
Fax: 1800.555.048
Technisch: 1800.555.061

Italië

Bestellingen: 02.33430411
Fax: 02.33430426
Technisch: 800.787980

Japan

Tel.: 03.5547.0811
Fax: 03.5547.0818
Technisch: 03.5547.0811

Korea (Zuid-)

Bestellingen: 1544.7145
Fax: 1544.7146
Technisch: 1544.7145

Luxemburg

Bestellingen: 8002.2076
Fax: 8002.2073
Technisch: 8002.2067

Nederland

Bestellingen: 0800.0229592
Fax: 0800.0229593
Technisch: 0800.0229602

Noorwegen

Bestellingen: 800.18859
Fax: 800.18817
Technisch: 800.18712

Singapore

Bestellingen: 65.67775366
Fax: 65.67785177
Technisch: 65.67775366

Spanje

Bestellingen: 91.630.7050
Fax: 91.630.5145
Technisch: 91.630.7050

Zweden

Bestellingen: 020.790282
Fax: 020.790582
Technisch: 020.798328

Zwitserland

Bestellingen: 055.254.22.11
Fax: 055.254.22.13
Technisch: 055.254.22.12

VK

Bestellingen: 01293.422.911
Fax: 01293.422.922
Technisch: 01293.422.999

VS

Bestellingen: 800.426.8157
Fax: 800.718.2056
Technisch: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Blod-DNA-rør

NO - Norsk

I. Bruksområde

PAXgene blod-DNA-rør er beregnet på innsamling, antikoagulering, stabilisering, transport og lagring av venøst fullblod for preparering av DNA av høy kvalitet til bruk med molekylærdiagnostiske metoder som krever DNA.

Det er ikke etablert funksjonsdata for disse rørene for molekylærdiagnostiske analyser generelt. Brukere må validere bruken av produktet for deres spesifikke molekylærdiagnostiske analyser.

Produktfunksjoner

PAXgene blod-DNA-rør • 2,5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA tilsetningsstoff
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 rør/pakning • 1 000 rør/eske

II. Sammendrag og forklaring

PAXgene blod-DNA-rør gir muligheten til å samle fullblod for å isolere gen-DNA i et lukket vakuumsystem. Blodet samles i samsvar med standard protokoll for venepunksjon i et vakuumsystem som inneholder K₂EDTA tilsetningsstoff. Fullstendig isolering av DNA utføres med manuelle eller automatiske metoder som presipitering, magnetperler eller teknologier basert på silikamembran.

III. Advarsler

Innholdet i dette røret irriterer huden.


- Etter innånding må den eksponerte personen flyttes til frisk luft.
- Etter hudkontakt må huden umiddelbart skylles med rikelige mengder såpe og vann i minst 15 minutter.
- Etter øyekontakt må det umiddelbart skylles med rikelige mengder vann i minst 15 minutter.
- Etter svelging må det umiddelbart gis store mengder vann. Oppsøk lege.

IV. Prøvetaking og preparering for analyse

A. Nødvendig blodprøvestyr (ikke inkludert med PAXgene blod-DNA-rør)

1. Blodprøvekanyler som BD Vacutainer® Eclipse™ blodprøvekanyler eller BD Vacutainer Eclipse Signal™ blodprøvekanyler. Se Bestillingsinformasjon.
2. Det må brukes en BD Vacutainer kanyلهolder for å sikre korrekt funksjon. Se Bestillingsinformasjon.
3. Etiketters for positiv donoridentifikasjon av prøvene etter behov
4. Alkoholserviett for å vaske punksjonsstedet
5. Tørr, ren kompress
6. Stasebånd
7. Kanyلهøtte for brukt kanyler eller kombinasjon av kanyler/holder.

B. Prosedyre for prøvetaking



Generelle instruksjoner

BRUK HANSKER UNDER VENEPUNKSJON OG VED HÅNDBLING AV BLODPRØVERØR FOR Å MINIMERE EKSPONERINGSFAREN.

1. Sett kanylen i holderen. Sørg for at kanylen er godt festet, slik at den ikke kan løsne under bruk.
2. Plasser røret i holderen. Merk: Ikke punkter korken.
3. Velg venepunksjonssted.
4. **Plasser stasebåndet. Klargjør venepunksjonsstedet med passende desinfiserende middel. IKKE PALPER VENEPUNKSJONSOMRÅDET ETTER DESINFISERING.**
5. Plasser pasientens arm slik at den heller nedover.
6. Fjern kanylehylsen. Utfør venepunksjon MED ARMEN HELLENDE NEDOVER OG RØRKORKEN VENDT OPP.
7. Sentrer røret i holderen når du penetrerer korken for å unngå penetrasjon av sideveggene, som kan føre til tap av vakuum. Skyv røret på kanylen slik at membranen i korken punkteres.
8. **FJERN STASEBÅNDET SÅ SNART BLODET STRØMMER INN I RØRET. IKKE LA INNHOLDET I RØRET KOMME I KONTAKT MED KORKEN ELLER ENDEN PÅ KANYLEN UNDER PROSEDYREN.**

Merk: Det kan av og til lekket blod fra kanylehylsen. Bruk generelle forsiktighetsregler for å minimere eksponeringsfaren. Hvis det ikke strømmer blod inn i røret eller hvis blodstrømmen stanser før adekvat prøve er trukket, foreslås følgende trinn for å gjennomføre en tilfredsstillende prøvetaking:

- a. Skyv røret fremover til rørkorken er penetret. Hold om nødvendig på plass for å sikre fullstendig vakuumtrekk.
 - b. Kontroller at kanylen sitter korrekt i venen.
9. Når det første røret er fylt opp til oppgitt volum og blodstrømmen avtar, fjernes det fra holderen.
 10. Inverter 8 ganger.
 11. Fjern kanylen fra venen og legg press på punksjonsstedet med en tørr, steril kompress til blødningen stanser.
 12. Når koagulasjon har funnet sted, settes det eventuelt på en bandasje.
 13. Etter venepunksjon kan toppen av korken inneholde blodrester. Ta nødvendige forholdsregler når du håndterer rør for å unngå kontakt med dette blodet.
 14. Kast kanylen og holderen i samsvar med din institusjons retningslinjer.
 15. Oppbevar det fylte PAXgene blod-DNA-røret ved romtemperatur (18-25 °C). Se funksjonsdata for DNA-stabilitet i blodprøver ved romtemperatur (18-25 °C), 2-8 °C, eller 20 °C.

Se Prosedyre for frysing og tining av prøver i PAXgene blod-DNA-rør for nærmere opplysninger hvis du ønsker en lagringstemperatur på -70 °C / -80 °C.

Følgende teknikker skal brukes for å unngå tilbakestrømming:

- a. Plasser donorens arm slik at den heller nedover.
- b. Hold røret med korken vendt opp.
- c. Løsne stasebåndet så snart blodet begynner å strømme inn i røret.
- d. Påse at tilsetningsstoffene i røret ikke berører korken eller enden på kanylen under venepunksjon.

C. Prosedyre for frysing og tining av prøver i PAXgene blod-DNA-rør

1. Sett PAXgene blod-DNA-rør oppreist i et trådstativ. **Ikke frys rør stående på et isoporbrett, da dette kan gjøre at rørene sprekker.**
2. PAXgene blod-DNA-rør kan oppbevares ved -20 °C og kaldere. Hvis rørene skal oppbevares ved temperaturer under -20 °C, skal de først fryses ved -20 °C i 24 timer, deretter skal de overføres til -70 °C eller -80 °C.
3. Tin opp PAXgene blod-DNA-rør i et trådstativ ved omgivelsestemperatur (18-25 °C) i ca. to timer. **Ikke tin PAXgene blod-DNA-rør ved temperaturer over 25 °C.**
4. Inverter de opptinte PAXgene blod-DNA-rørene forsiktig 10 ganger.

(Fortsatt)

Merk: Frosne PAXgene blod-DNA-rør kan sprekke hvis de støtes. For å redusere faren for sprekker under forsendelse, må frosne rør behandles på samme måte som glassrør. Brukere bør validere deres egen fryse- og forsendelsesprotokoll for PAXgene blod-DNA-rør.


D. Prosedyre for preparering av prøver for analyse

Blodprøvene bør behandles i samsvar med instruksjonene som følger med settet for DNA-prøvepreparering. Se Bestillingsinformasjon for eksempler.

V. Funksjonsdata

Etter at blodet er fylt i røret, er DNA stabilt i 14 dager ved 18°C til 25 °C (Figur 1). Basert på studier av DNA-stabilitet kan blod oppbevares i røret i 14 dager ved 18-25 °C, 28 dager ved 2-8 °C, 3 dager ved 35 °C eller minst 6 måneder ved -20°C med DNA-konsentrasjon $\geq 12,5$ ng/ μ l og DNA-renhet (A_{260}/A_{280}) på 1,7-1,9. Oppdaterte data om stabiliteten til frosne prøver finner du på www.PreAnalytiX.com.

DNA-stabilitet i blodprøver ved 18-25 °C

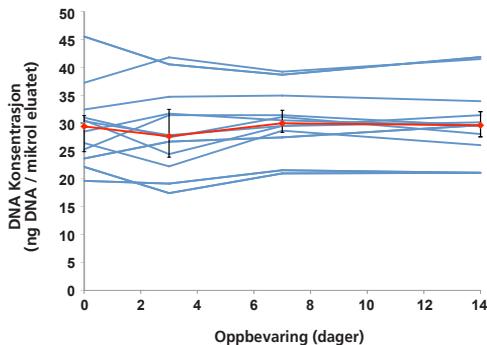

Figur 1

Blod ble trukket fra 12 frivillige voksne donorer og lagret ved 18-25 °C i det indikerte antallet dager, etterfulgt av total DNA-rensing. Blod ble samlet inn og oppbevart i PAXgene blod-DNA-rør, og total DNA ble rensing med QIAGEN® QIAasymphony® DSP DNA Mini Kit på et QIAGEN QIAasymphony automatisk instrument.

VI. Begrensninger

1. Mengden av blod som trekkes bør være 2,5 ml per PAXgene blod-DNA-rør, men dette kan variere med høyde over havet, omliggende temperatur, barometrisk trykk, rørets alder, venetrykket og fylleteknikken.

VII. Forsiktighetsregler


1. Utvis generell forsiktighet. Bruk hansker, frakker, øyebeskyttelse og annet personlig verneutstyr og teknisk kontroll til å beskytte mot blodsprut, blodlekkasje og potensiell eksponering for patogener i blodet.
2. Håndter alle biologiske prøver og skarpt blodprøveutstyr i samsvar med retningslinjer og prosedyrer ved din institusjon. Hvis det oppstår eksponering for biologiske prøver (for eksempel ved en stikkskade), må du kontakte medisinsk personell fordi prøver kan overføre HBV (viral hepatitt), HIV (AIDS) eller andre infeksjonssykdommer.
Bruk enhver innebygd kanylebeskyttelse hvis blodprøveenheten har dette. PreAnalytiX anbefaler ikke å sette nye hylser på brukte kanyler. Imidlertid kan regler og prosedyrer ved din institusjon være annerledes, og de må følges.
3. Alle blodprøverør skal kastes i beholdere godkjent for slikt avfall.
4. Ikke bruk PAXgene blod-DNA-rør om igjen.
5. Ikke bruk PAXgene blod-DNA-rør etter utløpsdatoen, som er trykket på røretiketten.
6. For stor sentrifugeringshastighet (over 10 000 RCF) kan gjøre at PAXgene blod-DNA-rør sprekker, noe som kan føre til blodeksponering og mulige skader.
7. Ikke overfør en prøve fra en sprøyte til et rør.

(Fortsatt)

VIII. Oppbevaring


1. Oppbevar ubrukte PAXgene blod-DNA-rør ved 18 °C til 25 °C. Begrenset temperaturavvik opptil 40 °C tillates. Rørene skal ikke brukes etter utløpsdatoen.

IX. Instruksjoner for fjerning av BD Hemogard-kork



1. Grip PAXgene blod-DNA-røret med én hånd og plasser tommelen under BD Hemogard-korken. (Du får bedre stabilitet hvis armen plasseres på et solid underlag). Med den andre hånden vrir du BD Hemogard-korken mens du samtidig skyver opp med tommelen på den andre hånden, KUN TIL RØRKORKEN LØSNER.
2. Flytt tommelen vekk før du løfter av korken. IKKE bruk tommelen til å skyve korken av røret. Hvis røret inneholder blod, utgjør dette en eksponeringsfare. For å unngå uhell når korken fjernes er det viktig at tommelen som brukes til å skyve korken oppover, fjernes fra røret så snart BD Hemogard-korken løsner.
3. Løft korken av røret. Dersom plastdekslet skulle løsne fra gummikorken, noe som er lite sannsynlig, MÅ DU IKKE SETTE KORKEN SAMMEN IGJEN. Fjern gummikorken forsiktig fra røret.

X. Instruksjoner for å sette på plass en BD Hemogard-kork



1. Sett korken over røret.
2. Vri og skyv bestemt ned til korken sitter helt på plass. Det er viktig at korken settes helt på plass for at den skal sitte trygt på røret under håndtering.

Teknisk assistanse

Hvis du har spørsmål om PAXgene blod-DNA-rør, kan du kontakte en av BD tekniske serviceavdelinger på listen i avsnittet BD – Kundeservice.

Bestillingsinformasjon

PAXgene-produkter

PAXgene blod-DNA-rør / 761165

Innhold: 1 000 blodprøverør

BD-produkter*

BD Vacutainer Eclipse blodprøvekanyle / 368609 CE

Innhold: 21G 1¼" kanyle, 0,8 mm x 32 mm, 48/pakning, 480/eske

BD Vacutainer Eclipse blodprøvekanyle med forhåndsmontert holder / 368650

Innhold: 21G 1¼" kanyle, 0,8 mm x 32 mm, 100/pakning

BD Vacutainer Eclipse Signal blodprøvekanyle / 368835 CE

Innhold: 21G 1¼" kanyle, 0,8 mm x 32 mm, 50/pakning, 400/eske

BD Vacutainer engangsholder / 364815

Innhold: Kun eske for 13 mm og 16 mm diameter 1000/eske

* Disse katalognumrene representerer typiske produkter som kan brukes med PAXgene blod-DNA-rør.

Slik bestilles BD blodprøvestyr:

Gå til: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Velg land • Bla ned til BD Diagnostics - Preanalytiske systemer • Slå nummeret

QIAGEN-produkter*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA-kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Innhold: Reagenspatron, enzymstativ, punkteringslokk, buffer-ATE, forseglingssett til gjenbruk

QIAGEN QIAamp® DSP DNA-kit / 61104 (50)

Innhold: QIAamp Mini spinnesøyler, prøverør, buffer-AL, buffer-ATL, buffer-AW1, buffer-AW2, buffer-AE, QIAGEN protease, proteaseløsning

QIAGEN Gentra® Puregene® blod-kit / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Innhold: RBC lysisløsning, cellelysisløsning, proteinpresipiteringsløsning, DNA-hydreringsløsning, RNase A-løsning

* Disse katalognumrene representerer typiske DNA-prepareringssett som kan brukes med PAXgene blod-DNA-rør.

Slik bestilles QIAGEN DNA-prepareringssett:

Gå til: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

PAXgene blod-DNA-rør fremstilles i Storbritannia av BD for PreAnalytiX GmbH. PAXgene og PreAnalytiX er varemerker som tilhører PreAnalytiX GmbH. QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene er varemerker som tilhører QIAGEN NV. Styrofoam et varemerke som tilhører The Dow Chemical Company. Alle andre varemerker tilhører Becton, Dickinson and Company.

(Fortsatt)

BD - Kundeservice

Argentina, Uruguay og Paraguay

Bestillinger: 011.4551.7100
E-post: crc_argentina@bd.com

Australia

Bestillinger: 1.800.656.100
Faks: 1.800.656.110
E-post: bd_anz@bd.com

Østerrike

Bestillinger: 43.1.7063660
Faks: 43.1.7063660-11

Belgia

Bestillinger: 32.53.720.556
Faks: 32.53.720.549

Brasil

Bestillinger: 0800.055.5654
E-post: consultoria_vacutainer@bd.com

Canada

Bestillinger: 800.268.5430
Faks: 800.565.0897
E-post: custsvccan@bd.com

Danmark

Bestillinger: 45.43.43.45.66
Faks: 45.43.96.56.76
E-post: bdcs_dk@europe.bd.com

Øst-Europa

Bestillinger: 48.22.651.75.88
Faks: 48.22.651.75.89

Finland

Bestillinger: 358.9.88.70.780
Faks: 358.9.88.70.7816
E-post: bdorder_finland@europe.bd.com

Frankrike

Bestillinger: 33.476.689496
Faks: 33.476.683693
E-post: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Tyskland

Bestillinger: 49.6221305553
Faks: 49.6221305379

Italia

Bestillinger: 39.02.48.240.500
Faks: 39.02.48.240.344
Teknisk: 39.02.48.240.264
E-post: ordini_medicale@europe.bd.com

Midt-Østen og Afrika (EMA)

Bestillinger: 971.4.3379525
Faks: 971.4.03379551
E-post: EMA_PAS@bd.com

Nederland

Bestillinger: 31.20.6545.716
Faks: 31.20.5829.421
E-post: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

New Zealand

Bestillinger: 0800.572.468
Faks: 0800.572.469
E-post: bd_anz@bd.com

Norge:

Bestillinger: 47.73.59.12.00
Faks: 47.73.59.12.01

Spania

Bestillinger: 34.902.27.17.27
Faks: 34.91.848.81.04
E-post: servicio_de_clientes@bd.com

Sverige

Bestillinger: 46.8.775.51.60
Faks: 46.8.775.51.95
E-post: bdorder_sweden@europe.bd.com

Sveits

Bestillinger: 41.61.4852222
Bestillinger: 41.61.4852200

Storbritannia

Bestillinger: 44.1.865.781.666
Faks: 44.1.865.717.313
E-post: bduk_customerservice@europe.bd.com

USA

Bestillinger: 888.237.2762
Faks: 800.847.2220
Teknisk: 800.631.0174
E-post: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN - Kundeservice

Australia

Bestillinger: 03.9840.9800
Faks: 03.9840.9888
Teknisk: 1.800.243.066

Østerrike

Bestillinger: 0800/28.10.10
Faks: 0800/28.10.19
Teknisk: 0800/28.10.11

Belgia

Bestillinger: 0800.79612
Faks: 0800.79611
Teknisk: 0800.79556

Canada

Bestillinger: 800.572.9613
Faks: 800.713.5951
Teknisk: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Kina

Bestillinger: 0086.21.3865.3865
Faks: 0086.21.3865.3965
Teknisk: 800.988.0325 / 800.988.0327

Danmark

Bestillinger: 80.885945
Faks: 80.885944
Teknisk: 80.885942

Finland

Bestillinger: 0800.914416
Faks: 0800.914415
Teknisk: 0800.914413

Frankrike

Bestillinger: 01.60.920.926
Faks: 01.60.920.925
Teknisk: 01.60.920.930
Tilbud: 01.60.920.928

Tyskland

Bestillinger: 02103.29.12000
Faks: 02103.29.22000
Teknisk: 02103.29.12400

Hong Kong

Bestillinger: 800.933.965
Faks: 800.930.439
Teknisk: 800.930.425

Irland

Bestillinger: 1800.555.049
Faks: 1800.555.048
Teknisk: 1800.555.061

Italia

Bestillinger: 02.33430411
Faks: 02.33430426
Teknisk: 800.787980

Japan

Bestillinger: 03.5547.0811
Faks: 03.5547.0818
Teknisk: 03.5547.0811

Korea (Sør)

Bestillinger: 1544.7145
Faks: 1544.7146
Teknisk: 1544.7145

Luxembourg

Bestillinger: 8002.2076
Faks: 8002.2073
Teknisk: 8002.2067

Nederland

Bestillinger: 0800.0229592
Faks: 0800.0229593
Teknisk: 0800.0229602

Norge

Bestillinger: 800.18859
Faks: 800.18817
Teknisk: 800.18712

Singapore

Bestillinger: 65.67775366
Faks: 65.67785177
Teknisk: 65.67775366

Spania

Bestillinger: 91.630.7050
Faks: 91.630.5145
Teknisk: 91.630.7050

Sverige

Bestillinger: 020.790282
Faks: 020.790582
Teknisk: 020.798328

Sveits

Bestillinger: 055.254.22.11
Faks: 055.254.22.13
Teknisk: 055.254.22.12

Storbritannia

Bestillinger: 01293.422.911
Faks: 01293.422.922
Teknisk: 01293.422.999

USA

Bestillinger: 800.426.8157
Faks: 800.718.2056
Teknisk: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Probówka do DNA z krwi

PL – Polski

I. Przeznaczenie

Probówka PAXgene do DNA z krwi jest przeznaczona do pobierania, antykoagulacji, stabilizacji, transportowania oraz przechowywania próbki krwi żyłnej pełnej w celu przygotowania wysokiej jakości DNA na potrzeby molekularnych badań diagnostycznych, które wymagają DNA.

Charakterystyka działania niniejszych probówek nie została określona dla molekularnych testów diagnostycznych ogólnie. Użytkownicy muszą przeprowadzić walidację zastosowania produktu dla swoich konkretnych molekularnych testów diagnostycznych.

Właściwości produktu

Probówka PAXgene Blood do DNA z krwi • 2,5 ml • 13 x 75 mm • dodatek K₂EDTA
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 probówek/pudełko • 1 000 probówek/pudło

II. Streszczenie i wyjaśnienia

Probówka PAXgene do DNA z krwi pozwala na pobranie krwi pełnej w celu izolacji DNA genomowego w zamkniętym systemie próżniowym. Krew jest pobierana do probówki próżniowej, która zawiera dodatek K₂EDTA, zgodnie ze standardowym protokołem nakłuwania żyły. Pełna izolacja DNA jest przeprowadzana przy użyciu metod manualnych lub automatycznych, takich jak wysalanie lub wytrącanie, kulki magnetyczne, czy technologii opartych na membranach krzemionkowych.

III. Ostrzeżenia

Zawartość tej probówki działa drażniąco na skórę.


- W razie inhalacji wyprowadzić narażoną osobę na świeże powietrze.
- W razie kontaktu ze skórą natychmiast spłukać skórę dużą ilością wody z mydłem przez co najmniej 15 minut.
- W razie kontaktu z oczami natychmiast przepłukać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut.
- W razie połknięcia natychmiast podać dużą ilość wody. Uzyskać pomoc lekarską.

IV. Pobieranie próbki i przygotowanie do analizy

A. Wymagane akcesoria do pobierania krwi (niedostarczane razem z probówką PAXgene do DNA z krwi)

1. Igła do pobierania krwi, taka jak BD Vacutainer® Eclipse™ lub BD Vacutainer Eclipse Signal™. Zob. Składanie zamówień.
2. Warunkiem prawidłowego działania jest zastosowanie uchwytu BD Vacutainer Needle Holder. Zob. Składanie zamówień.
3. Etykiety do identyfikacji próbek od dawców z wynikiem dodatnim, jeśli wymagane.
4. Waciki nasączone alkoholem do przemywania miejsca wkłucia.
5. Sucha jałowa gaza.
6. Opaska uciskowa.
7. Pojemnik na używane igły lub igły z uchwytem.

B. Procedura pobierania próbek



Instrukcje ogólne

PODZAS WYKONYWANIA WKŁĘCIA DOŻYLNEGO ORAZ MANIPULOWANIA PROBÓWKAMI DO POBIERANIA KRWI NALEŻY NOSIĆ RĘKAWICZKI, ABY OGRANICZYĆ DO MINIMUM RYZYKO NARAŻENIA NA KONTAKT Z KRWIĄ.

1. Zamontować igłę w uchwycie. Upewnić się, że jest mocno osadzona, aby nie odkręciła się podczas używania.
2. Umieścić probówkę w uchwycie. Uwaga: Nie przekłuwać zatyczki.
3. Wybrać miejsce wkłucia dożylnego.
4. **Założyć opaskę uciskową. Przygotować miejsce wkłucia dożylnego, stosując odpowiedni środek antyseptyczny. NIE DOTYKAĆ MIEJSCA WKŁĘCIA PALCAMI PO JEGO OCZYSZCZENIU.**
5. Ułożyć przedramię pacjenta w pozycji skierowanej do dołu.
6. Zdjąć osłonkę igły. Wykonać wkłucie W PRZEDRAMIENIU SKIEROWANYM DO DOŁU I TAK, ABY KOREK PROBÓWKI ZNAJDOWAŁ SIĘ NA GÓRZE.
7. Podczas przekłuwania korka probówki muszą znajdować się w uchwytach w położeniu centralnym, aby zapobiec przebiciu ścianek i przedczesnemu uwolnieniu podciśnienia. Wcisnąć probówkę na igłę, przekłuwając błonę korka.
8. GDY TYLKO KREW POJAWI SIĘ W PROBÓWCE, ZDJAĆ OPASKĘ. NIE DOPUŚCIĆ DO ZETKNIĘCIA SIĘ ZAWARTOŚCI PROBÓWKI Z KORKIEM LUB KOŃCÓWKĄ IGŁY.

Uwaga: Z tulejki igły może czasami wyciekać krew. Należy zachować standardowe środki ostrożności, aby ograniczyć ryzyko narażenia na kontakt z krwią. Jeśli do probówki nie napływa krew lub przestaje płynąć przed pobraniem wystarczającej objętości próbki, należy wykonać następujące czynności:

- a. Popchnąć probówkę do momentu przebicia korka. W razie potrzeby przytrzymać ją, aby zapewnić zassanie podciśnienia.
 - b. Sprawdzić, czy igła jest prawidłowo umieszczona w żyłę.
9. Jeśli po napełnieniu probówki do pełnej objętości krew przestaje płynąć, zdjąć probówkę z uchwytu.
 10. Odwrócić 8 razy.
 11. Wyjąć igłę z żyły, mocno przyciskając miejsce wkłucia suchym, jałowym wacikiem do czasu ustania krwawienia.
 12. Po utworzeniu się skrzepu, w razie potrzeby założyć bandaż.
 13. Po wkłuciu dożylnym w górnej części zatyczki może znaleźć się mała ilość krwi. Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby uniknąć kontaktu z tą krwią.
 14. Igłę i uchwyt wyrzucić zgodnie z wytycznymi i zasadami obowiązującymi w placówce.
 15. Przechowywać napełnioną probówkę PAXgene do DNA z krwi w temperaturze pokojowej (18-25°C). Zobacz Charakterystyka działania dla stabilności DNA w próbkach krwi w temperaturze pokojowej (18-25°C), 2-8°C lub -20°C.

Jeśli wskazane jest przechowywanie probówek w temperaturze -70°C / -80°C należy zapoznać się z informacjami podanymi w punkcie Procedura zamrażania i odmrażania próbek pobranych do probówek PAXgene do DNA z krwi.

Abby wykluczyć cofanie się krwi, należy zastosować następujące środki:

- a. Umieścić przedramię pacjenta w pozycji skierowanej do dołu.
- b. Chwycić probówkę tak, aby zatyczka znajdowała się najwyżej.
- c. Zwolnić opaskę uciskową, gdy tylko krew zacznie napływać do probówki.
- d. Dopilnować, by podczas nakłuwania żyły dodatki w probówce nie dotykały korka ani końca igły.

(Fortsatt)

C. Procedura zamrażania i odmrażania próbek pobranych do próbki PAXgene do DNA z krwi

1. Postawić próbkę PAXgene do DNA z krwi w metalowym statywie. **Nie zamrażać próbek stojących w tacy styropianowej Styrofoam™, ponieważ może to powodować ich pękanie.**
2. Probówki PAXgene do DNA z krwi można przechowywać w temperaturze -20°C lub niższej. Jeśli probówki mają być przechowywane w temperaturze poniżej -20°C, należy je najpierw zamrozić do -20°C i przechować w tej temperaturze przez 24 godziny, a następnie przenieść do temperatury -70°C lub -80°C.
3. Probówki PAXgene do DNA z krwi należy rozmrażać w metalowym statywie, w temperaturze otoczenia (18-25°C) przez około dwie godziny. **Nie rozmrażać próbek PAXgene do DNA z krwi w temperaturze przekraczającej 25°C.**
4. Ostrożnie odwrócić rozmrożoną próbkę PAXgene do DNA z krwi 10 razy.

Uwaga: Zamrożone próbki PAXgene do DNA z krwi mogą pękać pod wpływem uderzenia. Aby ograniczyć ryzyko pęknięcia podczas transportu, z próbkami zamrożonymi należy postępować tak samo, jak ze szklanymi. Użytkownicy powinni opracować i zatwierdzić własny protokół zamrażania i transportu próbek PAXgene do DNA z krwi.

D. Procedura przygotowania próbki do analizy


Próbki krwi muszą być przetwarzane zgodnie z instrukcjami dołączonymi do zestawu do przygotowywania próbek DNA. Przykłady znajdują się w punkcie Składanie zamówień.

V. Charakterystyka działania

Po wprowadzeniu krwi do próbki DNA pozostaje stabilne przez 14 dni w temp. od 18°C do 25°C (Ryc. 1). W oparciu o badania dotyczące stabilności DNA, krew może być przechowywana w próbce przez 14 dni w temp. od 18°C do 25°C, przez 28 dni w temp. od 2 do 8°C, przez 3 dni w temp. 35°C lub przez minimum 6 miesięcy w temp. -20°C przy stężeniu DNA $\geq 12,5$ ng/ μ l i czystości (A_{260}/A_{280}) 1,7-1,9.

Aby uzyskać najnowsze dane na temat stabilności zamrożonych próbek, należy zajrzeć na stronę www.PreAnalytiX.com.

Stabilność DNA w próbkach krwi w temperaturze 18-25°C

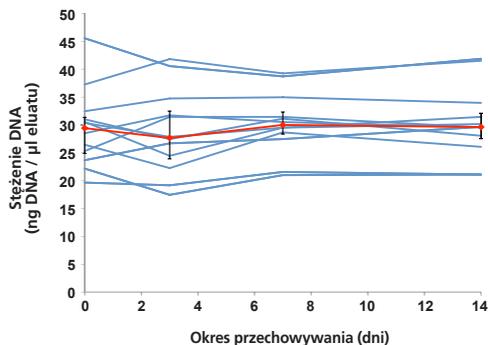

Rysunek 1

Krew pobrano od 12 dorosłych dawców, którzy wyrazili na to zgodę i przechowywano w temperaturze 18-25°C przez podaną liczbę dni, a następnie przeprowadzono oczyszczanie całkowitego DNA. Krew była pobierana do próbek PAXgene do DNA z krwi i w nich przechowywana, a całkowity DNA oczyszczano za pomocą zestawu QIAGEN® QIAAsymphony® DSP DNA Mini Kit w automatycznym urządzeniu QIAGEN QIAAsymphony.

VI. Ograniczenia

1. Ilość krwi pobranej do jednej próbki PAXgene do DNA z krwi powinna wynosić 2,5 ml, jednak faktyczna ilość pobranej krwi może zależeć od wysokości n.p.m., temperatury otoczenia, ciśnienia barometrycznego, wieku próbki, ciśnienia w żyłach i techniki napełniania.

VII. Środki ostrożności

1. Stosować uniwersalne środki ostrożności. Stosować rękawice, odzież i gogle ochronne oraz inne środki ochrony osobistej, a także metody technologiczne zabezpieczające przed rozpryskiem lub rozlaniem krwi i potencjalnym narażeniem na czynniki chorobotwórcze przenoszone we krwi.
2. Ze wszystkimi próbkami biologicznymi i „ostrymi” elementami zestawów do pobierania krwi należy postępować zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi w danej placówce. W razie narażenia na kontakt z próbkami biologicznymi (np. w wyniku zakłucia) należy uzyskać odpowiednią pomoc medyczną, ponieważ próbki takie mogą przenosić wirusa zapalenia wątroby, HIV (AIDS) oraz inne choroby zakaźne.


Jeśli zestaw do pobierania krwi zawiera zabezpieczenie na igłę, należy z niego korzystać. PreAnalytiX nie zaleca ponownego nakładania osłon na zużyte igły. Należy jednak zawsze stosować się do procedur obowiązujących w placówce, które mogą zalecać inne postępowanie.

3. Wszystkie próbki do pobierania krwi należy wyrzucać do zatwierdzonych pojemników na odpady potencjalnie niebezpieczne biologicznie.
4. Nie używać ponownie próbek PAXgene do DNA z krwi.
5. Nie używać próbek PAXgene do DNA z krwi po terminie ważności wydrukowanym na etykiecie próbek.
6. Wirowanie z nadmierną prędkością (ponad 10 000 RCF) może doprowadzić do pęknięcia próbki PAXgene do DNA z krwi, narażenia na kontakt z krwią i urazu.
7. Nie przelewać próbki ze strzykawki do próbki.

VIII. Przechowywanie


1. Nieużywane próbki PAXgene do DNA z krwi należy przechowywać w temperaturze od 18°C do 25°C. Dopuszczalne są krótkotrwałe odchylenia temperatury do maksymalnie 40°C. Nie stosować próbek po upływie daty ważności.

IX. Instrukcja zdejmowania zamknięcia BD Hemogard



1. Chwycić próbkę PAXgene do DNA z krwi jedną dłonią, tak aby kciuk znalazł się pod zamknięciem BD Hemogard. (Dla lepszej stabilności oprzeć przedramię na mocnym podłożu). Drugą ręką przekreślać zamknięcie BD Hemogard jednocześnie popychając je do góry kciukiem DO MOMENTU ODKRĘCENIA ZATYCZKI PROBÓWKI.
2. Przed podniesieniem zamknięcia odsunąć kciuk. NIE zsuwać zamknięcia z próbki kciukiem. W przypadku próbek z krwią istnieje ryzyko narażenia na kontakt z krwią. Aby zapobiec zranieniu podczas otwierania, kciuk używany do wypchnięcia do góry zamknięcia należy cofnąć od próbki natychmiast po odkręceniu zamknięcia BD Hemogard.
3. Zdjąć zamknięcie z próbki. W mało prawdopodobnym przypadku oddzielenia się plastikowej osłonki od gumowej zatyczki, NIE WOLNO PONOWNIE MOCOWAĆ ZAMKNIĘCIA. Ostrożnie zdjąć gumową zatyczkę z próbki.

X. Instrukcja ponownego nakładania zamknięcia BD Hemogard



1. Ponownie nałożyć zamknięcie na probówkę.
2. Przekręcić i mocno wcisnąć, aby zatyczka w pełni zaskoczyła. Konieczne jest wkładanie zatyczki do końca, tak aby podczas pracy z probówką zamknięcie nie otworzyło się.

Pomoc techniczna

W przypadku pytań dotyczących probówek PAXgene do DNA z krwi, należy się skontaktować z jednym z działów pomocy technicznej firmy BD wymienionych w części BD – Obsługa klienta.

Składanie zamówień

Produkty PAXgene

Probówka PAXgene do DNA z krwi / 761165

Zawartość: 1000 probówek do pobierania krwi.

Produkty BD*

Igła do pobierania krwi BD Vacutainer Eclipse / 368609 CE

Zawartość: Igła 21G o długości 1/4 cala, 0,8 mm x 32 mm, 48/opakowanie, 480/karton

Igła do pobierania krwi BD Vacutainer Eclipse ze wstępnie założonym uchwytem / 368650

Zawartość: Igła 21G o długości 1/4 cala, 0,8 mm x 32 mm, 100/karton

Igła do pobierania krwi BD Vacutainer Eclipse Signal / 368835 CE

Zawartość: Igła 21G o długości 1/4 cala, 0,8 mm x 32 mm, 50/opakowanie, 400/karton

Uchwyt jednorazowy BD Vacutainer / 364815

Zawartość: Opakowanie zbiorcze tylko w przypadku średnic 13 mm i 16 mm 1000/karton

* Te numery katalogowe odpowiadają typowym produktom, które mogą być używane z probówką PAXgene do DNA z krwi.

Aby zamówić akcesoria firmy BD do pobierania krwi:

Przejdź pod adres: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Wybierz kraj • Przewiń do odpowiedniego oddziału BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Wybierz numer

Produkty QIAGEN*

Zestaw QIAGEN QIAasympHony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Zawartość: Kasetka z odczytnikami, stojak z enzymami, pokrywa przekłuwająca, bufor ATE, zamknięcie wielorazowe

Zestaw QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Zawartość: QIAamp kolumny minispin, probówki do pobierania, bufor AL, bufor ATL, bufor AW1, bufor AW2, bufor AE, proteaza QIAGEN, rozpuszczalnik proteazy

Zestaw QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Zawartość: roztwór do lizy erytrocytów, roztwór do lizy komórek, roztwór do wytrącania białek, do uwodnienia DNA, roztwór RNazy A

* Te numery katalogowe odpowiadają typowym zestawom do przygotowania DNA, które mogą być używane z probówką PAXgene do DNA z krwi.

Aby zamówić zestawy do przygotowania DNA QIAGEN:

Przejdź pod adres: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

Probówka PAXgene do DNA z krwi została wyprodukowana w Wielkiej Brytanii przez firmę BD dla firmy PreAnalytiX GmbH. PAXgene PreAnalytiX są znakami towarowymi firmy PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene są znakami towarowymi firmy QIAGEN NV; Styrofoam jest znakiem towarowym firmy The Dow Chemical Company; wszystkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność firmy Becton, Dickinson and Company.

BD – Obsługa klienta

Argentyna, Urugwaj i Paragwaj

Zamówienia: 011.4551.7100
E-mail: crc_argentina@bd.com

Australia

Zamówienia: 1.800.656.100
Faks: 1.800.656.110
E-mail: bd_anz@bd.com

Austria

Zamówienia: 43.1.7063660
Faks: 43.1.7063660-11

Belgia

Zamówienia: 32.53.720.556
Faks: 32.53.720.549

Brazylia

Zamówienia: 0800.055.5654
E-mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Zamówienia: 800.268.5430
Faks: 800.565.0897
E-mail: custsvccan@bd.com

Dania

Zamówienia: 45.43.43.45.66
Faks: 45.43.96.56.76
E-mail: bdcs_dk@europe.bd.com

Europa wschodnia

Zamówienia: 48.22.651.75.88
Faks: 48.22.651.75.89

Finlandia

Zamówienia: 358.9.88.70.780
Faks: 358.9.88.70.7816
E-mail: bdorder_finland@europe.bd.com

Francja

Zamówienia: 33.476.689496
Faks: 33.476.683693
E-mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Niemcy

Zamówienia: 49.6221305553
Faks: 49.6221305379

Włochy

Zamówienia: 39.02.48.240.500
Faks: 39.02.48.240.344
Pomoc techniczna: 39.02.48.240.264
E-mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Bliski Wschód i Afryka (EMA)

Zamówienia: 971.4.3379525
Faks: 971.4.03379551
E-mail: EMA_PAS@bd.com

Holandia

Zamówienia: 31.20.6545.716
Faks: 31.20.5829.421
E-mail: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Nowa Zelandia

Zamówienia: 0800.572.468
Faks: 0800.572.469
E-mail: bd_anz@bd.com

Norwegia:

Zamówienia: 47.73.59.12.00
Faks: 47.73.59.12.01

Hiszpania

Zamówienia: 34.902.27.17.27
Faks: 34.91.848.81.04
E-mail: servicio_de_clientes@bd.com

Szwecja

Zamówienia: 46.8.775.51.60
Faks 46: 8.775.51.95
E-mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Szwajcaria

Zamówienia: 41.61.4852222
Faks: 41.61.4852200

Wlk. Brytania

Zamówienia: 44.1.865.781.666
Faks: 44.1.865.717.313
E-mail: bduk_customerservice@europe.bd.com

USA

Zamówienia: 888.237.2762
Faks: 800.847.2220
Pomoc techniczna: 800.631.0174
E-mail: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Obsługa klienta

Australia

Zamówienia: 03.9840.9800

Faks: 03.9840.9888

Pomoc techniczna: 1.800.243.066

Austria

Zamówienia: 0800/28.10.10

Faks: 0800/28.10.19

Pomoc techniczna: 0800/28.10.11

Belgia

Zamówienia: 0800.79612

Faks: 0800.79611

Pomoc techniczna: 0800.79556

Kanada

Zamówienia: 800.572.9613

Faks: 800.713.5951

Pomoc techniczna: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Chiny

Zamówienia: 0086.21.3865.3865

Faks: 0086.21.3865.3965

Pomoc techniczna: 800.988.0325 / 800.988.0327

Dania

Zamówienia: 80.885945

Faks: 80.885944

Pomoc techniczna: 80.885942

Finlandia

Zamówienia: 0800.914416

Faks: 0800.914415

Pomoc techniczna: 0800.914413

Francja

Zamówienia: 01.60.920.926

Faks: 01.60.920.925

Pomoc techniczna: 01.60.920.930

Oferty: 01.60.920.928

Niemcy

Zamówienia: 02103.29.12000

Faks: 02103.29.22000

Pomoc techniczna: 02103.29.12400

Hong Kong

Zamówienia: 800.933.965

Faks: 800.930.439

Pomoc techniczna: 800.930.425

Irlandia

Zamówienia: 1800.555.049

Faks: 1800.555.048

Pomoc techniczna: 1800.555.061

Włochy

Zamówienia: 02.33430411

Faks: 02.33430426

Pomoc techniczna: 800.787980

Japonia

Telefon: 03.5547.0811

Faks: 03.5547.0818

Pomoc techniczna: 03.5547.0811

Korea (Poł.)

Zamówienia: 1544.7145

Faks: 1544.7146

Pomoc techniczna: 1544.7145

Luksemburg

Zamówienia: 8002.2076

Faks: 8002.2073

Pomoc techniczna: 8002.2067

Holandia

Zamówienia: 0800.0229592

Faks: 0800.0229593

Pomoc techniczna: 0800.0229602

Norwegia

Zamówienia: 800.18859

Faks: 800.18817

Pomoc techniczna: 800.18712

Singapur

Zamówienia: 65.67775366

Faks: 65.67785177

Pomoc techniczna: 65.67775366

Hiszpania:

Zamówienia: 91.630.7050

Faks: 91.630.5145

Pomoc techniczna: 91.630.7050

Szwecja

Zamówienia: 020.790282

Faks: 020.790582

Pomoc techniczna: 020.798328

Szwajcaria

Zamówienia: 055.254.22.11

Faks: 055.254.22.13

Pomoc techniczna: 055.254.22.12

Wlk. Brytania

Zamówienia: 01293.422.911

Faks: 01293.422.922

Pomoc techniczna: 01293.422.999

USA

Zamówienia: 800.426.8157

Faks: 800.718.2056

Pomoc techniczna: 800.DNA.PREP (800.362.7737)

Tubo para colheita de ADN no sangue

PT – Português

I. Finalidade

O PAXgene Blood DNA Tube (Tubo para colheita de ADN no sangue) destina-se à colheita, anticoagulação, estabilização, transporte e armazenamento de uma amostra de sangue total venoso para a preparação de ADN de alta qualidade a utilizar com métodos de teste de diagnóstico molecular que exijam ADN.

As características de desempenho deste dispositivo não se encontram estabelecidas para ensaios de diagnóstico molecular em geral. Os utilizadores devem validar a utilização do produto para o ensaio de diagnóstico molecular específico.

Características do produto

PAXgene Blood DNA Tube • 2,5 mL • 13 x 75 mm • Aditivo K₂EDTA
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 tubos/embalagem de cartão • 1000 tubos/embalagem

II. Resumo e explicação

O PAXgene Blood DNA Tube faculto um meio para colheita, processamento e transporte de sangue total destinado a isolar o ADN genómico num sistema com vácuo fechado. O sangue é colhido segundo um protocolo de flebotomia padrão para dentro de um tubo com vácuo que contém o aditivo K₂EDTA. O isolamento completo do ADN é realizado utilizando métodos manuais ou automatizados, como a precipitação salina, esferas magnéticas ou tecnologias à base de membrana de sílica.

III. Advertências

O conteúdo deste tubo é irritante para a pele.


- Após a inalação, conduza a pessoa exposta para uma zona com ar fresco.
- Após o contacto com a pele, lave imediatamente com água e sabão abundantes durante pelo menos 15 minutos.
- Após o contacto com os olhos, lave imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos.
- Após a ingestão, dê imediatamente a beber grandes quantidades de água. Consulte um médico.

IV. Colheita da amostra e preparação para análise

A. Acessórios para colheita de sangue necessários (não incluídos com o PAXgene Blood DNA Tube)

1. Agulha para colheita de sangue como a Agulha para Colheita de Sangue BD Vacutainer® Eclipse™ ou a Agulha para Colheita de Sangue BD Vacutainer Eclipse Signal™. Consulte Informações para encomenda.
2. Deve usar-se o Suporte de Agulhas BD Vacutainer para garantir uma função adequada. Consulte Informações para encomenda.
3. Rótulos para identificação de dador positivo nas amostras, se necessário
4. Cotonete de álcool para limpar o local
5. Compressa estéril e seca
6. Garrote
7. Contentor para eliminação de agulhas para agulhas ou combinação agulha/suporte usados

B. Procedimento para colheita de amostras



(continuação)

Instruções gerais

USE LUVAS DURANTE A PUNÇÃO VENOSA E QUANDO MANIPULAR TUBOS DE COLHEITA DE SANGUE PARA MINIMIZAR O PERIGO DE EXPOSIÇÃO.

1. Monte a agulha no suporte. Certifique-se de que a agulha está firmemente assente para garantir que a agulha não se desenrosca durante a utilização.
2. Coloque o tubo no suporte. Nota: Não perfure a rolha.
3. Seleccione o local para punção venosa.
4. **Aplique o garrote. Desinfecte o local de punção venosa com um anti-séptico adequado. NÃO PALPE A ÁREA DE PUNÇÃO VENOSA DEPOIS DA LIMPEZA.**
5. Coloque o braço do doente numa posição descendente.
6. Retire a protecção da agulha. Efectue a punção venosa COM O BRAÇO PARA BAIXO E A ROLHA DO TUBO NA POSIÇÃO MAIS SUPERIOR.
7. Centre os tubos no suporte quando penetrar a rolha para impedir a penetração da parede lateral e perda prematura de vácuo resultante. Empurre o tubo para a agulha, punctionando o diafragma da tampa.
8. **RETIRE O GARROTE ASSIM QUE OBSERVE SANGUE NO TUBO. NÃO DEIXE QUE O CONTEÚDO DO TUBO ENTRE EM CONTACTO COM A ROLHA OU EXTREMIDADE DA AGULHA DURANTE O PROCEDIMENTO.**

Nota: Podem ocasionalmente ocorrer fugas de sangue da manga da agulha. Siga as Precauções Universais para minimizar o perigo de exposição. Se não fluir sangue para o tubo ou se o sangue deixar de fluir antes da colheita de uma amostra adequada, sugerem-se os passos seguintes para concluir uma colheita adequada:

- a. Empurre o tubo para a frente até que a rolha do tubo tenha sido penetrada. Se for necessário, mantenha no lugar para garantir uma colheita completa sob vácuo.
 - b. Confirme a posição correcta da agulha na veia.
9. Depois de o primeiro tubo se ter enchido até ao seu volume nominal e o fluxo de sangue cessar, retire-o do suporte.
 10. Inverta 8 vezes.
 11. Retire a agulha da veia aplicando pressão no local de punção com um cotonete estéril e seco até a hemorragia parar.
 12. Depois de ocorrer a coagulação, aplique um penso, se desejar.
 13. Depois da punção venosa, o cimo da rolha pode conter sangue residual. Tome as precauções adequadas quando manipular os tubos para evitar o contacto com este sangue.
 14. Elimine a agulha e o suporte de acordo com a política e as normas da sua instituição.
 15. Armazene o PAXgene Blood DNA Tube cheio à temperatura ambiente (18-25°C). Consulte as Características de desempenho para obter informações sobre a estabilidade do ADN em amostras de sangue à temperatura ambiente (18-25°C), 2-8°C, ou -20°C.

Consulte o Procedimento para congelar e descongelar amostras em PAXgene Blood DNA Tubes para detalhes caso se pretendam temperaturas de armazenamento de -70°C / -80°C.

As técnicas que se seguem devem ser usadas para prevenir um possível refluxo de sangue:

- a. Coloque o braço do dador numa posição descendente.
- b. Segure no tubo com a rolha no nível mais elevado.
- c. Liberte o garrote assim que o sangue começar a fluir para o tubo.
- d. Certifique-se de que os aditivos do tubo não tocam na rolha ou na extremidade da agulha durante a punção venosa.

C. Procedimento para congelar e descongelar amostras colhidas em PAXgene Blood DNA Tubes

1. Coloque o PAXgene Blood DNA Tube na vertical, num suporte metálico. **Não congele os tubos na vertical num tabuleiro de espuma Styrofoam™, dado que tal pode fazer com que os tubos fissurem.**
2. Os PAXgene Blood DNA Tubes podem ser conservados a -20°C e temperaturas inferiores. Caso pretenda manter os tubos a temperaturas inferiores a -20°C, congele-os primeiro a -20°C durante 24 horas e depois transfira-os para -70°C ou -80°C.
3. Descongele os PAXgene Blood DNA Tubes num suporte metálico à temperatura ambiente (18-25°C) durante aproximadamente duas horas. **Não descongele os PAXgene Blood DNA Tubes a temperaturas superiores a 25°C.**
4. Inverta cuidadosamente os PAXgene Blood DNA Tubes descongelados 10 vezes.

Nota: Os PAXgene Blood DNA Tubes congelados estão sujeitos a quebra por impacto. Para reduzir o risco de quebra durante o transporte, os tubos congelados devem ser tratados como se fossem tubos de vidro. Os utilizadores devem validar o seu próprio protocolo de congelamento e transporte para os PAXgene Blood DNA Tubes.

D. Procedimento para preparação de amostras para análise

As amostras de sangue devem ser processadas de acordo com as instruções fornecidas com o kit de preparação de amostras de ADN. Para exemplos, consulte Informações para encomenda.

V. Características de desempenho

Após o sangue ser introduzido no tubo, o ADN permanece estável durante 14 dias entre 18°C e 25°C (Figura 1). Com base em estudos de estabilidade do ADN, o sangue pode ser armazenado no tubo durante 14 dias entre 18°C e 25°C, 28 dias entre 2°C e 8°C, 3 dias a 35°C ou durante um mínimo de 6 meses a -20°C com uma concentração de ADN $\geq 12,5$ ng/ μ l e uma pureza de ADN (A_{260}/A_{280}) de 1,7–1,9. Para os dados mais recentes sobre a estabilidade de amostras congeladas, consulte www.PreAnalytiX.com.

Estabilidade do ADN em amostras de sangue entre 18°C e 25°C

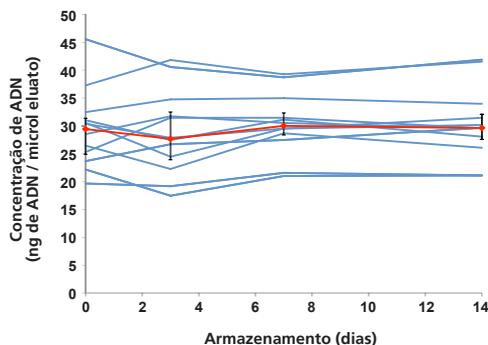


Figura 1

O sangue foi colhido em 12 dadores adultos com o seu consentimento e armazenado a 18-25°C durante o número de dias indicado, seguindo-se a purificação do ADN total. O sangue foi colhido e armazenado em PAXgene Blood DNA Tubes e o ADN total foi purificado utilizando o QIAGEN® QIASymphony® DSP DNA Mini Kit no instrumento automatizado QIAGEN QIASymphony.

VI. Limitações

1. A quantidade de sangue colhida deve ser de 2,5 mL por PAXgene Blood DNA Tube, mas este volume pode variar com a altitude, temperatura ambiente, pressão barométrica, idade do tubo, pressão venosa e técnica de enchimento.

(continuação)


VII. Precauções

1. Seguir as precauções universais. Usar luvas, batas, protecção ocular, outro equipamento protector pessoal e controlos de engenharia para proteger contra salpicos de sangue, fugas de sangue e potencial exposição a agentes patogénicos transmitidos pelo sangue.
2. Manipular todas as amostras biológicas e conjuntos de colheita de sangue "aguçados" de acordo com as políticas e procedimentos da instituição. Procurar assistência médica adequada em caso de qualquer exposição a amostras biológicas (por exemplo, através de uma lesão por picada), dado que estas podem transmitir hepatite viral, infecção por VIH (SIDA) ou outras doenças infecciosas.
Utilizar a protecção integrada na agulha quando o conjunto de colheita estiver equipado com essa função. A PreAnalytiX não recomenda que se voltem a tapar agulhas usadas. Todavia, as políticas e procedimentos da instituição podem diferir e devem ser sempre cumpridos.
3. Descartar todos os tubos de colheita de sangue em recipientes aprovados para eliminação de materiais que apresentem perigo biológico.
4. Não reutilizar os PAXgene Blood DNA Tubes.
5. Não utilizar os PAXgene Blood DNA Tubes depois do final do prazo de validade impresso no rótulo do tubo.
6. Uma velocidade de centrifugação excessiva (superior a 10.000 RPM) pode fazer com que o PAXgene Blood DNA Tube se quebre, com exposição ao sangue e possível lesão.
7. Não transferir uma amostra de uma seringa para um tubo.

VIII. Armazenamento

1. Conserve os PAXgene Blood DNA Tubes não usados entre 18°C e 25°C. São permitidas temperaturas de excursão limitadas até 40°C. Não utilize os tubos findo o prazo de validade.


IX. Instruções para remoção da Tampa BD Hemogard



1. Segure o PAXgene Blood DNA Tube com uma mão, colocando o polegar por baixo da Tampa BD Hemogard. (Para maior estabilidade, coloque o braço numa superfície fixa). Com a outra mão, rode a Tampa BD Hemogard utilizando simultaneamente o polegar da outra mão para empurrar para cima **APENAS ATÉ A TAMPA DO TUBO FICAR SOLTA**.

2. Afaste o polegar antes de levantar a tampa. **NÃO** utilize o polegar para afastar a tampa do tubo. Se o tubo contiver sangue, verifica-se um perigo de exposição. Para ajudar a evitar lesões durante a remoção da tampa, é importante que afaste do tubo o polegar que utilizou para empurrar a tampa para cima assim que a Tampa BD Hemogard ficar solta.
3. Afaste a tampa do tubo. Na improbabilidade de a protecção de plástico se separar da rolha de borracha, **NÃO VOLTE A MONTAR A TAMPA**. Remova cuidadosamente o batente de borracha do tubo.

X. Instruções para reinserção da Tampa BD Hemogard



1. Volte a colocar a tampa sobre o tubo.
2. Rode e empurre firmemente até que a rolha fique completamente assente. A reintrodução total da rolha é necessária para que a tampa se mantenha firmemente presa no tubo durante o manuseamento.

Assistência Técnica

Em caso de dúvidas relativamente ao PAXgene Blood DNA Tube, contacte um dos Departamentos de Assistência Técnica da BD referidos na secção BD – Atendimento ao consumidor.

Informações para encomenda

Produtos PAXgene

PAXgene Blood DNA Tube / 761165

Conteúdo: 1000 tubos de colheita de sangue.

Produtos da BD*

Agulha para Colheita de Sangue BD Vacutainer Eclipse / 368609 CE

Conteúdo: Agulha de 21G 1¼", 0,8 mm x 32 mm, 48/caixa, 480/embalagem

Agulha para Colheita de Sangue BD Vacutainer Eclipse com Suporte Pré-fixado / 368650

Conteúdo: Agulha de 21G 1¼", 0,8 mm x 32 mm, 100/embalagem

Agulha para Colheita de Sangue BD Vacutainer Eclipse Signal / 368835 CE

Conteúdo: Agulha de 21G 1¼", 0,8 mm x 32 mm, 50/caixa, 400/embalagem

Suporte de Utilização Única BD Vacutainer / 364815

Conteúdo: Apenas embalagem para 13 mm e 16 mm de diâmetro, 1000/embalagem

* Estes números de catálogo representam produtos típicos que podem ser usados com o PAXgene Blood DNA Tube.

Para encomendar acessórios de colheita de sangue BD:

Vá a: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Escolha o país • Desloque-se para baixo, até BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Marque o número

Produtos da QIAGEN*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Conteúdo: Cartucho de reagente, suporte enzimático, tampa perfurada, tampão ATE, conjunto de vedantes reutilizáveis

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Conteúdo: Colunas de agitação QIAamp Mini, tubos de colheita, tampão AL, tampão ATL, tampão AW1, tampão AW2, tampão AE, protease QIAGEN, solvente de protease

QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit / 158422 (3 mL) / 158445 (30 mL) / 158467 (120 mL) / 158389 (1000 mL)

Conteúdo: Solução de lise de eritrócitos, solução de lise celular, solução de precipitação de proteínas, solução de hidratação de ADN, solução de RNase A

* Estes números de catálogo representam kits típicos de preparação de ADN que podem ser usados com o PAXgene Blood DNA Tube.

Para encomendar produtos de preparação de ADN da QIAGEN:

Vá a: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

O PAXgene Blood DNA Tube é fabricado no Reino Unido pela BD para PreAnalytiX GmbH. PAXgene e PreAnalytiX são marcas comerciais da PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene são marcas comerciais da QIAGEN NV; Styrofoam é uma marca comercial da The Dow Chemical Company; todas as outras marcas comerciais são propriedade da Becton, Dickinson and Company.

(continuação)

BD – Atendimento ao consumidor

Argentina, Uruguai e Paraguai

Encomendas: 011.4551.7100
E-mail: crc_argentina@bd.com

Austrália

Encomendas: 1.800.656. 100
Fax: 1.800.656.110
E-mail: bd_anz@bd.com

Áustria

Encomendas: 43.1.7063660
Fax: 43.1.7063660-11
Bélgica
Encomendas: 32.53.720.556
Fax: 32.53.720.549

Brasil

Encomendas: 0800.055.5654
E-mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Canadá

Encomendas: 800.268.5430
Fax: 800.565.0897
E-mail: custsvccan@bd.com

Dinamarca

Encomendas: 45.43.43.45.66
Fax: 45.43.96.56.76
E-mail: bdcv_dk@europe.bd.com

Europa de Leste

Encomendas: 48.22.651.75.88
Fax: 48.22.651.75.89

Finlândia

Encomendas: 358.9.88.70.780
Fax: 358.9.88.70.7816
E-mail: bdorder_finland@europe.bd.com

França

Encomendas: 33.476.689496
Fax: 33.476.683693
E-mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Alemanha

Encomendas: 49.6221305553
Fax: 49.6221305379

Itália

Encomendas: 39.02.48.240.500
Fax: 39.02.48.240.344
Assistência Técnica: 39.02.48.240.264
E-mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Médio Oriente e África (EMA)

Encomendas: 971.4.3379525
Fax: 971.4.03379551
E-mail: EMA_PAS@bd.com

Países Baixos

Encomendas: 31.20.6545.716
Fax: 31.20.5829.421
E-mail: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Nova Zelândia

Encomendas: 0800.572.468
Fax: 0800.572.469
E-mail: bd_anz@bd.com

Noruega

Encomendas: 47.73.59.12.00
Fax: 47.73.59.12.01

Espanha

Encomendas: 34.902.27.17.27
Fax: 34.91.848.81.04
E-mail: servicio_de_clientes@bd.com

Suécia

Encomendas: 46.8.775.51.60
Fax 46: 8.775.51.95
E-mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Suíça

Encomendas: 41.61.4852222
Encomendas: 41.61.4852200

Reino Unido

Encomendas: 44.1.865.781.666
Fax: 44.1.865.717.313
E-mail: bduk_customerservice@europe.bd.com

EUA

Encomendas: 888.237.2762
Fax: 800.847.2220
Assistência Técnica: 800.631.0174
E-mail: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Atendimento ao consumidor

Austrália

Encomendas: 03.9840.9800

Fax: 03.9840.9888

Assistência Técnica: 1.800.243.066

Áustria

Encomendas: 0800/28.10.10

Fax: 0800/28.10.19

Assistência Técnica: 0800/28.10.11

Bélgica

Encomendas: 0800.79612

Fax: 0800.79611

Assistência Técnica: 0800.79556

Canadá

Encomendas: 800.572.9613

Fax: 800.713.5951

Assistência Técnica: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

China

Encomendas: 0086.21.3865.3865

Fax: 0086.21.3865.3965

Assistência Técnica: 800.988.0325 / 800.988.0327

Dinamarca

Encomendas: 80.885945

Fax: 80.885944

Assistência Técnica: 80.885942

Finlândia

Encomendas: 0800.914416

Fax: 0800.914415

Assistência Técnica: 0800.914413

França

Encomendas: 01.60.920.926

Fax: 01.60.920.925

Assistência Técnica: 01.60.920.930

Ofertas: 01.60.920.928

Alemanha

Encomendas: 02103.29.12000

Fax: 02103.29.22000

Assistência Técnica: 02103.29.12400

Hong Kong

Encomendas: 800.933.965

Fax: 800.930.439

Assistência Técnica: 800.930.425

Irlanda

Encomendas: 1800.555.049

Fax: 1800.555.048

Assistência Técnica: 1800.555.061

Itália

Encomendas: 02.33430411

Fax: 02.33430426

Assistência Técnica: 800.787980

Japão

Telefone: 03.5547.0811

Fax: 03.5547.0818

Assistência Técnica: 03.5547.0811

Coreia (Sul)

Encomendas: 1544.7145

Fax: 1544.7146

Assistência Técnica: 1544.7145

Luxemburgo

Encomendas: 8002.2076

Fax: 8002.2073

Assistência Técnica: 8002.2067

Países Baixos

Encomendas: 0800.0229592

Fax: 0800.0229593

Assistência Técnica: 0800.0229602

Noruega

Encomendas: 800.18859

Fax: 800.18817

Assistência Técnica: 800.18712

Singapura

Encomendas: 65.67775366

Fax: 65.67785177

Assistência Técnica: 65.67775366

Espanha

Encomendas: 91.630.7050

Fax: 91.630.5145

Assistência Técnica: 91.630.7050

Suécia

Encomendas: 020.790282

Fax: 020.790582

Assistência Técnica: 020.798328

Suíça

Encomendas: 055.254.22.11

Fax: 055.254.22.13

Assistência Técnica: 055.254.22.12

Reino Unido

Encomendas: 01293.422.911

Fax: 01293.422.922

Assistência Técnica: 01293.422.999

EUA

Encomendas: 800.426.8157

Fax: 800.718.2056

Assistência Técnica: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Eprubetă pentru ADN sangvin

RO – Română

I. Domeniu de utilizare

Eprubeta PAXgene pentru ADN sangvin se utilizează pentru recoltarea, tratarea cu anticoagulante, stabilizarea, transportarea și depozitarea unei probe de sânge integral obținut prin puncție venoasă, în vederea pregătirii unui probe de ADN de calitate superioară pentru utilizarea cu metode de diagnostic molecular pentru care sunt necesare probe de ADN.

Nu s-au stabilit caracteristicile privind performanțele acestui dispozitiv pentru testele de diagnostic molecular în general. Utilizatorii trebuie să verifice dacă produsul poate fi utilizat pentru testul de diagnostic molecular pe care doresc să îl efectueze.

Caracteristicile produsului

Eprubetă PAXgene pentru ADN sangvin • 2,5 ml • 13 x 75 mm • aditiv K₂EDTA
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 eprubete/cutie din carton • 1000 eprubete/ladă

II. Rezumat și explicație

Eprubeta PAXgene pentru ADN sangvin oferă o metodă de recoltare a sângelui integral pentru izolarea ADN-ului genomic într-un sistem etanș și vidat. Sângele se recoltează printr-un protocol standard de flebotomie într-o eprubetă vidată care conține aditiv K₂EDTA de aditiv. Izolarea completă a ADN-ului se realizează prin metode manuale sau automate, cum ar fi precipitarea prin desalinizare, particulele magnetice sau tehnologiile bazate pe membrană de siliciu.

III. Avertismente

Conținutul acestei eprubete irită pielea.

- În cazul inhalării, mutați persoana expusă într-un spațiu cu aer curat.
- În cazul contactului cu pielea, clătiți imediat pielea cu apă și săpun din abundență, timp de cel puțin 15 minute.
- În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență, timp de cel puțin 15 minute.
- În cazul înghițirii, administrați imediat cantități mari de apă. Solicitați îngrijiri medicale.


IV. Recoltarea și pregătirea probelor pentru analiză

A. Accesoriile necesare recoltării sângelui (neincluse cu eprubetele PAXgene pentru ADN sangvin)

1. Ac pentru recoltarea sângelui, cum ar fi acul BD Vacutainer® Eclipse™ pentru recoltarea sângelui sau acul BD Vacutainer Eclipse Signal™ pentru recoltarea sângelui. Vezi Informații pentru comandă.
2. În vederea asigurării funcționării corespunzătoare, trebuie utilizat un suport pentru ac BD Vacutainer. Vezi Informații pentru comandă.
3. Etichete pentru identificarea mostrelor provenite de la donatori pozitivi, dacă este necesar
4. Tampon cu alcool pentru dezinfectarea locului
5. Compresă sterilă uscată
6. Garou
7. Container pentru eliminarea acelor sau a combinației ac/suport

(continuare)

B. Procedură pentru recoltarea probelor



Instrucțiuni generale

PURTAȚI MĂNUȘI ÎN TIMPUL PUNCȚIEI VENOASE ȘI ATUNCI CÂND MANIPULAȚI EPRUBETE DE RECOLTARE A SÂNGELUI, PENTRU A REDUCE LA MINIMUM RISCUL DE EXPUNERE.

1. Asamblați acul în suport. Asigurați-vă că acul este fixat bine, pentru ca acesta să nu se deșurubeze în timpul utilizării.
2. Introduceți eprubeta în suport. Notă: Nu înțepați dopul.
3. Alegeți locul pentru puncția venoasă.
4. **Aplicați garoul. Pregătiți locul de puncție venoasă folosind un antiseptic adecvat. NU PALPAȚI ZONA DE PUNCȚIE VENOASĂ DUPĂ CURĂȚARE.**
5. Așezați brațul pacientului orientat în jos.
6. Scoateți capacul acului. Efectuați puncția venoasă CU BRAȚUL ÎN JOS, IAR DOPUL EPRUBETEI ÎN POZIȚIA CEA MAI DE SUS.
7. Centrați eprubetele în suport la penetrarea dopului, pentru a preveni penetrarea peretelui lateral și pierderea prematură a vidului. Împingeți eprubeta pe ac, înțepând diafragma dopului.
8. **ÎNDEPĂRTAȚI GAROUL DE ÎNDATĂ CE APARE SÂNGE ÎN EPRUBETĂ. NU LĂSAȚI CONȚINUTUL EPRUBETEI SĂ VINĂ ÎN CONTACT CU DOPUL SAU CU CAPĂȚUL ACULUI ÎN TIMPUL PROCEDURII.**

Notă: Uneori se poate scurge sânge din manșonul acului. Luați măsurile de precauție universale pentru a reduce la minimum riscul de expunere. Dacă nu curge deloc sânge în eprubetă sau dacă sângele se oprește din curs înainte de a fi recoltată o probă corespunzătoare, se recomandă pașii de mai jos pentru a realiza o recoltare satisfăcătoare:

- a. Împingeți eprubeta în față până la penetrarea dopului eprubetei. Dacă este necesar, țineți-o pentru a asigura extragerea completă a vidului.
 - b. Verificați dacă este corect poziționat acul în venă.
9. Când eprubeta s-a umplut până la volumul menționat, iar curgerea sângelui se oprește, scoateți-o din suport.
 10. Ranversați eprubeta de 8 ori.
 11. Scoateți acul din venă, aplicând presiune cu compresa sterilă uscată în locul unde se face puncția până când se oprește sângerarea.
 12. Odată produsă coagularea, aplicați un bandaj dacă se dorește acest lucru.
 13. După puncția venoasă, partea de sus a dopului poate conține sânge rezidual. Luați măsurile de precauție adecvate când manipulați eprubetele, pentru a evita contactul cu acest sânge.
 14. Eliminați acul și suportul conform politicii și recomandărilor în vigoare în unitatea dumneavoastră.
 15. Păstrați eprubeta PAXgene pentru ADN sangvin plină la temperatura camerei (18-25°C). Vezi caracteristicile privind performanțele pentru stabilitatea ADN în probele de sânge la temperatura camerei (18-25°C), 2-8°C sau -20°C.

Pentru detalii, vezi procedeul pentru congelarea și decongelarea probelor în eprubetele PAXgene pentru ADN sangvin dacă se dorește o temperatură de păstrare de -70°C/-80°C.

În vederea prevenirii eventualei reflux, se vor utiliza următoarele tehnici:

1. Poziționați în jos brațul donatorului.
2. Țineți eprubeta cu dopul în partea cea mai de sus.
3. Eliberați garoul imediat ce sângele începe să curgă în eprubetă.
4. Asigurați-vă ca aditivii din eprubetă să nu atingă dopul sau capătul acului în timpul puncției venoase.

C. Procedeu pentru congelarea și decongelarea probelor recoltate în eprubetele PAXgene pentru ADN sangvin

1. Plasați eprubeta PAXgene pentru ADN sangvin în poziție verticală, pe un stativ din sârmă. **Nu congelați eprubetele ținute vertical pe o tavă de polistiren expandat Styrofoam™, deoarece aceasta poate duce la crăparea acestora.**
2. Eprubetele PAXgene pentru ADN sangvin pot fi păstrate la temperaturi de -20°C și chiar mai scăzute. Dacă eprubetele sunt păstrate la temperaturi de sub -20°C, întâi congelați-le la -20°C pentru 24 de ore, apoi transferați-le la -70°C sau -80°C.
3. Decongelați eprubetele PAXgene® pentru ADN sangvin într-un stativ de sârmă la temperatura camerei (18-25°C) timp de aproximativ două ore. **Nu decongelați eprubetele PAXgene pentru ADN sangvin la temperaturi de peste 25°C.**
4. Ranversați cu grijă de 10 ori eprubetele PAXgene pentru ADN sangvin decongelate.

Notă: Eprubetele PAXgene pentru ADN sangvin congelate se pot sparge la lovire. În vederea reducerii riscului casării în timpul transportului, eprubetele congelate trebuie tratate în același mod ca eprubetele de sticlă. Utilizatorii trebuie să-și valideze propriile lor protocoale pentru congelarea și transportul eprubetelor PAXgene pentru ADN sangvin.

D. Procedeu pentru pregătirea probei pentru analiză

Probele de sânge trebuie să fie prelucrate în conformitate cu instrucțiunile date în trusa pentru pregătirea probelor de ADN. Pentru exemple, vezi Informații pentru comandă.

V. Caracteristici de performanță

După introducerea sângelui în eprubetă, ADN-ul rămâne stabil timp de 14 zile la 18-25°C (Figura 1). Pe baza studiilor privind stabilitatea ADN, sângele poate fi depozitat în eprubetă timp de 14 zile la 18-25°C, 28 de zile la 2-8°C, 3 zile la 35°C sau pentru minimum 6 luni la -20°C cu o concentrație ADN $\geq 12,5$ ng/ μ l și puritate ADN (A_{260}/A_{280}) de 1,7-1,9.

Pentru datele cele mai recente privind stabilitatea probelor congelate vezi www.PreAnalytiX.com.

Stabilitatea ADN în probe de sânge la 18-25°C

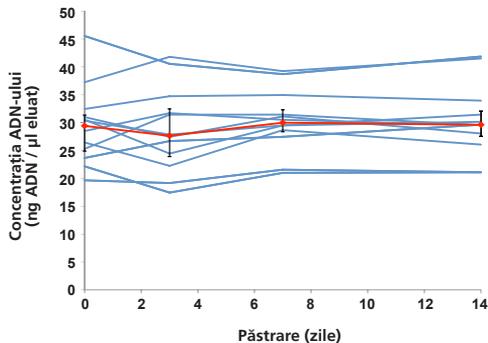


Figura 1

(continuare)

S-a recoltat sânge de la 12 donatori adulți care și-au dat acordul, acesta fiind depozitat la 18-25°C pentru numărul de zile indicat, urmat de purificarea totală a ADN-ului. Sângele a fost recoltat și păstrat în eprubete PAXgene pentru ADN sangvin, iar ADN-ul total a fost purificat folosind trusa mini pentru ADN QIAGEN® QIASymphony® DSP din instrumentul automat QIAGEN QIASymphony.

VI. Restricții

1. Cantitatea de sânge recoltat trebuie să fie de 2,5 ml pentru fiecare eprubetă PAXgene pentru ADN sangvin, dar acest volum poate varia în funcție de altitudine, temperatura camerei, presiunea barometrică, vârsta eprubetei, presiunea venoasă și tehnica de umplere.

VII. Precauții

1. Recurgeți la măsurile generale de precauție. Utilizați mănuși, halate, dispozitive de protecție pentru ochi, alte echipamente individuale de protecție și dispozitive tehnice pentru a preveni stropirea cu sânge, scurgerea sângelui și expunerea potențială la patogeni sanguini.
2. Manipulați toate probele biologice și obiectele ascuțite pentru recoltarea sângelui în conformitate cu politica și recomandările în vigoare în unitatea dumneavoastră. Acordați atenția medicală cuvenită în cazul oricărei expuneri la probe biologice (de exemplu dacă vă înțepați) deoarece probele pot transmite hepatită virală, HIV (SIDA) sau alte boli infecțioase.


Dacă setul de recoltare a sângelui este utilat cu apărător pentru ac, folosiți-l. PreAnalytix nu recomandă reintroducerea apărătorii pe acele care au fost folosite. Totuși, politicile și procedeele unității dumneavoastră pot să difere și trebuie respectate întotdeauna.

3. Dezafectați toate eprubetele folosite la recoltarea sângelui în containere special aprobate pentru deșeuri biologice periculoase.
4. Nu refolosiți eprubetele PAXgene pentru ADN sangvin.
5. Nu utilizați eprubetele PAXgene pentru ADN sangvin după data expirării menționată pe eticheta eprubetei.
6. Viteza excesivă de centrifugare (peste 10.000 RCF) poate duce la spargerea eprubetei PAXgene pentru ADN sangvin, expunerea la sânge și eventual accidentare.
7. Nu transferați probă din seringă în eprubetă.

VIII. Păstrare

1. Păstrați eprubetele PAXgene pentru ADN sangvin neutilizate la 18-25°C. Este permisă expunerea pentru un timp limitat la temperaturi de până la 40°C. Nu utilizați eprubetele după data de expirare.


IX. Instrucțiuni pentru îndepărtarea capacului BD Hemogard



1. Prindeți eprubeta PAXgene pentru ADN sangvin cu o mână, ținând degetul mare sub capacul BD Hemogard. (Pentru mai multă stabilitate, țineți brațul pe o suprafață solidă.) Cu cealaltă mână, răsuciți capacul BD Hemogard împingându-l în același timp în sus cu degetul mare de la cealaltă mână NUMAI PÂNĂ CÂND DOPUL EPRUBETEI ESTE SLĂBIT.
2. Îndepărtați degetul mare înainte de ridicarea capacului. NU scoateți capacul de pe eprubetă împingându-l cu degetul mare. Dacă eprubeta conține sânge, există un risc de expunere. Pentru a preveni accidentarea în timpul scoaterii capacului, este important ca degetul mare folosit pentru a împinge în sus capacul să fie îndepărtat de la eprubetă de îndată ce este slăbit capacul BD Hemogard.
3. Ridicați capacul de pe eprubetă. În situația improbabilă în care protecția de plastic se desface de pe dopul de cauciuc, NU REASAMBLAȚI CAPACUL. Scoateți cu grijă dopul de cauciuc de pe eprubetă.

(continuare)

X. Instrucțiuni pentru reintroducerea capacului BD Hemogard



1. Așezați la loc capacul pe eprubetă.
2. Răsuciți-l și împingeți-l ferm în jos până când dopul este reintrodus complet. Este necesară reintroducerea completă a dopului pentru a rămâne fixat capacul pe eprubetă în timpul manipulării.

Asistență tehnică

Pentru întrebări despre eprubeta PAXgene pentru ADN sangvin, contactați unul dintre Departamentele de servicii tehnice din cadrul BD din lista din secțiunea BD – Serviciul pentru clienți.

Informații pentru comandă

Produse PAXgene

Eprubetă PAXgene pentru ADN sangvin/761165

Conținut: 1.000 eprubete pentru recoltarea sângelui

Produse BD*

Ac BD Vacutainer Eclipse pentru recoltarea sângelui/368609 CE

Conținut: Ac de 1¼" țoli, de calibru 21G, 0,8 mm x 32 mm, 48/cutie, 480/ladă

Ac BD Vacutainer Eclipse pentru recoltarea sângelui cu suport montat în prealabil/368650

Conținut: Ac de 1¼" țoli, de calibru 21G, 0,8 mm x 32 mm, 100/ladă

Ac BD Vacutainer Eclipse Signal pentru recoltarea sângelui/368835 CE

Conținut: Ac de 1¼" țoli, de calibru 21G, 0,8 mm x 32 mm, 50/cutie, 400/ladă

Suport BD Vacutainer pentru utilizare unică/364815

Conținut: Ladă numai pentru diametre de 13 mm și 16 mm 1000/ladă

* Aceste numere de catalog reprezintă produse tipice care pot fi utilizate cu eprubeta PAXgene pentru ADN sangvin.

În vederea comandării accesoriilor BD pentru recoltarea sângelui:

Vizitați: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Selectați țara • Defilați în jos până la BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Formați numărul

Produse QIAGEN*

Trusă pentru ADN QIAGEN QIAAsymphony DSP/937255 trusă medie (96)/937236 trusă mini (192)

Conținut: Cartuș cu reactiv, stativ pentru enzime, capac cu orificii, soluție tampon ATE, set de etanșare pentru reutilizare

Trusă mini pentru ADN QIAGEN QIAamp® DSP/61104 (50)

Conținut: Coloane de centrifugare QIAamp Mini, eprubete de recoltare, soluție tampon AL, soluție tampon ATL, soluție tampon AW1, soluție tampon AW2, soluție tampon AE, protează QIAGEN, dizolvant cu protează

Trusă de recoltare QIAGEN Gentra® Puregene®/158422 (3 ml)/158445 (30 ml)/158467 (120 ml)/158389 (1000 ml)

Conținut: Soluție de liză pentru globulele roșii, soluție de liză celulară, soluție de precipitare a proteinelor, soluție de hidratare pentru ADN, soluție de ribonuclează A

* Aceste numere de catalog reprezintă seturi tipice pentru pregătirea ADN-ului, care pot fi utilizate cu eprubeta PAXgene pentru ADN sangvin.

Pentru a comanda trusele QIAGEN de pregătire a ADN-ului:

Vizitați: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

Eprubeta PAXgene pentru ADN sangvin este fabricată în Regatul Unit de firma BD pentru PreAnalytiX GmbH. PAXgene și PreAnalytiX sunt mărci înregistrate ale firmei PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene sunt mărci înregistrate ale firmei QIAGEN NV; Styrofoam este marcă înregistrată a firmei The Dow Chemical Company; toate celelalte mărci înregistrate sunt proprietatea firmei Becton, Dickinson and Company.

BD – Servicii pentru clienți

Argentina, Uruguay și Paraguay

Comenzi: 011.4551.7100
E-mail: crc_argentina@bd.com

Australia

Comenzi: 1.800.656.100
Fax: 1.800.656.110
E-mail: bd_anz@bd.com

Austria

Comenzi: 43.1.7063660
Fax: 43.1.7063660-11

Belgia

Comenzi: 32.53.720.556
Fax: 32.53.720.549

Brazilia

Comenzi: 0800.055.5654
E-mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Canada

Comenzi: 800.268.5430
Fax: 800.565.0897
E-mail: custsvccan@bd.com

Danemarca

Comenzi: 45.43.43.45.66
Fax: 45.43.96.56.76
E-mail: bdcs_dk@europe.bd.com

Europa de Est

Comenzi: 48.22.651.75.88
Fax: 48.22.651.75.89

Finlanda

Comenzi: 358.9.88.70.780
Fax: 358.9.88.70.7816
E-mail: bdorder_finland@europe.bd.com

Franța

Comenzi: 33.476.689496
Fax: 33.476.683693
E-mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Germania

Comenzi: 49.6221305553
Fax: 49.6221305379

Italia

Comenzi: 39.02.48.240.500
Fax: 39.02.48.240.344
Tehnic: 39.02.48.240.264
E-mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Orientul Mijlociu și Africa (EMA)

Comenzi: 971.4.3379525
Fax: 971.4.03379551
E-mail: EMA_PAS@bd.com

Olanda

Comenzi: 31.20.6545.716
Fax: 31.20.5829.421
E-mail: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Noua Zeelandă

Comenzi: 0800.572.468
Fax: 0800.572.469
E-mail: bd_anz@bd.com

Norvegia:

Comenzi: 47.73.59.12.00
Fax: 47.73.59.12.01

Spania

Comenzi: 34.902.27.17.27
Fax: 34.91.848.81.04
E-mail: servicio_de_clientes@bd.com

Suedia

Comenzi: 46.8.775.51.60
Fax 46: 8.775.51.95
E-mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Elveția

Comenzi: 41.61.4852222
Fax: 41.61.4852200

Regatul Unit

Comenzi: 44.1.865.781.666
Fax: 44.1.865.717.313
E-mail: bduk_customerservice@europe.bd.com

SUA

Comenzi: 888.237.2762
Fax: 800.847.2220
Tehnic: 800.631.0174
E-mail: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Serviciul pentru clienți

Australia

Comenzi: 03.9840.9800
Fax: 03.9840.9888
Tehnic: 1.800.243.066

Austria

Comenzi: 0800/28.10.10
Fax: 0800/28.10.19
Tehnic: 0800/28.10.11

Belgia

Comenzi: 0800.79612
Fax: 0800.79611
Tehnic: 0800.79556

Canada

Comenzi: 800.572.9613
Fax: 800.713.5951
Tehnic: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

China

Comenzi: 0086.21.3865.3865
Fax: 0086.21.3865.3965
Tehnic: 800.988.0325 / 800.988.0327

Danemarca

Comenzi: 80.885945
Fax: 80.885944
Tehnic: 80.885942

Finlanda

Comenzi: 0800.914416
Fax: 0800.914415
Tehnic: 0800.914413

Franța

Comenzi: 01.60.920.926
Fax: 01.60.920.925
Tehnic: 01.60.920.930
Oferte: 01.60.920.928

Germania

Comenzi: 02103.29.12000
Fax: 02103.29.22000
Tehnic: 02103.29.12400

Hong Kong

Comenzi: 800.933.965
Fax: 800.930.439
Tehnic: 800.930.425

Irlanda

Comenzi: 1800.555.049
Fax: 1800.555.048
Tehnic: 1800.555.061

Italia

Comenzi: 02.33430411
Fax: 02.33430426
Tehnic: 800.787980

Japonia

Telefon: 03.5547.0811
Fax: 03.5547.0818
Tehnic: 03.5547.0811

Coreea (de Sud)

Comenzi: 1544.7145
Fax: 1544.7146
Tehnic: 1544.7145

Luxemburg

Comenzi: 8002.2076
Fax: 8002.2073
Tehnic: 8002.2067

Olanda

Comenzi: 0800.0229592
Fax: 0800.0229593
Tehnic: 0800.0229602

Norvegia

Comenzi: 800.18859
Fax: 800.18817
Tehnic: 800.18712

Singapore

Comenzi: 65.67775366
Fax: 65.67785177
Tehnic: 65.67775366

Spania

Comenzi: 91.630.7050
Fax: 91.630.5145
Tehnic: 91.630.7050

Suedia

Comenzi: 020.790282
Fax: 020.790582
Tehnic: 020.798328

Elveția

Comenzi: 055.254.22.11
Fax: 055.254.22.13
Tehnic: 055.254.22.12

Regatul Unit

Comenzi: 01293.422.911
Fax: 01293.422.922
Tehnic: 01293.422.999

SUA

Comenzi: 800.426.8157
Fax: 800.718.2056
Tehnic: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Пробирка для взятия крови на ДНК

RU – Русский

I. Назначение

Пробирка для взятия крови PAXgene Blood DNA Tube предназначена для взятия, антикоагуляции, стабилизации, транспортировки и хранения образцов цельной венозной крови для выделения высококачественной ДНК для использования в молекулярных диагностических тестах, для проведения которых необходима ДНК.

Эксплуатационные качества этого устройства для молекулярной диагностики в целом не были установлены. В связи с этим пользователи должны удостовериться в пригодности продукта для конкретных молекулярно-диагностических анализов.

Характеристики продукта

Пробирка для взятия крови PAXgene Blood DNA Tube • 2,5 мл • 13 x 75 мм • реагент K₂EDTA 761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 пробирок в коробке • 1000 пробирок в ящике

II. Общие сведения и пояснения

Пробирка для взятия крови PAXgene Blood DNA Tube является средством для взятия образцов цельной крови с целью выделения геномной ДНК и представляет собой закрытую вакуумированную систему. Взятие крови осуществляется в соответствии со стандартным флеботомическим протоколом в вакуумированную пробирку, содержащую реагент K₂EDTA. Полное выделение ДНК осуществляется вручную или автоматизированным способом, например, посредством высаливания, использования магнитных микрошариков или кремнеземных мембран.

III. Предупреждения

Содержимое пробирки может оказывать раздражающее действие на кожу.

- В случае вдыхания вывести пострадавшего на свежий воздух.
- При попадании на кожу немедленно промыть кожу большим количеством воды с мылом в течение по крайней мере 15 минут.
- При попадании в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды в течение по крайней мере 15 минут.
- При проглатывании немедленно дать пострадавшему большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью.


IV. Взятие образцов и подготовка к анализу

A. Необходимые принадлежности для взятия крови (не входят в комплект пробирки PAXgene Blood DNA Tube)

1. Игла для взятия крови, например, BD Vacutainer® Eclipse™ Blood Collection Needle или BD Vacutainer Eclipse Signal™ Blood Collection Needle. См. раздел «Информация о заказе».
2. Для правильного функционирования необходимо использовать держатель иглы BD Vacutainer Needle Holder. См. раздел «Информация о заказе».
3. При необходимости — ярлыки для позитивной идентификации пациентов на образцах.
4. Смоченный спиртом тампон для очистки места прокола.
5. Сухая стерильная марлевая салфетка.
6. Жгут.
7. Контейнер для использованных игл или комбинаций игла/держатель.

(Продолжение)

В. Процедура взятия образцов



Общие инструкции

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ К МИНИМУМУ УГРОЗЫ КОНТАКТА С ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ВО ВРЕМЯ ВЕНЕПУНКЦИИ И МАНИПУЛЯЦИЙ С ПРОБИРКАМИ ДЛЯ ВЗЯТИЯ КРОВИ СЛЕДУЕТ НАДЕВАТЬ ПЕРЧАТКИ.

1. Вставьте иглу в держатель. Убедитесь, что игла прочно зафиксирована и не отсоединится во время использования.
2. Поместите пробирку в держатель. Примечание. Не прокалывайте пробку.
3. Выберите место для венеопункции.
4. Наложите жгут. Обработайте место венеопункции подходящим антисептиком. **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ОБЛАСТИ ВЕНЕПУНКЦИИ ПОСЛЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ.**
5. Опустите руку пациента вниз.
6. Снимите чехол с иглы. Выполните венеопункцию НА РУКЕ, НАПРАВЛЕННОЙ ВНИЗ, ДЕРЖА ПРОБИРКУ ПРОБКЕЙ ВВЕРХ.
7. При введении пробки расположите пробирку по центру держателя, чтобы предотвратить неровное введение и последующую преждевременную потерю вакуума. Наденьте пробирку на иглу, проколов перегородку пробки.
8. **СНИМИТЕ ЖГУТ, КАК ТОЛЬКО КРОВЬ НАЧНЕТ ПОСТУПАТЬ В ПРОБИРКУ. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СОДЕРЖИМОМУ ПРОБИРКИ КОНТАКТИРОВАТЬ С ПРОБКЕЙ ИЛИ КОНЦОМ ИГЛЫ.**

Примечание. Кровь может случайно протечь через муфту иглы. Соблюдайте общие меры предосторожности, чтобы свести к минимуму угрозу контакта с опасными веществами. В случае, если кровь не затекает в пробирку или перестает течь до достижения достаточного количества образца, то для завершения взятия рекомендуется выполнение следующих действий.

- a. Продвиньте пробирку вперед, прокалывая пробку. При необходимости зафиксируйте положение пробирки для обеспечения полного вакуумного вытягивания.
 - b. Убедитесь в правильном положении иглы в вене.
9. Если пробирка наполнилась до заданного уровня и поток крови прекратился, вытащите пробирку из держателя.
 10. Переверните 8 раз.
 11. Извлеките иглу из вены, прижав место прокола сухим стерильным тампоном до остановки кровотечения.
 12. После свертывания крови при желании наложите повязку.
 13. После венеопункции на верхней стороне пробки могут остаться следы крови. При работе с пробирками соблюдайте надлежащие меры предосторожности, чтобы избежать контакта с данной кровью.
 14. Утилизируйте иглу и держатель в соответствии с принципами и указаниями вашего учреждения.
 15. Храните заполненные пробирки PAXgene Blood DNA Tube при комнатной температуре (18–25°C). См. раздел «Рабочие характеристики» для получения информации о стабильности ДНК в образцах крови при комнатной температуре (18–25°C), 2–8°C, или –20°C.

См. раздел «Процедура замораживания и оттаивания образцов в пробирках PAXgene Blood DNA Tube», если температура хранения составляет –70°C / –80°C.

Для предотвращения возможного возврата крови следует использовать следующие методики:

- a. Опустите руку пациента вниз.
- b. Во время крови держите пробирку вертикально, ниже руки донора.

(Продолжение)

- c. Ослабить жгут, как только кровь начнет поступать в пробирку.
- d. Проследить за тем, чтобы находящиеся в пробирке реагенты не касались пробки и конца иглы во время венепункции.

C. Процедура замораживания и оттаивания образцов в пробирках PAXgene Blood DNA Tube

1. Поставьте пробирку PAXgene Blood DNA Tube вертикально в проволочный штатив. **Не замораживайте пробирки в вертикальном положении в пенопластовой подставке Styrofoam™, поскольку пробирки при этом могут лопнуть.**
2. Пробирки PAXgene Blood DNA Tube можно хранить при температуре -20°C и ниже. Если пробирки предполагается хранить при температуре ниже -20°C , необходимо сначала заморозить их при температуре -20°C в течение 24 часов, а затем перенести в температуру -70°C или -80°C .
3. Оттаивайте пробирки PAXgene Blood DNA Tube в проволочном штативе при температуре окружающей среды ($18-25^{\circ}\text{C}$) приблизительно два часа. **Не оттаивайте пробирки PAXgene Blood DNA Tube при температуре выше 25°C .**
4. Осторожно переверните оттаявшие пробирки PAXgene Blood DNA Tube 10 раз.

Примечание. Замороженные пробирки PAXgene Blood DNA Tube могут разбиться при ударе. Чтобы уменьшить риск разбить замороженные пробирки при транспортировке, с ними необходимо обращаться как со стеклянными. Пользователи должны утверждать собственные протоколы замораживания и транспортировки для пробирок PAXgene Blood DNA Tube.

D. Процедура подготовки образцов для анализа

Обработку образцов крови необходимо произвести в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к комплекту DNA sample preparation kit. Примеры см. в разделе «Информация о заказе».

V. Рабочие характеристики

После взятия крови в пробирку ДНК остается стабильной в течение 14 дней при температуре от 18°C до 25°C (рис. 1). Из исследований стабильности ДНК известно, что кровь можно хранить в пробирке в течение 14 дней при температуре от 18°C до 25°C , 28 дней при температуре от 2°C до 8°C , 3 дня при температуре 35°C и минимум 6 месяцев при температуре -20°C с концентрацией ДНК $\geq 12,5$ нг/мл и чистотой ДНК (A_{260}/A_{280}) 1,7–1,9.

Новейшие данные о стабильности замороженных образцов см. на сайте www.PreAnalytiX.com.

Стабильность ДНК в образцах крови при $18-25^{\circ}\text{C}$

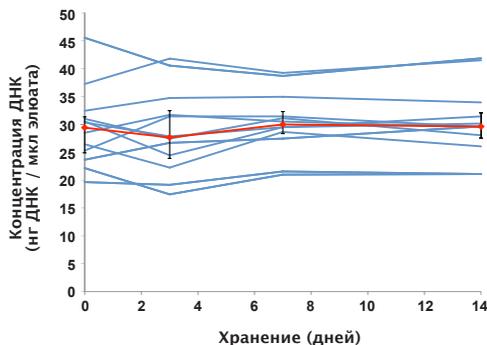


Рис. 1

Кровь брали у давших согласие 12 взрослых доноров и хранили при $18-25^{\circ}\text{C}$ в течение указанного числа дней, после чего проводили полную очистку ДНК. Кровь забирали и хранили в пробирках PAXgene Blood DNA Tube, а общую ДНК очищали с помощью набора QIAGEN® QIAAsymphony® DSP DNA Mini Kit на автоматической станции QIAGEN QIAAsymphony.

VI. Ограничения

1. Количество взятой крови должно составлять 2,5 мл на пробирку PAXgene Blood DNA Tube, однако оно может зависеть от высоты над уровнем моря, температуры окружающей среды, барометрического давления, времени, прошедшего с момента изготовления пробирки, венозного давления и техники заполнения.

VII. Меры предосторожности

1. Соблюдайте общие меры предосторожности. Для защиты от брызг и пролива крови и возможного воздействия содержащихся в крови патогенов использовать перчатки, халаты, средства защиты глаз и другие средства индивидуальной защиты, а также надлежащие технические меры.
2. Соблюдайте принятые в учреждении правила и процедуры по обращению с биологическими образцами и острыми предметами, используемыми при взятии крови. Немедленно обратитесь за соответствующей медицинской помощью в случае какого-либо контакта с биологическими образцами (например, укола), поскольку они могут быть источником заражения вирусным гепатитом, ВИЧ (СПИД) или другими инфекционными заболеваниями.


Используйте встроенное приспособление для защиты иглы, если набор для взятия крови оснащен таким приспособлением. PreAnalytiX не рекомендует надевать колпачки на использованные иглы. Однако правила и процедуры, принятые в вашем учреждении, могут быть другими, и их необходимо соблюдать в любом случае.

3. Выбрасывайте все пробирки для взятия крови в предназначенные для этого контейнеры для биологически опасных материалов.
4. Не используйте пробирки PAXgene Blood DNA Tube повторно.
5. Не используйте пробирки PAXgene Blood DNA Tube по истечении срока годности, указанного на этикетке пробирки.
6. При чрезмерно высокой (более 10 000 RCF) скорости центрифугирования возможно разрушение пробирки PAXgene Blood DNA Tube, контакт с кровью и травмы.
7. Не переносите образец из шприца в пробирку.

VIII. Условия хранения


1. Храните неиспользованные пробирки PAXgene Blood DNA Tube при температуре от 18°C до 25°C. Допускается повышение температуры до 40°C в течение ограниченного времени. Не используйте пробирки после истечения срока годности.

IX. Инструкции по удалению крышки BD Hemogard



1. Возьмите пробирку PAXgene Blood DNA Tube одной рукой, расположив большой палец под крышкой BD Hemogard. (Для дополнительной устойчивости расположите руку на твердой поверхности.) Другой рукой поворачивайте крышку BD Hemogard, одновременно толкая ее большим пальцем руки с пробиркой, ТОЛЬКО ЧТОБЫ РАСШАТАТЬ КРЫШКУ ПРОБИРКИ.
2. Уберите большой палец перед снятием крышки. НЕЛЬЗЯ использовать большой палец для снятия крышки с пробирки. Если в пробирке содержится кровь, существует угроза контакта с опасными веществами. Для предотвращения травм во время снятия крышки важно, чтобы большой палец, который выталкивал крышку, был отведен от пробирки сразу после расшатывания кBD Hemogard.
3. Вытяните крышку из пробирки. В маловероятном случае отделения пластиковой защиты от резиновой пробки НЕ СОБИРАЙТЕ КРЫШКУ ЗАНОВО. Осторожно извлеките резиновую пробку из пробирки.

Х. Инструкции по повторному введению крышки BD Hemogard



1. Расположите крышку над пробиркой.
2. Поворачивайте и вдавливайте крышку до полного притирания пробки. Полное повторное введение пробки требуется для того, чтобы крышка надежно сидела на пробирке во время ее перемещения.

Техническая помощь

В случае возникновения вопросов, касающихся пробирок PAXgene Blood DNA Tube, обратитесь в один из отделов технического обслуживания компании BD, перечисленных в разделе «BD — Служба поддержки клиентов».

Информация о заказе

Продукция PAXgene

Пробирка для взятия крови PAXgene Blood DNA Tube / 761165

Содержание: 1000 пробирок для взятия крови.

Продукция BD*

Игла для взятия крови BD Vacutainer Eclipse Blood Collection Needle / 368609 CE

Содержание: игла 21G 1¼" дюйма, 0,8 мм x 32 мм, 48 шт. в коробке, 480 шт. в упаковке

Игла для взятия крови с предварительно подсоединенным держателем BD Vacutainer Eclipse Blood Collection Needle / 368650

Содержание: игла 21G 1¼" дюйма, 0,8 мм x 32 мм, 100 шт. в упаковке

Игла для взятия крови BD Vacutainer Eclipse Signal Blood Collection Needle / 368835 CE

Содержание: игла 21G 1¼" дюйма, 0,8 мм x 32 мм, 50 шт. в коробке, 400 шт. в упаковке

Одноразовый держатель BD Vacutainer / 364815

Содержание: подходят для пробирок диаметром 13 мм и 16 мм, 1000 шт. в упаковке

* Эти позиции по каталогу соответствуют типичным продуктам, которые можно использовать с пробирками PAXgene Blood DNA Tube.

Для заказа принадлежностей BD для взятия крови:

Войдите на сайт <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

- Выберите страну
- Найдите раздел BD Diagnostics – Preanalytical Systems
- Позвоните по указанному номеру телефона

Продукция QIAGEN*

Набор для очистки ДНК QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Содержание: картридж с реагентом, фермент, прокалыватель крышки, буфер АТЕ, многоразовая система укупорки

Набор для очистки ДНК QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Содержание: миницентрифужные колонки QIAamp Mini, пробирки для взятия крови, буфер AL, буфер ATL, буфер AW1, буфер AW2, буфер АЕ, протеаза QIAGEN, растворитель протеазы

Набор QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit / 158422 (3 мл) / 158445 (30 мл) / 158467 (120 мл) / 158389 (1000 мл)

Содержание: лизирующий раствор RBC, раствор для клеточного лизиса, раствор для преципитации белка, раствор для гидратации ДНК, раствор РНКазы А

* Эти позиции по каталогу соответствуют типичным наборам для выделения ДНК, которые можно использовать с пробирками PAXgene Blood DNA Tube.

(Продолжение)

Для заказа наборов для выделения ДНК QIAGEN DNA Preparation Kits:

Войдите на сайт <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

Пробирки PAXgene Blood DNA Tube производятся в Великобритании компанией BD для PreAnalytiX GmbH. PAXgene и PreAnalytiX являются товарными знаками компании PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIAamp, QIAamp, QIAamp, QIAamp, QIAamp являются товарными знаками компании QIAGEN NV; Styrofoam является товарным знаком компании The Dow Chemical Company; все другие товарные знаки являются собственностью Becton, Dickinson and Company.

BD — Служба поддержки клиентов

Аргентина, Уругвай и Парагвай

Заказы по тел.: 011.4551.7100
E-mail: crc_argentina@bd.com

Австралия

Заказы по тел.: 1.800.656.100
Факс: 1.800.656.110
E-mail: bd_anz@bd.com

Австрия

Заказы по тел.: 43.1.7063660
Факс: 43.1.7063660-11

Бельгия

Заказы по тел.: 32.53.720.556
Факс: 32.53.720.549

Бразилия

Заказы по тел.: 0800.055.5654
E-mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Канада

Заказы по тел.: 800.268.5430
Факс: 800.565.0897
E-mail: custsvccan@bd.com

Дания

Заказы по тел.: 45.43.43.45.66
Факс: 45.43.96.56.76
E-mail: bdcs_dk@europe.bd.com

Восточная Европа

Заказы по тел.: 48.22.651.75.88
Факс: 48.22.651.75.89

Финляндия

Заказы по тел.: 358.9.88.70.780
Факс: 358.9.88.70.7816
E-mail: bdorder_finland@europe.bd.com

Франция

Заказы по тел.: 33.476.689496
Факс: 33.476.683693
E-mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Германия

Заказы по тел.: 49.6221305553
Факс: 49.6221305379

Италия

Заказы по тел.: 39.02.48.240.500
Факс: 39.02.48.240.344
Технические вопросы: 39.02.48.240.264
E-mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Ближний Восток и Африка (ЕМА)

Заказы по тел.: 971.4.3379525
Факс: 971.4.03379551
E-mail: EMA_PAS@bd.com

Нидерланды

Заказы по тел.: 31.20.6545.716
Факс: 31.20.5829.421
E-mail: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Новая Зеландия

Заказы по тел.: 0800.572.468
Факс: 0800.572.469
E-mail: bd_anz@bd.com

Норвегия

Заказы по тел.: 47.73.59.12.00
Факс: 47.73.59.12.01

Испания

Заказы по тел.: 34.902.27.17.27
Факс: 34.91.848.81.04
E-mail: servicio_de_clientes@bd.com

Швеция

Заказы по тел.: 46.8.775.51.60
Факс: 46.8.775.51.95
E-mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Швейцария

Заказы по тел.: 41.61.4852222
Заказы по тел.: 41.61.4852200

Великобритания

Заказы по тел.: 44.1.865.781.666
Факс: 44.1.865.717.313
E-mail: bduk_customerservice@europe.bd.com

США

Заказы по тел.: 888.237.2762
Факс: 800.847.2220
Технические вопросы: 800.631.0174
E-mail: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN — Служба поддержки клиентов

Австралия

Заказы по тел.: 03.9840.9800
Факс: 03.9840.9888
Технические вопросы: 1.800.243.066

Австрия

Заказы по тел.: 0800/28.10.10
Факс: 0800/28.10.19
Технические вопросы: 0800/28.10.11

Бельгия

Заказы по тел.: 0800.79612
Факс: 0800.79611
Технические вопросы: 0800.79556

Канада

Заказы по тел.: 800.572.9613
Факс: 800.713.5951
Технические вопросы: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Китай

Заказы по тел.: 0086.21.3865.3865
Факс: 0086.21.3865.3965
Технические вопросы: 800.988.0325 / 800.988.0327

Дания

Заказы по тел.: 80.885945
Факс: 80.885944
Технические вопросы: 80.885942

Финляндия

Заказы по тел.: 0800.914416
Факс: 0800.914415
Технические вопросы: 0800.914413

Франция

Заказы по тел.: 01.60.920.926
Факс: 01.60.920.925
Технические вопросы: 01.60.920.930
Предложения: 01.60.920.928

Германия

Заказы по тел.: 02103.29.12000
Факс: 02103.29.22000
Технические вопросы: 02103.29.12400

Гонконг

Заказы по тел.: 800.933.965
Факс: 800.930.439
Технические вопросы: 800.930.425

Ирландия

Заказы по тел.: 1800.555.049
Факс: 1800.555.048
Технические вопросы: 1800.555.061

Италия

Заказы по тел.: 02.33430411
Факс: 02.33430426
Технические вопросы: 800.787980

Япония

Тел.: 03.5547.0811
Факс: 03.5547.0818
Технические вопросы: 03.5547.0811

Корея (Южная)

Заказы по тел.: 1544.7145
Факс: 1544.7146
Технические вопросы: 1544.7145

Люксембург

Заказы по тел.: 8002.2076
Факс: 8002.2073
Технические вопросы: 8002.2067

Нидерланды

Заказы по тел.: 0800.0229592
Факс: 0800.0229593
Технические вопросы: 0800.0229602

Норвегия

Заказы по тел.: 800.18859
Факс: 800.18817
Технические вопросы: 800.18712

Сингапур

Заказы по тел.: 65.67775366
Факс: 65.67785177
Технические вопросы: 65.67775366

Испания

Заказы по тел.: 91.630.7050
Факс: 91.630.5145
Технические вопросы: 91.630.7050

Швеция

Заказы по тел.: 020.790282
Факс: 020.790582
Технические вопросы: 020.798328

Швейцария

Заказы по тел.: 055.254.22.11
Факс: 055.254.22.13
Технические вопросы: 055.254.22.12

Великобритания

Заказы по тел.: 01293.422.911
Факс: 01293.422.922
Технические вопросы: 01293.422.999

США

Заказы по тел.: 800.426.8157
Факс: 800.718.2056
Технические вопросы: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Skúmavka Blood DNA Tube

SK – Slovenský (jazyk)

I. Určené použitie

Skúmavka PAXgene Blood DNA Tube je určená na zber, antikoaguláciu, stabilizáciu, prepravu a uskladnenie vzoriek plnej žilovej krvi na prípravu vysokokvalitnej DNA, ktorá sa má použiť v testovacích metódach molekulárnej diagnostiky, ktoré si vyžadujú DNA.

Výkonnostné charakteristiky tohto zariadenia neboli vo všeobecnosti stanovené pre skúšky v rámci molekulárnej diagnostiky. Používatelia musia overiť, či sa ich produkt môže použiť v rámci konkrétnej skúšky molekulárnej diagnostiky.

Vlastnosti produktu

Skúmavka PAXgene Blood DNA Tube • 2,5 ml • 13 x 75 mm • prídavná látka K₂EDTA
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 ks skúmaviek/v kartónovej priehradke • 1 000 ks skúmaviek/v balení

II. Súhrn a vysvetlenie

Skúmavka PAXgene Blood DNA Tube predstavuje pomôcku na odber plnej krvi na izolovanie genómovej DNA v uzavretom evakuovanom systéme. Krv sa odoberá v rámci štandardných flebotomických postupov do evakuovanej skúmavky, ktorá obsahuje prídavnú látku K₂EDTA. Úplná izolácia DNA sa vykonáva pomocou manuálnych alebo automatizovaných metód, ako napríklad vysolovaním (forma zrážania), magnetickými guľičkami alebo technológiami na báze silikónovej membrány.

III. Varovania

Obsah skúmavky dráždi pokožku.

- Po vdýchnutí zabezpečte prívod čerstvého vzduchu.
- Po kontakte s pokožkou okamžite umyte vodou a mydlom a dôkladne opláchnite po dobu min. 15 minút.
- Po kontakte s očami okamžite umyte vodou a dôkladne opláchnite po dobu min. 15 minút.
- Po prehltnutí ihneď zapite veľkým množstvom vody. Vyhľadajte lekársku pomoc.

IV. Odber a príprava vzoriek na analýzu

A. Požadované príslušenstvo na odber krvi (nie je súčasťou skúmavky PAXgene Blood DNA Tube)

1. Skúmavka na odber krvi, napríklad ihla BD Vacutainer® Eclipse™ Blood Collection Needle alebo ihla BD Vacutainer Eclipse Signal™ Blood Collection Needle. Pozri časť Informácie ohľadom objednávania.
2. Musí sa používať držiak ihiel BD Vacutainer Needle Holder, aby sa zabezpečila správna funkčnosť. Pozri časť Informácie ohľadom objednávania.
3. Značky na identifikáciu vzoriek pozitívnych darcov, podľa potreby.
4. Tampón navlhčený alkoholom na čistenie miesta.
5. Čistá gáza.
6. Škrtdlo.
7. Odpadový kontajner na použité ihly alebo na ihly a držiaky.

B. Postup pri odbere vzoriek



Všeobecné pokyny

POČAS NAPICHNUTIA ŽILY A PRI MANIPULÁCII SO SKÚMAVKAMI NA ODBER KRVI POUŽÍVAJTE RUKAVICE, ABY STE MINIMALIZOVALI RIZIKO VYSTAVENIA.

1. Namontujte ihlu na držiak. Uistite sa, že je ihla pevne na svojom mieste, aby ste zabezpečili, že sa ihla počas používania nevykrúti zo závitu.
2. Vložte skúmavku do držiaka. Poznámka: Neprepichujte uzáver.
3. Zvoľte si miesto na napichnutie žily.
4. **Použite škrtidlo. Pripravte miesto napichnutia žily pomocou vhodného dezinfekčného prostriedku. MIESTO NAPICHNUTIA ŽILY PO VYČISTENÍ NECHYTAJTE.**
5. Nastavte ruku pacienta v smere nadol.
6. Vyberte kryt ihly. Napichnite žilu S RUKOU NASTAVENOU NADOL A UZÁVEROM SKÚMAVKY OTOČENÝM NAHOR.
7. Vycentrujte skúmavku v držiaku, keď preniknete cez uzáver, aby ste zabránili prieniku bočnej steny a následnej predčasnej strate vákuu. Zatlačte skúmavku na ihlu a prepichnete membránu uzáveru.
8. **ODSTRÁŇTE ŠKRTIDLO HNEĎ, AKO SA V SKÚMAVKE OBJAVÍ KRŤ. NEDOVOLTE, ABY SA OBSAH SKÚMAVKY POČAS TOHTO POSTUPU DOSTAL DO KONTAKTU S UZÁVEROM ALEBO KONCOM IHLY.**

Poznámka: Z obalu ihly môže príležitostne unikať krv. Použite univerzálne opatrenia na minimalizáciu rizika vystavenia. Ak do skúmavky netečie žiadna krv alebo ak krv prestane tiecť pred získaním potrebnej vzorky, navrhujú sa nasledujúce kroky pre vykonanie uspokojivého odberu:

- a. Zatlačte skúmavku dopredu, kým sa uzáver neprepichne. V prípade potreby ho podržte na mieste pre zabezpečenie kompletného odberu do vákuu.
 - b. Potvrďte správnu polohu ihly v žile.
9. Keď sa skúmavka naplní na uvedený objem a prietok krvi sa zastaví, vyberte ju z držiaka.
 10. Prevráťte skúmavku 8-krát.
 11. Vytiahnite ihlu zo žily tak, že pomocou sterilného tampónu zatlačíte na miesto vpichu, až kým sa krvácanie nezastaví.
 12. Keď dôjde k zrazeniu krvi, v prípade potreby použite bandáž.
 13. Po napichnutí žily sa môže vo vrchnej časti uzáveru nachádzať zvyšková krv. Prijmite vhodné opatrenia pri manipulácii so skúmavkami, aby ste sa vyhli kontaktu s touto krvou.
 14. Ihlu a držiak zlikvidujte podľa zásad a smerníc platných vo vašom zariadení.
 15. Naplnenú skúmavku PAXgene Blood DNA Tube skladujte pri izbovej teplote (18 až 25 °C). Pozrite parametre stability DNA v krvných vzorkách pri izbovej teplote (18 až 25 °C), 2 až 8 °C alebo -20 °C.

Ak je potrebná teplota skladovania -70 °C/-80 °C, viac informácií nájdete v časti Postup pri zmrazovaní a rozmrazovaní odobratých vzoriek v skúmavkách PAXgene Blood DNA Tubes.

Použite nasledujúce postupy, aby ste zabránili možnému spätnému toku:

- a. Nastavte ruku darcu smerom nadol.
- b. Podržte skúmavku s uzáverom v hornej polohe.
- c. Uvoľnite škrtidlo hneď, ako začne krv tiecť do skúmavky.
- d. Uistite sa, že prídavné látky v skúmavke sa nedotýkajú uzáveru alebo konca ihly počas napichnutia žily.

C. Postup pri zmrazovaní a rozmrazovaní odobratých vzoriek v skúmavkách PAXgene Blood DNA Tubes

1. Postavte skúmavku PAXgene Blood DNA Tube v drôtenom stojane do zvislej polohy. **Nezmrazujte skúmavku vo vzpriamenej polohe v polystyrénovom zásobníku, pretože to môže viesť k prasknutiu skúmavky.**

- Skúmavky PAXgene Blood DNA Tubes sa môžu skladovať pri teplote -20°C a nižšej. Ak sa skúmavky budú skladovať pri teplote nižšej ako -20°C , najskôr ich na 24 hodín zmrazte na teplotu -20°C a potom na teplotu -70°C alebo -80°C .
- Skúmavky PAXgene Blood DNA Tubes rozmrazujte v drôtenom stojane pri teplote okolia (18 až 25°C) približne dve hodiny. **Skúmavky nerozmrazujte PAXgene Blood DNA Tubes pri teplotách vyšších ako 25°C .**
- Rozmrazené skúmavky PAXgene Blood DNA Tube opatrne prevráťte 10-krát.

Poznámka: Zmrazené skúmavky PAXgene Blood DNA Tubes by v dôsledku nárazu mohli prasknúť. Ak chcete znížiť riziko prasknutia počas prepravy, so zmrazenými skúmavkami by ste mali zaobchádzať rovnako ako so sklenenými skúmavkami. Používatelia si musia overiť svoj vlastný protokol zmrazovania a prepravy pre skúmavky PAXgene Blood DNA Tubes.

D. Postup pri príprave vzoriek na analýzu


Vzorky krvi sa musia spracovať v súlade s pokynmi, ktoré sú priložené k súprave na prípravu vzoriek DNA. Príklady nájdete v časti Informácie ohľadom objednávania.

V. Výkonnostné charakteristiky

Po naplnení skúmavky krvou ostáva DNA stabilná počas 14 dní pri teplote 18 až 25°C (Obrázok 1). Podľa výsledkov štúdií zameraných na stabilitu DNA je krv možné skladovať v skúmavke po dobu 14 dní pri teplote 18 až 25°C , 28 dní pri teplote 2 až 8°C , 3 dni pri teplote 35°C a minimálne po dobu 6 mesiacov pri teplote -20°C , pokiaľ je koncentrácia DNA $\geq 12,5$ ng/ μl a čistota DNA (A_{260}/A_{280}) $1,7$ až $1,9$.

Najaktuálnejšie údaje o stabilite zmrazených vzoriek nájdete na webovej stránke www.PreAnalytiX.com.

Stabilita DNA vo vzorkách krvi pri teplote 18 až 25°C

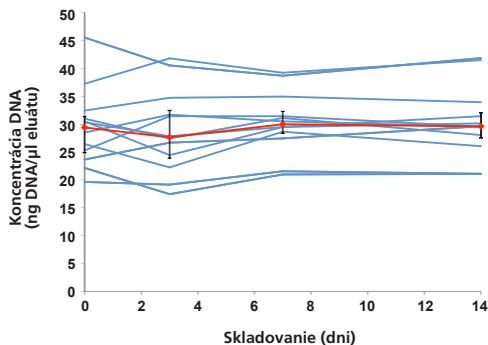

Obrázok 1:

Krv bola odobratá od 12 dobrovoľných dospelých darcov a skladovaná pri teplote 18 až 25°C počas uvedeného počtu dní a potom nasledovala purifikácia celkovej DNA. Krv bola odobratá a skladovaná v skúmavkách PAXgene Blood DNA Tubes a celková DNA bola purifikovaná pomocou súpravy QIAGEN® QIAAsymphony® DSP DNA Mini Kit na automatizovanom prístroji QIAGEN QIAAsymphony.

VI. Obmedzenia

- Množstvo odobratej krvi by malo byť $2,5$ ml na skúmavku PAXgene Blood DNA Tube, ale tento objem sa môže meniť v závislosti od nadmorskej výšky, teploty okolia, barometrického tlaku, veku skúmavky, venózneho tlaku a techniky plnenia.


VII. Upozornenia

1. Všeobecné pracovné opatrenia. Používajte rukavice, pracovné plášte, ochranné okuliare, iné osobné ochranné prostriedky a technologické pomôcky na ochranu proti postriekaniu krvou, zabráneniu úniku krvi a potenciálnemu vystaveniu krvným patogénom.
2. So všetkými biologickými vzorkami a súpravami na odber krvi zaobchádzajte v súlade s postupmi a predpismi vášho zariadenia. Ak dôjde k vystaveniu biologickej vzorky (napr. cez ranu v pokožke), vyhľadajte adekvátnu lekársku pomoc, pretože vzorky môžu prenášať vírusovú hepatitídu, HIV (AIDS), alebo iné infekčné choroby. Vždy použite zabudovaný chránič ihly, ak je súčasťou súpravy na odber. PreAnalytiX neodporúča opätovne nasunutie krytu na použité ihly. Predpisy vášho zariadenia sa však môžu v tomto bode líšiť a treba sa nimi vždy riadiť.
3. Všetky skúmavky na odber krvi zlikvidujte v odpadových nádobách schválených pre biologický odpad.
4. Nepoužívajte opakovane skúmavky PAXgene Blood DNA Tubes.
5. Nepoužívajte skúmavky PAXgene Blood DNA Tubes po dátume expirácie vytlačenom na štítku skúmavky.
6. Nadmerná rýchlosť odstredovania (viac ako 10 000 RCF) môže spôsobiť prasknutie skúmavky PAXgene Blood DNA Tube, vystavenie krvi a možné poranenie.
7. Neprenášajte vzorku zo striekačky do skúmavky.

VIII. Skladovanie

1. Nepoužité skúmavky PAXgene Blood DNA Tubes skladujte pri teplote od 18 do 25 °C. Povolené sú obmedzené zvýšenia teploty do 40 °C. Skúmavky nepoužívajte po dátume expirácie.


IX. Pokyny pre odstránenie uzáveru BD Hemogard Closure



1. Uchopte skúmavku PAXgene Blood DNA Tube jednou rukou a palec dajte pod uzáver BD Hemogard Closure. (Pre zabezpečenie stability si položte ruku na pevný povrch). Druhou rukou vytočte uzáver BD Hemogard Closure a súčasne ho palcom prvej ruky tlačte nahor, **LEN KÝM SA ZÁTKA SKÚMAVKY NEUVOĽNÍ.**

2. Pred vybráním uzáveru dajte palec preč. **NEPOUŽÍVAJTE** palec na vytlačenie uzáveru zo skúmavky. Ak skúmavka obsahuje krv, existuje nebezpečenstvo vystavenia. Ak chcete predísť poraneniu pri odstraňovaní uzáveru, je dôležité, aby ste palec, ktorým tlačíte uzáver nahor, ihneď po uvoľnení uzáveru BD Hemogard Closure uvoľnili zo skúmavky.
3. Vytiahnite uzáver zo skúmavky. V nepravdepodobnom prípade, kedy sa môže plastový kryt oddeliť od gumového uzáveru, **UZÁVER NEMONTUJTE NASPÄŤ.** Opatrne odstráňte gumový uzáver zo skúmavky.

X. Pokyny pre opätovné vloženie uzáveru BD Hemogard Closure



1. Vymeňte uzáver skúmavky.
2. Otočte a pevne zatlačte nadol, kým sa uzáver nedostane na svoje miesto. Uzáver je potrebné naspäť vložiť kompletne, aby mohol uzáver bezpečne zostať na skúmavke počas manipulácie.

Technická podpora

Ak máte otázky ohľadom skúmavky PAXgene Blood DNA Tube, obráťte sa na oddelenia technických služieb BD, ktoré nájdete v časti BD – Zákaznícky servis.

Informácie ohľadom objednávanía

Produkty PAXgene

Skúmavka PAXgene Blood DNA Tube/761165

Obsah: 1 000 ks skúmaviek na odber krvi.

Produkty BD*

Ihla na odber krvi BD Vacutainer Eclipse Blood Collection Needle/368609 CE

Obsah: Ihla 21 G 1¼ palcov, 0,8 mm x 32 mm, 48 ks/v krabici, 480 ks/v balení

Ihla na odber krvi BD Vacutainer Eclipse Blood Collection Needle s vopred pripojeným držiakom Pre-Attached Holder/368650

Obsah: Ihla 21 G 1¼ palcov, 0,8 mm x 32 mm, 100 ks/v balení

Ihla na odber krvi BD Vacutainer Eclipse Signal Blood Collection Needle/368835 CE

Obsah: Ihla 21 G 1¼ palcov, 0,8 mm x 32 mm, 50 ks/v krabici, 400 ks/v balení

Jednorázový držiak BD Vacutainer One Use Holder/364815

Obsah: Balenie len pre priemer 13 mm a 16mm, 1 000 ks/v balení

* *Tieto katalógové čísla predstavujú typické produkty, ktoré sa môžu použiť so skúmavkou PAXgene Blood DNA Tube.*

Ak chcete objednať príslušenstvo na odber krvi BD Blood Collection Accessories:

Prejdite na webovú stránku: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

- vyberte krajinu • posuňte sa smerom nadol na BD Diagnostics - Preanalytical Systems • vytočte príslušné telefónne číslo

Produkty QIAGEN*

Súprava QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kit/937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Obsah: Kazeta s reagenciou, stojan s enzýmom, perforované veko, bufer ATE, súprava na zapečatenie pri opakovanom použití

Súprava QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Obsah: kolóny spin QIAamp Mini, skúmavky na odber, bufer AL, bufer ATL, bufer AW1, bufer AW2, bufer AE, proteáza QIAGEN, rozpúšťadlo proteázy,

Súprava QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit/158422 (3 ml)/158445 (30 ml)/158467 (120 ml)/158389 (1000 ml)

Obsah: roztok na lýzu RBC, roztok na lýzu buniek, roztok na zrážanie bielkovín, roztok na hydratáciu DNA, roztok RNáza A

* *Tieto katalógové čísla predstavujú typické súpravy na prípravu DNA, ktoré sa môžu použiť so skúmavkou PAXgene Blood DNA Tube.*

Ak chcete objednať súpravy na prípravu DNA QIAGEN DNA Preparation Kits:

Prejdite na webovú stránku: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

Skúmavku PAXgene Blood DNA Tube vyrába vo Veľkej Británii BD pre spoločnosť PreAnalytiX GmbH. PAXgene a PreAnalytiX sú ochranné známky spoločnosti PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIAamp, Gentra, Puregene sú ochranné známky spoločnosti QIAGEN NV; polystyrén je ochranná známka spoločnosti The Dow Chemical Company a všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Becton, Dickinson and Company.

(Pokračovanie)

BD – Zákaznícky servis

Argentína, Uruguaj a Paraguaj

Objednávky: 011.4551.7100
E-mail: crc_argentina@bd.com

Austrália

Objednávky: 1.800.656. 100
Fax: 1.800.656.110
E-mail: bd_anz@bd.com

Rakúsko

Objednávky: 43.1.7063660
Fax: 43.1.7063660-11

Belgicko

Objednávky: 32.53.720.556
Fax: 32.53.720.549

Brazília

Objednávky: 0800.055.5654
E-mail: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Objednávky: 800.268.5430
Fax: 800.565.0897
E-mail: custsvccan@bd.com

Dánsko

Objednávky: 45.43.43.45.66
Fax: 45.43.96.56.76
E-mail: bdc_dk@europe.bd.com

Východná Európa

Objednávky: 48.22.651.75.88
Fax: 48.22.651.75.89

Fínsko

Objednávky: 358.9.88.70.780
Fax: 358.9.88.70.7816
E-mail: bdorder_finland@europe.bd.com

Francúzsko

Objednávky: 33.476.689496
Fax: 33.476.683693
E-mail: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Nemecko

Objednávky: 49.6221305553
Fax: 49.6221305379

Taliansko

Objednávky: 39.02.48.240.500
Fax: 39.02.48.240.344
Technická podpora: 39.02.48.240.264
E-mail: ordini_medicale@europe.bd.com

Stredný Východ a Afrika (EMA)

Objednávky: 971.4.3379525
Fax: 971.4.03379551
E-mail: EMA_PAS@bd.com

Holandsko

Objednávky: 31.20.6545.716
Fax: 31.20.5829.421
E-mail: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Nový Zéland

Objednávky: 0800.572.468
Fax: 0800.572.469
E-mail: bd_anz@bd.com

Nórsko:

Objednávky: 47.73.59.12.00
Fax: 47.73.59.12.01

Španielsko

Objednávky: 34.902.27.17.27
Fax: 34.91.848.81.04
E-mail: servicio_de_clientes@bd.com

Švédsko

Objednávky: 46.8.775.51.60
Fax 46: 8.775.51.95
E-mail: bdorder_sweden@europe.bd.com

Švajčiarsko

Objednávky: 41.61.4852222
Objednávky: 41.61.4852200

Spojené kráľovstvo

Objednávky: 44.1.865.781.666
Fax: 44.1.865.717.313
E-mail: bduk_customerservice@europe.bd.com

USA

Objednávky: 888.237.2762
Fax: 800.847.2220
Technická podpora: 800.631.0174
E-mail: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Zákaznický servis

Austrália

Objednávky: 03.9840.9800

Fax: 03.9840.9888

Technická podpora: 1.800.243.066

Rakúsko

Objednávky: 0800/28.10.10

Fax: 0800/28.10.19

Technická podpora: 0800/28.10.11

Belgicko

Objednávky: 0800.79612

Fax: 0800.79611

Technická podpora: 0800.79556

Kanada

Objednávky: 800.572.9613

Fax: 800.713.5951

Technická podpora: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Čína

Objednávky: 0086.21.3865.3865

Fax: 0086.21.3865.3965

Technická podpora: 800.988.0325 / 800.988.0327

Dánsko

Objednávky: 80.885945

Fax: 80.885944

Technická podpora: 80.885942

Fínsko

Objednávky: 0800.914416

Fax: 0800.914415

Technická podpora: 0800.914413

Francúzsko

Objednávky: 01.60.920.926

Fax: 01.60.920.925

Technická podpora: 01.60.920.930

Ponuky: 01.60.920.928

Nemecko

Objednávky: 02103.29.12000

Fax: 02103.29.22000

Technická podpora: 02103.29.12400

Hong Kong

Objednávky: 800.933.965

Fax: 800.930.439

Technická podpora: 800.930.425

Írsko

Objednávky: 1800.555.049

Fax: 1800.555.048

Technická podpora: 1800.555.061

Taliansko

Objednávky: 02.33430411

Fax: 02.33430426

Technická podpora: 800.787980

Japonsko

Telefón: 03.5547.0811

Fax: 03.5547.0818

Technická podpora: 03.5547.0811

Južná Kórea

Objednávky: 1544.7145

Fax: 1544.7146

Technická podpora: 1544.7145

Luxembursko

Objednávky: 8002.2076

Fax: 8002.2073

Technická podpora: 8002.2067

Holandsko

Objednávky: 0800.0229592

Fax: 0800.0229593

Technická podpora: 0800.0229602

Nórsko

Objednávky: 800.18859

Fax: 800.18817

Technická podpora: 800.18712

Singapur

Objednávky: 65.67775366

Fax: 65.67785177

Technická podpora: 65.67775366

Španielsko

Objednávky: 91.630.7050

Fax: 91.630.5145

Technická podpora: 91.630.7050

Švédsko

Objednávky: 020.790282

Fax: 020.790582

Technická podpora: 020.798328

Švajčiarsko

Objednávky: 055.254.22.11

Fax: 055.254.22.13

Technická podpora: 055.254.22.12

Spojené kráľovstvo

Objednávky: 01293.422.911

Fax: 01293.422.922

Technická podpora: 01293.422.999

USA

Objednávky: 800.426.8157

Fax: 800.718.2056

Technická podpora: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Epruveta za DNA v krvi

SL – Slovenski (jezik)

I. Namen uporabe

Epruveta PAXgene za DNA v krvi se uporablja za zbiranje, antikoaguliranje, stabiliziranje, prevoz in hrambo vzorcev venske polne krvi za pripravo visokokakovostne DNA za uporabo z molekularnimi metodami diagnostičnih preiskav, pri katerih je zahtevana DNA.

Lastnosti glede učinkovitosti tega pripomočka niso bile določene za molekularne diagnostične preiskave na splošno. Uporabniki morajo preveriti, ali je uporaba izdelka za specifično molekularno diagnostično preiskavo ustrezna.

Lastnosti izdelka

Epruveta PAXgene za DNA v krvi • 2,5 ml • 13 x 75 mm • aditiv K₂EDTA
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 epruvet/škatlo • 1.000 epruvet/zabojo

II. Povzetek in razlaga

Epruveta PAXgene za DNA v krvi predstavlja način za odvzem polne krvi za izolacijo genomske DNA v zaprtem vakuumskem sistemu. Kri se odvzame s standardnim protokolom flebotomije v vakuumsko epruveto, ki vsebuje aditiv K₂EDTA. Popolna izolacija DNA se izvede z ročnimi ali avtomatskimi metodami, kot so obarjanje (izsoljevanje), magnetne kroglice ali tehnologije na osnovi silicijevo-dioksidne membrane.

III. Opozorila

Vsebina te epruvete draži kožo.


- V primeru vdihavanja izpostavljeno osebo peljite na svež zrak.
- V primeru stika s kožo takoj začnite z izpiranjem prizadetega mesta na koži z veliko količino mila in vode ter izpirajte najmanj 15 minut.
- V primeru stika z očmi takoj začnite z izpiranjem z veliko količino vode ter izpirajte najmanj 15 minut.
- V primeru zaužitja takoj zaužite velike količine vode. Poiščite zdravniško pomoč.

IV. Odvzem vzorca in priprava za analizo

A. Pripomočki, potrebni za odvzem krvi (niso priloženi epruveti PAXgene za DNA v krvi)

1. Igla za odvzem krvi, kot sta igla za odvzem krvi BD Vacutainer® Eclipse™ ali igla za odvzem krvi BD Vacutainer Eclipse Signal™. Glejte Informacije za naročanje.
2. Za zagotovitev ustreznega delovanja je treba uporabiti držalo za igle BD Vacutainer. Glejte Informacije za naročanje.
3. Oznake za pozitivno identifikacijo vzorcev krvodajalcev (po potrebi)
4. Vatirane palčke za alkoholom za čiščenje mesta
5. Suha, sterilna gaza
6. Zažemka
7. Vsebnik za porabljene igle ali sklope igel in držal

B. Postopek za odvzem vzorca



(nadaljevanje)

Splošna navodila

MED VENSKO PUNKCIJO IN PRI ROKOVANJU Z EPRUVETAMI ZA ODVZEM KRVI NOSITE ROKAVICE, DA ČIM BOLJ ZMANJŠATE TVEGANJE IZPOSTAVLJENOSTI.

1. Vstavite iglo v držalo. Prepričajte se, da je igla čvrsto nameščena, s čimer zagotovite, da se med uporabo ne sname.
2. Epruveto postavite v držalo. Opomba: Ne prebodite pokrovčka.
3. Izberite vbodno mesto.
4. **Namestite zažemko. Pripravite vbodno mesto z ustreznim antiseptikom. KO VBDNO MESTO OČISTITE, SE GA NE DOTIKAJTE.**
5. Pacientova roka mora biti usmerjena navzdol.
6. Odstranite ščitnik igle. Opravite odvzem krvi TAKO, DA JE ROKA USMERJENA NAVZDOL IN JE POKROVČEK ZGORAJ.
7. Epruvete med penetracijo pokrovčka postavite v središče držala, da ne prebodete stranske stene in tako povzročite prezgodnjo izgubo vakuuma. Epruveto potisnite na iglo, tako da prebodete opno pokrovčka.
8. **TAKOJ KO SE V EPRUVETI POJAVI KRI, ODSTRANITE ZAŽEMKO. NE DOVOLITE, DA BI MED POSTOPKOM VSEBINA EPRUVETE PRIŠLA V STIK S POKROVČKOM ALI KONCEM IGLE.**

Opomba: Kri lahko občasno uhaja iz tulca igle. Upoštevajte univerzalne varnostne ukrepe, da čim bolj zmanjšate tveganje izpostavljenosti. Če kri ne teče v epruveto ali če preneha teči, preden se napolni ustrezna količina vzorca, priporočamo naslednji postopek, da pridobite zadostno količino:

- a. Epruveto potisnite naprej, tako da se pokrovček prebode. Po potrebi držite epruveto, da zagotovite popolno vsesavanje vakuuma.
 - b. Prepričajte se, da je položaj igle v veni pravilen.
9. Ko se epruveta napolni do določene prostornine in kri preneha teči, jo odstranite z držala.
 10. Obrnite 8-krat.
 11. Odstranite iglo iz vene in s suho sterilno vatirano palčko pritisnite na mesto vboda, da se krvavitev ustavi.
 12. Ko se kri strdi, po želji namestite obvezo.
 13. Po odvzemu krvi je lahko na vrhu pokrovčka ostanek krvi. Upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe pri rokovanju z epruveto, da se ne dotaknete te krvi.
 14. Iglo in držalo zavrzite v skladu s pravilnikom in smernicami vaše ustanove.
 15. Napolnjeno epruveto PAXgene za DNA v krvi hranite pri sobni temperaturi (18-25 °C). Za stabilnost DNA v vzorcih krvi pri sobni temperaturi (18-25 °C), 2-8 °C, ali -20 °C glejte Lastnosti glede učinkovitosti.

Za podrobnosti pogledajte Postopek za zamrzovanje in odmrzovanje vzorcev v epruvetah PAXgene za DNA v krvi, če je zaželeno temperatura hranjenja -70 °C/-80 °C.

Za preprečitev povratnega toka je potrebno uporabiti naslednje tehnike:

- a. Krvodajalčeva roka mora biti usmerjena navzdol.
- b. Epruveto držite tako, da je pokrovček zgoraj.
- c. Takoj ko kri začne teči v epruveto, sprostite zažemko.
- d. Prepričajte se, da se aditivi epruvete med venko punkcijo ne dotikajo pokrovčka ali konca igle.

C. Postopek za zamrzovanje in odmrzovanje vzorcev, odvzetih v epruvete PAXgene za DNA v krvi

1. Epruveto PAXgene za DNA v krvi postavite pokonci v žično stojalo. **Epruvet ne zamrzujte v pokončnem položaju v pladnju iz stiropora Styrofoam™, saj lahko počijo.**
2. Epruvete PAXgene za DNA v krvi shranjujte pri -20 °C in nižjih temperaturah. Za shranjevanje epruvete pri temperaturah pod -20°C jih najprej zamrznite pri -20 °C za 24 ur, nato pa jih prenesite na -70 °C ali -80 °C.

- Epruvete PAXgene za DNA v krvi odmrzujte v žičnem stojalu pri sobni temperaturi (18-25 °C) približno dve uri.
Epruвет PAXgene za DNA v krvi ne odmrzujte pri temperaturah nad 25 °C.
- Odmrznjene epruvete PAXgene za DNA v krvi previdno 10-krat obrnite.

Opomba: Zamrznjene epruvete PAXgene za DNA v krvi se lahko ob udarcu zlomijo. Za zmanjšanje tveganja lomljenja med pošiljanjem je treba z zamrznjenimi epruветami ravnati enako kot s steklenimi epruветami. Uporabniki morajo potrditi svoj protokol zamrzovanja in pošiljanja epruвет PAXgene za DNA v krvi.

D. Postopek za pripravo vzorca za analizo


Pri postopku analize vzorcev krvi je potrebno ravnati v skladu z navodili, ki so del kompleta za pripravo vzorca DNA. Za primere glejte Informacije za naročanje.

V. Lastnosti glede učinkovitosti

Po vstopu krvi v epruveto bo DNA ostala stabilna 14 dni pri 18 °C do 25 °C (Slika 1). Na osnovi študij stabilnosti DNA je lahko kri shranjena v epruветi 14 dni pri 18 °C do 25°C, 28 dni pri 2 °C do 8 °C, 3 dni pri 35 °C ali najmanj 6 mesecev pri -20 °C s koncentracijo DNA $\geq 2,5$ ng/ μ l in čistočo DNA (A_{260}/A_{280}) 1,7–1,9.

Najnovejši podatki o stabilnosti zamrznjenih vzorcev so na voljo na www.PreAnalytiX.com.

Stabilnost DNA v vzorcih krvi pri 18–25 °C

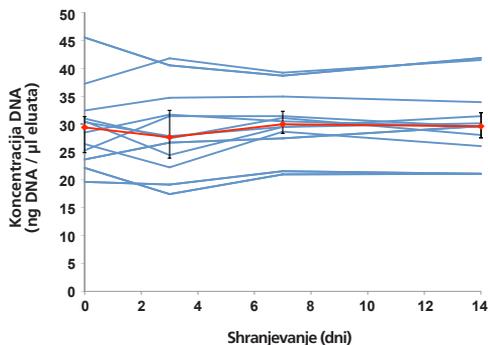

Slika 1

12 odraslim krvodajalcem so odvzeli vzorce krvi in jih shranili pri 18-25 °C za prikazano število dni, čemur je sledilo čiščenje vse DNA. Kri je bila odvzeta in shranjena v epruветah PAXgene za DNA v krvi, vsa DNA je bila očiščena s kompletom QIAGEN® QIASymphony® DSP DNA Mini na avtomatiziranem instrumentu QIAGEN QIASymphony.

VI. Omejitve

- Količina odvzete krvi mora biti 2,5 ml na epruveto PAXgene za DNA v krvi, vendar je lahko odvisna od nadmorske višine, temperature okolice, zračnega tlaka, starosti epruветe, venskega tlaka in tehnike polnjenja.

VII. Varnostni ukrepi

- Upoštevajte splošne varnostne ukrepe. Uporabljajte rokavice, halje, zaščito za oči, drugo osebno zaščitno opremo in tehnično-tehnološki nadzor za zaščito pred škropljenjem krvi, uhajanjem krvi in potencialno izpostavljenostjo patogenom, ki se prenašajo s krvjo.
- Z vsemi biološkimi vzorci in ostrimi predmeti iz kompleta za odvzem krvi rokujte v skladu s pravili in postopki svoje ustanove. V primeru izpostavljenosti biološkemu vzorcu (na primer z vbodom) poiščite ustrezno zdravniško pomoč, saj lahko vzorci prenašajo virusni hepatitis, HIV (AIDS) ali druge infektivne bolezni.


Uporabljajte morebitne vdelane zaščite za igle, če jih komplet za odvzem krvi ima. PreAnalytiX ne priporoča ponovnega nameščanja ščitnikov na uporabljene igle. Vendar so lahko pravilniki in postopki vaše ustanove drugačni, pri čemer jih morate vedno upoštevati.

3. Vse epruvete za odvzem krvi odvrzite v vsebnike za nevarne materiale, ki so odobreni za odstranjevanje teh epruvet.
4. Epruvet PAXgene za DNA v krvi ne uporabljajte ponovno.
5. Epruvet PAXgene za DNA v krvi ne uporabljajte po pretečenem roku uporabe, ki je natisnjen na nalepki epruvete.
6. Prekomerna hitrost centrifugiranja (nad 10.000 RCF) lahko povzroči, da epruveta PAXgene za DNA v krvi počí, pri čemer pride do izpostavljenosti krvi in morebitnih poškodb.
7. Ne prenašajte vzorca iz brizge v epruveto.

VIII. Shranjevanje

1. Neuporabljene epruvete PAXgene za DNA v krvi shranjujte pri od 18 °C do 25 °C. Dovoljene so kratkotrajne temperature do 40 °C. Epruvet ne uporabljajte po pretečenem roku uporabe.


IX. Navodila za odstranjevanje pokrovčka BD Hemogard



1. Z eno roko primite epruveto PAXgene za DNA v krvi in položite palec pod pokrovček BD Hemogard. (Za dodatno stabilnost roko naslonite na trdno površino.) Z drugo roko obrnite pokrovček BD Hemogard in hkrati potisnite palec druge roke gor, SAMO TOLIKO, DA SE POKROVČEK ZRAHLJA.

2. Preden pokrovček dvignete, umaknite palec. Pokrovčka z epruvete NE potisnite s palcem. Če epruveta vsebuje kri, obstaja tveganje zaradi izpostavljenosti. Za preprečevanje poškodb med odstranjevanjem pokrovčka je pomembno, da palec, s katerim pokrovček potisnete navzgor, odmaknete od epruvete takoj, ko se pokrovček BD Hemogard zrahlja.
3. Dvignite pokrovček z epruvete. Če se plastični ščitnik loči od gumijastega pokrovčka, POKROVČKA NE SESTAVITE PONOVO. Previdno odstranite gumijasti pokrovček z epruvete.

X. Navodila za nameščanje pokrovčka BD Hemogard



1. Namestite pokrovček na epruveto.
2. Obrnite in čvrsto pritisnite, tako da se pokrovček popolnoma namesti. Popolna namestitev pokrovčka je potrebna zato, da med rokovaljem pokrovček ostane trdno nameščen na epruveti.

Tehnična služba

Če imate kakršno koli vprašanje v zvezi z epruveto PAXgene za DNA v krvi, se obrnite na eno izmed tehničnih služb BD s seznama v razdelku BD – Storitve za stranke.

Informacije za naročanje

Izdelki PAXgene

Epruveta PAXgene za DNA v krvi / 761165

Vsebina: 1.000 epruvet za odvzem krvi.

Izdelki BD*

Igla za odvzem krvi BD Vacutainer Eclipse / 368609 CE

Vsebina: 21 G 1¼-palčna igla, 0,8 mm x 32 mm, 48/škatlo, 480/zaboj

Igla za odvzem krvi BD Vacutainer Eclipse s prednameščenim držalom / 368650

Vsebina: 21 G 1¼-palčna igla, 0,8 mm x 32 mm, 100/zaboj

Igla za odvzem krvi BD Vacutainer Eclipse Signal / 368835 CE

Vsebina: 21 G 1¼-palčna igla, 0,8 mm x 32 mm, 50/škatlo, 400/zaboj

Držalo BD Vacutainer za eno uporabo / 364815

Vsebina: Zaboj samo za 13 mm in 16 mm premera, 1000/zaboj

* Te kataloške številke predstavljajo tipične izdelke, ki se jih lahko uporabi z epruveto PAXgene za DNA v krvi.

Naročanje pripomočkov družbe BD za odvzem krvi:

Pojdite na: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

- Izberite državo • Pomaknite se po strani navzdol do "BD Diagnostics - Preanalytical Systems"
- Pokličite številko

Izdelki QIAGEN*

Komplet QIAGEN QIASymphony DSP DNA / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Vsebina: Kartuša z reagentom, stojalo za encime, pokrov za prebadanje, pufer ATE, komplet tesnil za ponovno uporabo

Komplet QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini / 61104 (50)

Vsebina: Kolone QIAamp Mini, epruvete za odvzem, pufer AL, pufer ATL, pufer AW1, pufer AW2, pufer AE, proteaza QIAGEN, topilo proteaze

Komplet za kri QIAGEN Gentra® Puregene® / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)

Vsebina: Raztopina za liziranje eritrocitov (RBC), raztopina za liziranje celic, raztopina za obarvanje proteinov, rehidracijska raztopina DNA, raztopina RNase A

* Te kataloške številke predstavljajo tipične komplete za pripravo DNA, ki se jih lahko uporabi z epruveto PAXgene za DNA v krvi.

Naročanje kompletov za pripravo DNA QIAGEN:

Pojdite na: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

Epruvete PAXgene za DNA v krvi za PreAnalytiX GmbH izdeluje BD v Veliki Britaniji. PAXgene in PreAnalytiX sta blagovni znamki družbe PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra, Puregene so blagovne znamke družbe QIAGEN NV; Styrofoam je blagovna znamka družbe The Dow Chemical Company; vse druge blagovne znamke so last družbe Becton, Dickinson and Company.

(nadaljevanje)

BD – Storitve za stranke

Argentina, Urugvaj in Paragvaj

Naročila: 011.4551.7100
E-pošta: crc_argentina@bd.com

Avstralija

Naročila: 1.800.656.100
Faks: 1.800.656.110
E-pošta: bd_anz@bd.com

Avstrija

Naročila: 43.1.7063660
Faks: 43.1.7063660-11

Belgija

Naročila: 32.53.720.556
Faks: 32.53.720.549

Brazilija

Naročila: 0800.055.5654
E-pošta: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Naročila: 800.268.5430
Faks: 800.565.0897
E-pošta: custsvccan@bd.com

Danska

Naročila: 45.43.43.45.66
Faks: 45.43.96.56.76
E-pošta: bdcs_dk@europe.bd.com

Vzhodna Evropa

Naročila: 48.22.651.75.88
Faks: 48.22.651.75.89

Finska

Naročila: 358.9.88.70.780
Faks: 358.9.88.70.7816
E-pošta: bdorder_finland@europe.bd.com

Francija

Naročila: 33.476.689496
Faks: 33.476.683693
E-pošta: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Nemčija

Naročila: 49.6221305553
Faks: 49.6221305379

Italija

Naročila: 39.02.48.240.500
Faks: 39.02.48.240.344
Tehnična služba: 39.02.48.240.264
E-pošta: ordini_medicale@europe.bd.com

Bližnji vzhod in Afrika (EMA)

Naročila: 971.4.3379525
Faks: 971.4.03379551
E-pošta: EMA_PAS@bd.com

Nizozemska

Naročila: 31.20.6545.716
Faks: 31.20.5829.421
E-pošta: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Nova Zelandija

Naročila: 0800.572.468
Faks: 0800.572.469
E-pošta: bd_anz@bd.com

Norveška:

Naročila: 47.73.59.12.00
Faks: 47.73.59.12.01

Španija

Naročila: 34.902.27.17.27
Faks: 34.91.848.81.04
E-pošta: servicio_de_clientes@bd.com

Švedska

Naročila: 46.8.775.51.60
Faks 46: 8.775.51.95
E-pošta: bdorder_sweden@europe.bd.com

Švica

Naročila: 41.61.4852222
Faks: 41.61.4852200

Velika Britanija

Naročila: 44.1.865.781.666
Faks: 44.1.865.717.313
E-pošta: bduk_customerservice@europe.bd.com

ZDA

Naročila: 888.237.2762
Faks: 800.847.2220
Tehnična služba: 800.631.0174
E-pošta: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Storitve za stranke

Avstralija

Naročila: 03.9840.9800

Faks: 03.9840.9888

Tehnična služba: 1.800.243.066

Avstrija

Naročila: 0800/28.10.10

Faks: 0800/28.10.19

Tehnična služba: 0800/28.10.11

Belgija

Naročila: 0800.79612

Faks: 0800.79611

Tehnična služba: 0800.79556

Kanada

Naročila: 800.572.9613

Faks: 800.713.5951

Tehnična služba: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Kitajska

Naročila: 0086.21.3865.3865

Faks: 0086.21.3865.3965

Tehnična služba: 800.988.0325 / 800.988.0327

Danska

Naročila: 80.885945

Faks: 80.885944

Tehnična služba: 80.885942

Finska

Naročila: 0800.914416

Faks: 0800.914415

Tehnična služba: 0800.914413

Francija

Naročila: 01.60.920.926

Faks: 01.60.920.925

Tehnična služba: 01.60.920.930

Ponudbe: 01.60.920.928

Nemčija

Naročila: 02103.29.12000

Faks: 02103.29.22000

Tehnična služba: 02103.29.12400

Hongkong

Naročila: 800.933.965

Faks: 800.930.439

Tehnična služba: 800.930.425

Irska

Naročila: 1800.555.049

Faks: 1800.555.048

Tehnična služba: 1800.555.061

Italija

Naročila: 02.33430411

Faks: 02.33430426

Tehnična služba: 800.787980

Japonska

Telefon: 03.5547.0811

Faks: 03.5547.0818

Tehnična služba: 03.5547.0811

Koreja (Južna)

Naročila: 1544.7145

Faks: 1544.7146

Tehnična služba: 1544.7145

Luksemburg

Naročila: 8002.2076

Faks: 8002.2073

Tehnična služba: 8002.2067

Nizozemska

Naročila: 0800.0229592

Faks: 0800.0229593

Tehnična služba: 0800.0229602

Norveška

Naročila: 800.18859

Faks: 800.18817

Tehnična služba: 800.18712

Singapur

Naročila: 65.67775366

Faks: 65.67785177

Tehnična služba: 65.67775366

Španija

Naročila: 91.630.7050

Faks: 91.630.5145

Tehnična služba: 91.630.7050

Švedska

Naročila: 020.790282

Faks: 020.790582

Tehnična služba: 020.798328

Švica

Naročila: 055.254.22.11

Faks: 055.254.22.13

Tehnična služba: 055.254.22.12

Združeno kraljestvo

Naročila: 01293.422.911

Faks: 01293.422.922

Tehnična služba: 01293.422.999

ZDA

Naročila: 800.426.8157

Faks: 800.718.2056

Tehnična s.: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

DNA-blodrör

SV – Svenska

I. Avsedd användning

PAXgene DNA-blodrör är avsett för tagning, antikoagulering, stabilisering, transporter och lagring av ett venöst helblodsprov, för framtagning av DNA i hög kvalitet som ska användas i molekylära diagnostiska testmetoder som kräver DNA.

Denna enhets funktionsegenskaper har inte fastställts för molekylära, diagnostiska analyser i allmänhet. Användare måste godkänna produktens användning för sin specifika, molekylära, diagnostiska analys.

Produktegenskaper

PAXgene DNA-blodrör • 2,5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA-tillsats
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 rör/hyllkartong • 1 000 rör/låda

II. Sammanfattning och förklaring

PAXgene DNA-blodrör gör det möjligt att ta helblodsprov för isolering av genomiskt DNA i ett slutet vakuumsystem. Blodprovet tas som flebotomi enligt standardprotokoll i ett vakuurrör som innehåller K₂EDTA-tillsats. Fullständig isolering av DNA utförs genom manuella eller automatiserade metoder som t.ex. utsaltnings/utfällning, magnetiska kulor eller kiselmembranbaserade tekniker.

III. Varningar

Innehållet i detta rör irriterar huden.


- Efter inandning, förflytta den exponerade personen till frisk luft.
- Efter hudkontakt, skölj omedelbart med rikliga mängder tvål och vatten i minst 15 minuter.
- Efter ögonkontakt, skölj omedelbart med rikliga mängder vatten i minst 15 minuter.
- Efter förtäring, drick stora mängder vatten. Kontakta läkare.

IV. Provtagning och beredning för analys

A. Nödvändiga tillbehör för blodprovstagning (ej inkluderat med PAXgene DNA-blodrör)

1. Säkerhetskanyl som t.ex. BD Vacutainer® Eclipse™ eller BD Vacutainer Eclipse Signal™.
Se beställningsinformation.
2. En BD Vacutainer kanylhållare måste användas för att säkerställa riktig funktion.
Se beställningsinformation.
3. Etiketter för positiv identifiering av givarprover, vid behov
4. Sprittork för rengöring av provtagningsställe
5. Torr, steril gasväv
6. Stasslang.
7. Behållare för använda kanyler eller kombination av kanyl/hållare

B. Provtagningsprocedur



Allmänna instruktioner

BÄR HANDSKAR UNDER VENPUNKTION SAMT VID HANTERING AV BLODPROVTAGNINGSRÖR FÖR ATT MINIMERA RISKEXPONERINGEN.

1. Montera kanylen i hållaren. Säkerställ att kanylen sitter ordentligt så att kanylen inte skruvas upp under användningen.
2. Placera röret i hållaren. Obs! Punktera inte proppen.
3. Välj ställe för venpunktion.
4. **Applicera stasslangen. Förbered venpunktionsstället med ett lämpligt antiseptikum. PALPERA INTE BLODPROVTAGNINGSMRÅDE EFTER RENGÖRING.**
5. Placera patientens arm i nedåtriktat läge.
6. Ta bort kanylskyddet. Utför venpunktionen MED ARMEN NEDÅT OCH RÖRPROPPEN UPPÅT.
7. Centrera röret i hållaren när proppen penetreras för att förhindra sidoväggspenetrering och därmed förtida vakuutförlust. Tryck röret på kanylen, punktera proppmembranet.
8. **TA BORT STASSLANGEN SÅ SNART BLOD KOMMER IN I RÖRET. LÅT INTE INNEHÅLLET I RÖRET KOMMA I KONTAKT MED PROPPEN ELLER KANYLÄNDEN UNDER FÖRFARANDET.**

Obs! Blod kan ibland läcka från kanylhylsan. Tillämpa allmänna försiktighetsåtgärder för att minimera riskexponeringen. Om inget blod flödar in i röret eller om blod upphör att flöda innan ett adekvat prov tagits, föreslås följande steg för att slutföra en tillfredsställande provtagning:

- a. Tryck röret framåt tills rörproppen har penetrerats. Håll det vid behov på plats för att säkerställa fullständigt vakuumdrag.
 - b. Bekräfta korrekt läge på kanylen i venen.
9. När röret har fyllts till den angivna volymen och blodflödet upphör, ta bort det från hållaren.
 10. Vänd röret 8 gånger.
 11. Ta bort kanylen från venen och tryck på punktionsstället med en torr steril kompress tills blödningsen upphör.
 12. När koagulering har inträffat, sätt på ett bandage om så önskas.
 13. Efter venpunktionen kan den övre delen av proppen innehålla kvarvarande blod. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder vid hantering av rören för att undvika kontakt med detta blod.
 14. Kassera kanyl och hållare enligt institutionens rutiner och riktlinjer.
 15. Förvara det fyllda PAXgene DNA-blodröret i rumstemperatur (18-25°C). Se funktionsegenskaperna för DNA-stabilitet i blodprover vid rumstemperatur (18-25°C), 2-8°C, eller -20°C.

Se "Procedur för nedfrysning och upptining av insamlade prover i PAXgene DNA-blodrör" för detaljerad information om en förvaringstemperatur på -70°C / -80°C önskas.

Följande tekniker ska användas för att förhindra eventuell återflöde:

- a. Placera blodgivarens arm lutande nedåt.
- b. Håll röret med proppen uppåt.
- c. Släpp stasen så snart blod börjar rinna in i röret.
- d. Säkerställ att tillsatserna i röret inte kommer i kontakt med proppen eller kanylspetsen under venpunktionen.

C. Procedur för nedfrysning och upptining av insamlade prover i PAXgene DNA-blodrör

1. Ställ PAXgene DNA-blodröret upprätt i ett metallträdsställ. Frys inte rör upprätt i en Styrofoam™-hållare eftersom detta kan orsaka att rören spricker.

2. PAXgene DNA-blodrör kan förvaras vid -20°C och lägre. Om rören ska förvaras vid temperaturer lägre än -20°C ska de först frysas vid -20°C under 24 timmar. Överför dem sedan till -70°C eller -80°C.
3. Tina PAXgene DNA-blodrör i ett metallträdsställ vid rumtemperatur (18-25°C) under cirka två timmar. **Tina inte PAXgene DNA-blodrör i temperaturer över 25°C.**
4. Vänd försiktigt de tinade PAXgene DNA-blodrörens 10 gånger.

Obs! De frusna PAXgene DNA-blodrörens kan spricka vid stötar. För att minska risken för sprickor under frakt bör frysta rör behandlas på samma sätt som glaströr. Användarna måste bekräfta sina egna nedfrysnings- och fraktprotokoll för PAXgene DNA-blodrörens.

D. Provberedning inför analys


Blodproverna ska bearbetas enligt de instruktioner som medföljer beredningssatsen för DNA-prov. För exempel, se Beställningsinformation.

V. Funktionsegenskaper

När blod har förts in i röret är DNA stabilt under 14 dagar vid 18°C till 25°C (figur 1). Baserat på DNA-stabilitetsstudier kan blod förvaras i röret under 14 dagar i 18°C till 25°C, 28 dagar i 2°C till 8°C, 3 dagar i 35°C eller minst sex månader i -20°C med DNA-koncentration $\geq 12,5$ ng/μl och DNA-renhet (A_{260}/A_{280}) på 1,7-1,9.

Gå till www.PreAnalytiX.com för den allra senaste informationen beträffande frysta provers stabilitet.

DNA-stabilitet i blodprover vid 18-25°C

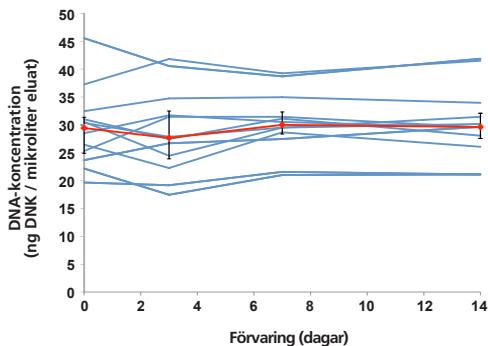

Figur 1

Blod togs från 12 frivilliga, vuxna givare och förvarades vid 18-25°C i angivet antal dagar följt av total DNA-rening. Blod insamlades och förvarades i PAXgene DNA-blodrör, och totalt DNA renades med hjälp av DNA-minisatsen QIAGEN® QIAasymphony® DSP på det automatiserade instrumentet QIAGEN QIAasymphony.

VI. Begränsningar

1. Blodkvantiteten bör vara 2,5 ml per PAXgene DNA-blodrör, men denna volym kan variera med höjdnivå, rumstemperatur, barometertryck, rörets ålder, ventryck och fyllnadsteknik.

VII. Försiktighetsåtgärder

1. Vidta allmänna försiktighetsåtgärder. Använd handskar, rockar, skyddsglasögon, annan personlig skyddsutrustning samt tekniska kontroller för att skydda mot blodstänk, blodläckage och potentiell exponering för blodburna patogener.

2. Hantera alla biologiska prover och allt "vasst" materiel för blodprovstagning i enlighet med de regler och rutiner som gäller vid din klinik. Kontakta läkare i händelse av exponering för biologiska prover (till exempel genom en punkteringskada), eftersom de kan överföra viral hepatit, HIV (AIDS) eller andra infektionssjukdomar.


Använd ett inbyggt kanylskydd om ett sådant tillhandahålls med provtagningssetsen. PreAnalytiX rekommenderar inte att hylsan sätts tillbaka på använda kanyler. Dock kan rutiner och procedurer vara annorlunda vid din institution och bör alltid följas.

3. Kassera alla blodprovstagningsrör i behållare godkända för biologiskt riskmaterial.
4. Återanvänd inte PAXgene DNA-blodrören.
5. Använd inte PAXgene DNA-blodrören efter det utgångsdatum som tryckts på rørets etikett.
6. Överdriven centrifugeringshastighet (över 10 000 RCF) kan orsaka att PAXgene DNA-blodrøret går sönder, exponering för blod samt möjlig personskada.
7. Överför inte ett prov från en spruta till ett rör.

VIII. Förvaring

1. Förvara icke använda PAXgene DNA-blodrör vid 18 till 25°C. Begränsade temperatursvängningar upp till 40°C är tillåtna. Använd inte røren efter utgångsdatum.


IX. Anvisningar för borttagning av BD Hemogard-förslutning



1. Greppa PAXgene DNA-blodrøret med ena handen och placera tummen under BD Hemogard-förslutningen (placera armen på en fast yta för ökad stabilitet). Vrid BD Hemogard-förslutningen med den andra handen och tryck samtidigt uppåt med den andra handens tumme **BARA TILLS RÖRPROPPEN LOSSATS**.

2. Ta bort tummen innan förslutningen lyfts. **ANVÄND INTE** tummen till att trycka av förslutningen från røret. Om røret innehåller blod finns en exponeringsrisk. För att förhindra personskada när förslutningen ska tas bort är det viktigt att kontakten mellan tummen som används för att skjuta förslutningen uppåt och røret upphör så snart BD Hemogard-förslutningen lossats.
3. Lyft bort förslutningen från røret. Om det osannolika skulle inträffa att plasthylsan separeras från gummiproppen, **MONTERA INTE IHOP FÖRSLUTNINGEN PÅ NYTT**. Ta försiktigt bort gummiproppen från røret.

X. Anvisningar för återisättning av BD Hemogard-förslutning



1. Placera förslutningen över røret.
2. Vrid och tryck ner ordentligt tills proppen åter sitter ordentligt på plats. Det är nödvändigt att proppen sätts tillbaka fullständigt för att förslutningen ska stanna säkert på røret under hanteringen.

Teknisk support

Om du har frågor gällande PAXgene DNA-blodrøret ska du kontakta någon av avdelningarna för BD teknisk service som finns angivna i avsnittet BD – Kundtjänst.

Beställningsinformation

PAXgene-produkter

PAXgene DNA-blodrör/761165

Innehåll: 1 000 blodprovstagningsrör.

BD-produkter*

Säkerhetskanyl BD Vacutainer Eclipse/368609 CE

Innehåll: 21G 1¼-tums kanyl, 0,8 mm x 32 mm, 48/kartong, 480/låda

Säkerhetskanyl med monterad hållare BD Vacutainer Eclipse/368650

Innehåll: 21G 1¼-tums kanyl, 0,8 mm x 32 mm, 100/kartong

Säkerhetskanyl BD Vacutainer Eclipse/368835 CE

Innehåll: 21G 1¼-tums kanyl, 0,8 mm x 32 mm, 50/kartong, 400/låda

Engångshållare BD Vacutainer/364815

Innehåll: Låda endast för 13 mm och 16 mm diameter 1 000/låda

** Dessa katalognummer representerar typiska produkter som kan användas med PAXgene DNA-blodrör.*

För att beställa tillbehör för BD blodprovstagnig:

Gå till: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

• Välj land • Rulla ned till BD Diagnostics - Preanalytical Systems • Slå numret

QIAGEN-produkter*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA-sats/937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Innehåll: Reagenspatron, enzymställ, instickslock, buffert ATE, återanvändbar tätningssats

QIAGEN QIAamp® DSP DNA-sats/Blood Mini Kit / 61104 (50)

Innehåll: QIAamp Mini spinnkolonner, provtagningsrör, buffert AL, buffert ATL, buffert AW1, buffert AW2, buffert AE, QIAGEN proteas, proteaslösningsmedel

QIAGEN Gentra® Puregene® blodsats/158422 (3 ml)/158445 (30 ml)/158467 (120 ml)/158389 (1 000 ml)

Innehåll: RBC lyseringslösning, cellyseringslösning, proteinutfällningslösning, DNA-hydreringslösning, RNase A-lösning

** Dessa katalognummer representerar typiska DNA-beredningssatser som kan användas med PAXgene DNA-blodrör.*

För att beställa QIAGEN DNA-beredningssatser:

Gå till: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

PAXgene DNA-blodröret är tillverkat i Storbritannien av BD för PreAnalytiX GmbH. PAXgene och PreAnalytiX är varumärken som tillhör PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra och Puregene är varumärken som tillhör QIAGEN NV; Styrofoam är ett varumärke som tillhör The Dow Chemical Company; alla andra varumärken tillhör Becton, Dickinson and Company.

(Fortsättning)

BD – Kundtjänst

Argentina, Uruguay och Paraguay

Beställningar: 011.4551.7100

E-post: crc_argentina@bd.com

Australien

Beställningar: 1.800.656.100

Fax: 1.800.656.110

E-post: bd_anz@bd.com

Österrike

Beställningar: 43.1.7063660

Fax: 43.1.7063660-11

Belgien

Beställningar: 32.53.720.556

Fax: 32.53.720.549

Brasilien

Beställningar: 0800.055.5654

E-post: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Beställningar: 800.268.5430

Fax: 800.565.0897

E-post: custsvccan@bd.com

Danmark

Beställningar: 45.43.43.45.66

Fax: 45.43.96.56.76

E-post: bdcs_dk@europe.bd.com

Östeuropa

Beställningar: 48.22.651.75.88

Fax: 48.22.651.75.89

Finland

Beställningar: 358.9.88.70.780

Fax: 358.9.88.70.7816

E-post: bdorder_finland@europe.bd.com

Frankrike

Beställningar: 33.476.689496

Fax: 33.476.683693

E-post: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Tyskland

Beställningar: 49.6221305553

Fax: 49.6221305379

Italien

Beställningar: 39.02.48.240.500

Fax: 39.02.48.240.344

Teknik: 39.02.48.240.264

E-post: ordini_medicale@europe.bd.com

Mellanöstern och Afrika (EMA)

Beställningar: 971.4.3379525

Fax: 971.4.03379551

E-post: EMA_PAS@bd.com

Nederländerna

Beställningar: 31.20.6545.716

Fax: 31.20.5829.421

E-post: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Nya Zeeland

Beställningar: 0800.572.468

Fax: 0800.572.469

E-post: bd_anz@bd.com

Norge

Beställningar: 47.73.59.12.00

Fax: 47.73.59.12.01

Spanien

Beställningar: 34.902.27.17.27

Fax: 34.91.848.81.04

E-post: servicio_de_clientes@bd.com

Sverige

Beställningar: 46.8.775.51.60

Fax 46: 8.775.51.95

E-post: bdorder_sweden@europe.bd.com

Schweiz

Beställningar: 41.61.4852222

Beställningar: 41.61.4852200

Storbritannien

Beställningar: 44.1.865.781.666

Fax: 44.1.865.717.313

E-post: bduk_customerservice@europe.bd.com

USA

Beställningar: 888.237.2762

Fax: 800.847.2220

Teknik: 800.631.0174

E-post: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Kundtjänst

Australien

Beställningar: 03.9840.9800
Fax: 03.9840.9888
Teknik: 1.800.243.066

Österrike

Beställningar: 0800/28.10.10
Fax: 0800/28.10.19
Teknik: 0800/28.10.11

Belgien

Beställningar: 0800.79612
Fax: 0800.79611
Teknik: 0800.79556

Kanada

Beställningar: 800.572.9613
Fax: 800.713.5951
Teknik: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Kina

Beställningar: 0086.21.3865.3865
Fax: 0086.21.3865.3965
Teknik: 800.988.0325 / 800.988.0327

Danmark

Beställningar: 80.885945
Fax: 80.885944
Teknik: 80.885942

Finland

Beställningar: 0800.914416
Fax: 0800.914415
Teknik: 0800.914413

Frankrike

Beställningar: 01.60.920.926
Fax: 01.60.920.925
Teknik: 01.60.920.930
Erbjudanden: 01.60.920.928

Tyskland

Beställningar: 02103.29.12000
Fax: 02103.29.22000
Teknik: 02103.29.12400

Hongkong

Beställningar: 800.933.965
Fax: 800.930.439
Teknik: 800.930.425

Irland

Beställningar: 1800.555.049
Fax: 1800.555.048
Teknik: 1800.555.061

Italien

Beställningar: 02.33430411
Fax: 02.33430426
Teknik: 800.787980

Japan

Telefon: 03.5547.0811
Fax: 03.5547.0818
Teknik: 03.5547.0811

Sydkorea

Beställningar: 1544.7145
Fax: 1544.7146
Teknik: 1544.7145

Luxemburg

Beställningar: 8002.2076
Fax: 8002.2073
Teknik: 8002.2067

Nederländerna

Beställningar: 0800.0229592
Fax: 0800.0229593
Teknik: 0800.0229602

Norge

Beställningar: 800.18859
Fax: 800.18817
Teknik: 800.18712

Singapore

Beställningar: 65.67775366
Fax: 65.67785177
Teknik: 65.67775366

Spanien

Beställningar: 91.630.7050
Fax: 91.630.5145
Teknik: 91.630.7050

Sverige

Beställningar: 020.790282
Fax: 020.790582
Teknik: 020.798328

Schweiz

Beställningar: 055.254.22.11
Fax: 055.254.22.13
Teknik: 055.254.22.12

Storbritannien

Beställningar: 01293.422.911
Fax: 01293.422.922
Teknik: 01293.422.999

USA

Beställningar: 800.426.8157
Fax: 800.718.2056
Teknik: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Kan DNA Tüpü

TR – Türkçe

1. Kullanım Amacı

PAXgene Kan DNA Tüpü, DNA gerektiren moleküler diyagnostik test yöntemleriyle kullanım için yüksek kalitede DNA hazırlamak amacıyla veniz kan örneği toplamak, anti-koagüle etmek, stabilize etmek, taşımak ve saklamak için tasarlanmıştır.

Bu cihazın performans özellikleri genel olarak moleküler diyagnostik testler için belirlenmemiştir. Kullanıcıların kendi spesifik moleküler diyagnostik testleri için ürün kullanımını valide etmesi gerekir.

Ürün Özellikleri

PAXgene Kan DNA Tüpü • 2,5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA katkı maddesi
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 tüp/raf kartonu • 1.000 tüp/kutu

II. Özet ve Açıklama

PAXgene Kan DNA Tüpü genomik DNA'nın kapalı, boşaltılmış bir sistemde izolasyonu için tam kan toplama aracı sağlar. Kan, standart flebotomi protokolü altında K₂EDTA katkı maddesi içeren boşaltılmış bir tüpe toplanır. Tam DNA izolasyonu, çöktiyi tuzlama, manyetik boncuklar veya silis membran temelli teknolojiler gibi manuel veya otomatik yöntemler kullanılarak gerçekleştirilir.

III. Uyarılar

Bu tüpün içinde bulunanlar cilde zarar verir.


- İnhalasyondan sonra, maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın.
- Ciltle temas ettikten sonra, ilgili bölgeyi derhal en az 15 dakika boyunca sabunla ve suyla iyice yıkayın.
- Gözle temas ettikten sonra, gözü derhal en az 15 dakika boyunca suyla iyice yıkayın.
- Yutulduktan sonra, derhal bol miktarda su verin. Tıbbi yardım alın.

IV. Örnek Toplama ve Analiz için Hazırlama

A. Gerekli Kan Toplama Aksesuarları (PAXgene Kan DNA Tüpüne Dahil Edilmemiştir)

1. BD Vacutainer® Eclipse™ Kan Toplama İğnesi veya BD Vacutainer Eclipse Signal™ Kan Toplama İğnesi gibi kan toplama iğnesi. Bkz. Sipariş Bilgileri.
2. Uygun işlev sağlamak için bir BD Vacutainer İğne Tutucusu kullanılmalıdır. Bkz. Sipariş Bilgileri.
3. Gerekliyse, örneklerin pozitif donör tanımlaması için etiketler.
4. Temizleme bölgesi için alkol sürüntüsü
5. Kuru steril gazlı bez
6. Turnike
7. Kullanılmış iğne veya iğne/tutucu kombinasyonu için iğne atma kabı

B. Örnek Toplama Prosedürü



(Devam)

Genel Talimatlar

RISK MARUZİYETİNİ MİNİMUMA İNDİRMEK İÇİN VENİPUNKTÜR SIRASINDA VE KAN TOPLAMA TÜPLERİYLE ÇALIŞIRKEN ELDİVEN TAKIN.

1. İğneyi tutucuya takın. Kullanım sırasında iğnenin çıkmamasını sağlamak için iğnenin sıkıca yerleştiğinden emin olun.
2. Tüpü tutucuya yerleştirin. Not: Durdurucuyu delmeyin.
3. Venipunktür için bölgeyi seçin.
4. **Turnike uygulayın. İlgili bir antiseptik ile venipunktür bölgesini hazırlayın. TEMİZLEDİKTEN SONRA VENİPUNKTÜR ALANINI ELLE MUAYENE ETMEYİN.**
5. Hastanın kolunu aşağı doğru bir konuma yerleştirin.
6. İğne kılıfını çıkarın. Venipunktürü KOL AŞAĞI YÖNDE VE TÜP DURDURUCU EN ÜSTTEYKEN gerçekleştirin.
7. Yan duvar penetrasyonunu ve meydana gelen prematüre vakum kaybını engellemek için durdurucuyu penetre ederken tüpleri tutucuda ortalayın. Durdurucu diyaframını delerek, tüpü iğneye itin.
8. **TÜPTE KAN BELİRİR BELİRMEZ TURNİKEYİ ÇIKARIN. İŞLEM SIRASINDA TÜPÜN İÇİNDEKİLERİN DURDURUCU VEYA İĞNENİN UCU İLE TEMAS ETMESİNE İZİN VERMEYİN.**

Not: İğne manşonundan bazen kan sızabilir. Risk maruziyetini minimuma indirmek için Üniversal Önlemleri uygulayın. Tüpe kan akmazsa veya yeterli örnek toplanmadan önce kan akışı durursa, başarılı toplamayı tamamlamak için aşağıdaki adımlar önerilir:

- a. Durdurucu penetre edilene dek tüpü ileri itin. Gerekirse, vakum çekmesini tamamladığınızdan emin olmak için yerinde tutun.
 - b. Damarda iğnenin doğru konumda olduğunu doğrulayın.
9. Tüp belirtilen hacmine dolduğunda ve kan akışı durduğunda, tutucudan çıkarın.
 10. 8 kez ters yüz edin.
 11. Kanama duruncaya kadar kutu steril bir bezle delme noktasına basınç uygulayarak iğneyi damardan çıkarın.
 12. Pıhtılaşma meydana geldiğinde, istenirse bandaj uygulayın.
 13. Venipunktürden sonra, durdurucunun üstü kalıntı kan içerebilir. Bu kanla temastan kaçınmak için tüpleri kullanırken gerekli önlemleri alın.
 14. İğneyi ve tutucuyu kurumunuzun ilke ve kurallarına göre atın.
 15. Dolu PAXgene Kan DNA Tüpünü oda sıcaklığında (18-25°C) saklayın. Oda sıcaklığında (18-25°C), 2-8°C veya -20°C veya de kan örneklerindeki DNA stabilitesini için Performans Özelliklerine bakın.

-70°C / -80°C'lik saklama sıcaklığı istenirse, ayrıntılar için bkz. PAXgene Kan DNA Tüplerinde Örnekleri Dondurma ve Eritme Prosedürü.

Olası geri akışı önlemek için aşağıdaki teknikleri kullanın:

- a. Donörün kolunu aşağı doğru bir konuma yerleştirin.
- b. Tüpü, durdurucu en üstte olacak şekilde tutun.
- c. Kan tüpe akmaya başladıktan sonra turnikeyi serbest bırakın.
- d. Venipunktür sırasında tüp katkı maddelerinin durdurucuya veya iğnenin ucuna dokunmadığından emin olun.

C. PAXgene Kan DNA Tüplerinde Örnekleri Dondurma ve Eritme Prosedürü

1. PAXgene Kan DNA Tüpünü dik bir şekilde tel bir rafta tutun. **Tüplerin çatlamasına neden olabildiğinden tüpleri dik olarak straför Styrofoam™ tepesinde dondurmayın.**
2. PAXgene Kan DNA Tüpleri -20°C'de ve aşağısında saklayın. Tüpler -20°C'nin aşağısında saklanacaksa, bunları ilk olarak 24 saat boyunca -20°C'de saklayın, ardından -70°C veya -80°C sıcaklığa aktarın.

(Devam)

3. PAXgene Kan DNA Tüplerini yaklaşık iki saat boyunca bir tel rafta ortam sıcaklığında (18-25°C) çözün. **PAXgene Kan DNA Tüplerini 25°C üzerindeki sıcaklıklarda çözmeyin.**
4. Erimiş PAXgene Kan DNA Tüplerini 10 kez dikkatli bir şekilde ters yüz edin.

Not: Dondurulmuş PAXgene Kan DNA Tüpleri darbe ile kırılmaya tabidir. Gönderim sırasında kırılma riskini azaltmak için, dondurulmuş tüplere cam tüplere yapıldığı şekilde muamele edilmelidir. Kullanıcılar PAXgene Kan DNA Tüpleri için kendi dondurma ve gönderme protokolünü valide etmelidir.

D. Analiz için Örnek Hazırlama Prosedürü


Kan numuneleri DNA örnek hazırlama kitiyle sağlanan talimatlara uygun olarak işlenmiştir. Örnekler için, bkz. Sipariş Bilgileri.

V. Performans Özellikleri

Kan tüpe aktarıldıktan sonra DNA 18°C ila 25°C'de 14 gün (Şekil 1) boyunca stabil kalır. DNA stabilite çalışmalarına dayalı olarak kan, DNA konsantrasyonu $\geq 12,5$ ng/ μ l ve DNA saflığı (A₂₆₀/A₂₈₀) - 1,7-1,9 değerleriyle 18°C ila 25°C'de 14 gün, 2°C ila 8°C'de 28 gün, 35°C'de 3 gün veya -20°C'de minimum 6 ay tüpte saklanabilir.

Donmuş örneklerin en güncel stabilite verileri için, www.PreAnalytiX.com adresine gidin.

Kan Örneklerinin 18-25°C'de DNA Stabilitesi

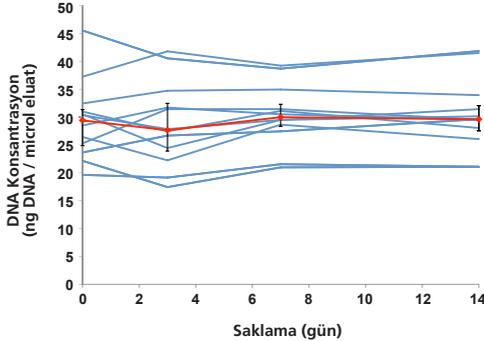

Şekil 1

Kan 12 bilgilendirilmiş yetişkin donörden alınır ve toplam DNA saflaştırmasından sonra belirtilen gün sayısı boyunca 18-25°C'de saklanır. Kan toplanır ve PAXgene Kan DNA Tüplerinde saklanır ve toplam DNA QIAGEN QIASymphony otomatik cihazdaki QIAGEN® QIASymphony® DSP DNA Mini Kit kullanılarak saflaştırılır.

VI. Sınırlamalar

1. Kan çekimi miktarı PAXgene Kan DNA Tüpü başına 2,5 ml'dir, ancak bu hacim rakım, ortam sıcaklığı, barometrik basınç, tüp yaşı, venöz basınç ve dolum tekniği ile değişebilir.

VII. Önlemler

1. Üniversal önlemleri uygulayın. Kan sıçraması, kan sızıntısı ve kanla bulaşan patojenlere potansiyel maruziyetten korumak için, eldivenler, önlükler, göz koruması, diğer kişisel koruyucu ekipman ve mühendislik kontrollerini kullanın.
2. Tüm biyolojik örnekleri ve kan toplama setlerinin "delici-kesici" öğelerini kurumunuzun ilkeleri ve işlemlerine göre kullanın. Viral hepatit, HIV (AIDS) veya başka enfeksiyöz hastalıklar taşıyabilecekleri için biyolojik örnekler herhangi bir maruz kalma durumunda (örneğin, delici bir yara ile) uygun tıbbi yardım isteyin.


Kan toplama setinde varsa, herhangi dahili bir iğne koruyucudan yararlanın. PreAnalytiX kullanılmış iğnelerin tekrar kılıflanmasını önermez. Ancak, kurumunuzun ilkeleri ve işlemleri farklılık gösterebilir ve daima takip edilmelidir.

3. Tüm kan toplama tüplerini atılmaları için onaylanmış biyolojik olarak tehlikeli madde kaplarına atın.
4. PAXgene Kan DNA Tüplerini tekrar kullanmayın.
5. Tüp etiketinde basılı olan son kullanma tarihinden sonra PAXgene Kan DNA Tüplerini kullanmayın.
6. Aşırı santrifüj hızı (10.000 RCF üzeri) PAXgene Kan DNA Tüpünün kırılmasına, kana maruziyete ve olası yaralanmaya neden olabilir.
7. Şırıngadan tüpe bir örneği nakletmeyin.

VIII. Saklama


1. Kullanılmayan PAXgene Kan DNA Tüplerini 18°C ila 25°C'de saklayın. 40°C'ye kadar sınırlı eksürsion sıcaklıkları kabul edilebilir. Tüpleri son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

IX. BD Hemogard Klosürünün Çıkarılması için Talimatlar



1. PAXgene Kan DNA Tüpü, baş parmağınızı BD Hemogard Klosürünün altına yerleştirerek, bir elinizle kavrayın. (İlave stabilite için, kolunuzu katı bir yüzeye koyun). YALNIZCA TÜP DURDURUCU GEVŞEYENE DEK diğer elin baş parmağıyla eşzamanlı olarak yukarı iterken, diğer elinizle, BD Hemogard Klosürünü bükün.
2. Klosürü kaldırmadan önce baş parmağı uzaklaştırın. Klosürü tüpten itmek için baş parmak KULLANMAYIN. Tüp kan içeriyorsa, bir maruziyet riski mevcuttur. Klosürün çıkarılması sırasında yaralanmayı engellemeye yardımcı olmak için, BD Hemogard Klosür gevşer gevşemez klosürü yukarı itmekte kullanılan baş parmağın tüple temasının kesilmesi önemlidir.
3. Klosürü tüpten kaldırın. Düşük ihtimalli plastik kılıfın lastik durdurucudan ayrılması durumunda, KLOSÜRÜ TEKRAR TAKMAYIN. Lastik durdurucuyu tüpten dikkatlice çıkarın.

X. BD Hemogard Klosürünün Tekrar Takılması için Talimatlar



1. Klosürü tüpe tekrar yerleştirin.
2. Durdurucu tam olarak tekrar yerleşene dek bükün ve sıkıca itin. Klosürün muamele sırasında tüpte sabit şekilde kalması için durdurucunun tam olarak tekrar takılması gereklidir.

Teknik Yardım

PAXgene Kan DNA Tüpüne ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, BD – Müşteri Servisi bölümünde bulunan BD Teknik Servisler Departmanlarından birisiyle temasa geçin.

Sipariş Bilgileri

PAXgene Ürünleri

PAXgene Kan DNA Tüpü / 761165
İçerik: 1.000 Kan kan toplama tüpü.

BD Ürünleri*

BD Vacutainer Eclipse Kan Toplama İğnesi / 368609 CE
İçerik: 21G 1¼" inçlik iğne, 0,8 mm x 32 mm, 48/kutu, 480/kutu

Önceden Takılmış tutucu ile BD Vacutainer Eclipse Kan Toplama İğnesi / 368650
İçerik: 21G 1¼" inçlik iğne, 0,8 mm x 32 mm, 100/kutu

BD Vacutainer Eclipse Signal Kan Toplama İğnesi / 368835 CE
İçerik: 21G 1¼" inçlik iğne, 0,8 mm x 32 mm, 50/kutu, 400/kutu

BD Vacutainer bir Kullanımlık Tutucu / 364815
İçerik: Yalnızca 13 mm ve 16 mm çapında 1000/kutu için kutu

* Bu katalog numaraları PAXgene Kan DNA Tüpü ile kullanılabilen tipik ürünleri temsil etmektedir.

BD Kan Toplama Aksesuarları Sipariş Etmek için:

Şu adrese gidin: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>
• Ülke seçin • BD Diagnostics - Preanalytical Systems'e gitmek için çubuğu kaydırın • Numarayı arayın

QIAGEN Ürünleri*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA Kiti / 937255 Orta (96) / 937236 Küçük (192)
İçerik: Reaktif kartuşu, enzim rakı, delme kapağı, tampon ATE, yeniden kullanım için mühür seti

QIAGEN QIAamp® DSP DNA Kit / 61104 Küçük (50)
İçerik: QIAamp Küçük dönüş sütunları, toplama tüpleri, tampon AL, tampon ATL, tampon AW1, tampon AW2, tampon AE, QIAGEN proteaz, proteaz çözücü

QIAGEN Gentra® Puregene® Kan Kiti / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)
İçerik: RBC lisiz çözeltisi, hücre lisiz çözeltisi, protein çökelti çözeltisi, DNA hidrasyon çözeltisi, RNase A çözeltisi

* Bu katalog numaraları PAXgene Kan DNA Tüpü ile kullanılabilen tipik DNA hazırlama kitlerini temsil etmektedir.

QIAGEN DNA Hazırlama Kitleri Sipariş Etmek için:

Şu adrese gidin: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

BD – Müşteri Servisi

Arjantin, Uruguay ve Paraguay

Siparişler: 011.4551.7100

E-posta: crc_argentina@bd.com

Avustralya

Siparişler: 1.800.656.100

Faks: 1.800.656.110

E-posta: bd_anz@bd.com

Avusturya

Siparişler: 43.1.7063660

Faks: 43.1.7063660-11

Belçika

Siparişler: 32.53.720.556

Faks: 32.53.720.549

Brezilya

Siparişler: 0800.055.5654

E-posta: consultoria_vacutainer@bd.com

Kanada

Siparişler: 800.268.5430

Faks: 800.565.0897

E-posta: custsvccan@bd.com

Danimarka

Siparişler: 45.43.43.45.66

Faks: 45.43.96.56.76

E-posta: bdcs_dk@europe.bd.com

Doğu Avrupa

Siparişler: 48.22.651.75.88

Faks: 48.22.651.75.89

Finlandiya

Siparişler: 358.9.88.70.780

Faks: 358.9.88.70.7816

E-posta: bdorder_finland@europe.bd.com

Fransa

Siparişler: 33.476.689496

Faks: 33.476.683693

E-posta: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Almanya

Siparişler: 49.6221305553

Faks: 49.6221305379

İtalya

Siparişler: 39.02.48.240.500

Faks: 39.02.48.240.344

Teknik: 39.02.48.240.264

E-posta: ordini_medicale@europe.bd.com

Orta Doğu ve Afrika (EMA)

Siparişler: 971.4.3379525

Faks: 971.4.03379551

E-posta: EMA_PAS@bd.com

Hollanda

Siparişler: 31.20.6545.716

Faks: 31.20.5829.421

E-posta: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Yeni Zelanda

Siparişler: 0800.572.468

Faks: 0800.572.469

E-posta: bd_anz@bd.com

Norveç

Siparişler: 47.73.59.12.00

Faks: 47.73.59.12.01

İspanya

Siparişler: 34.902.27.17.27

Faks: 34.91.848.81.04

E-posta: servicio_de_clientes@bd.com

İsveç

Siparişler: 46.8.775.51.60

Faks 46: 8.775.51.95

E-posta: bdorder_sweden@europe.bd.com

İsviçre

Siparişler: 41.61.4852222

Faks: 41.61.4852200

İngiltere

Siparişler: 44.1.865.781.666

Faks: 44.1.865.717.313

E-posta: bduk_customerservice@europe.bd.com

ABD

Siparişler: 888.237.2762

Faks: 800.847.2220

Teknik: 800.631.0174

E-posta: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Müşteri Servisi

Avustralya

Siparişler: 03.9840.9800
Faks: 03.9840.9888
Teknik: 1.800.243.066

Avusturya

Siparişler: 0800/28.10.10
Faks: 0800/28.10.19
Teknik: 0800/28.10.11

Belçika

Siparişler: 0800.79612
Faks: 0800.79611
Teknik: 0800.79556

Kanada

Siparişler: 800.572.9613
Faks: 800.713.5951
Teknik: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Çin

Siparişler: 0086.21.3865.3865
Faks: 0086.21.3865.3965
Teknik: 800.988.0325 / 800.988.0327

Danimarka

Siparişler: 80.885945
Faks: 80.885944
Teknik: 80.885942

Finlandiya

Siparişler: 0800.914416
Faks: 0800.914415
Teknik: 0800.914413

Fransa

Siparişler: 01.60.920.926
Faks: 01.60.920.925
Teknik: 01.60.920.930
Teklifler: 01.60.920.928

Almanya

Siparişler: 02103.29.12000
Faks: 02103.29.22000
Teknik: 02103.29.12400

Hong Kong

Siparişler: 800.933.965
Faks: 800.930.439
Teknik: 800.930.425

İrlanda

Siparişler: 1800.555.049
Faks: 1800.555.048
Teknik: 1800.555.061

İtalya

Siparişler: 02.33430411
Faks: 02.33430426
Teknik: 800.787980

Japonya

Telefon: 03.5547.0811
Faks: 03.5547.0818
Teknik: 03.5547.0811

Kore (Güney)

Siparişler: 1544.7145
Faks: 1544.7146
Teknik: 1544.7145

Lüksemburg

Siparişler: 8002.2076
Faks: 8002.2073
Teknik: 8002.2067

Hollanda

Siparişler: 0800.0229592
Faks: 0800.0229593
Teknik: 0800.0229602

Norveç

Siparişler: 800.18859
Faks: 800.18817
Teknik: 800.18712

Singapur

Siparişler: 65.67775366
Faks: 65.67785177
Teknik: 65.67775366

İspanya

Siparişler: 91.630.7050
Faks: 91.630.5145
Teknik: 91.630.7050

İsveç

Siparişler: 020.790282
Faks: 020.790582
Teknik: 020.798328

İsviçre

Siparişler: 055.254.22.11
Faks: 055.254.22.13
Teknik: 055.254.22.12

İngiltere

Siparişler: 01293.422.911
Faks: 01293.422.922
Teknik: 01293.422.999

ABD

Siparişler: 800.426.8157
Faks: 800.718.2056
Teknik: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Пробірка для крові на ДНК

УК – Українська мова

I. Призначення

Пробірка РАХgene для крові на ДНК призначена для збирання, антикоагуляційної обробки, стабілізації, транспортування і зберігання проби цільної венозної крові, з якої надалі виготовляють препарати високоякісної ДНК для аналізів, що проводяться методами молекулярної діагностики з використанням ДНК.

Робочі характеристики цього обладнання для досліджень методами молекулярної діагностики у цілому не встановлювались. Користувачі повинні провести валідацію продукту для свого конкретного дослідження, яке проводиться методами молекулярної діагностики.

Особливості продукту

Пробірка РАХgene для крові на ДНК • 2,5 мл • 13 x 75 мм • добавка K_2EDTA
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 пробірок у коробці • 1000 пробірок у ящику

II. Резюме і пояснення

Пробірки РАХgene для крові на ДНК дають можливість забезпечити закриту вакуумну систему у процесі взяття цільної крові для виділення геномної ДНК. Кров згідно зі стандартним протоколом венепункції надходить у вакуумну пробірку, яка містить добавку K_2EDTA . Повне виділення ДНК проводиться ручними або автоматизованими способами, такими як утворення осаду висолуванням чи використання магнітних мікрокульок або кремнеземних мембран.

III. Застереження

Вміст цієї пробірки справляє подразливу дію на шкіру.

- У разі, якщо його вдихнули, виведіть потерпілого на свіже повітря.
- У разі контакту зі шкірою негайно промийте шкіру великою кількістю води з милом протягом щонайменше 15 хвилин.
- У разі потрапляння в очі негайно промийте великою кількістю води протягом щонайменше 15 хвилин.
- У разі прокоштування негайно дайте випити велику кількість води. Зверніться за медичною допомогою.


IV. Відбір проб і підготовка до аналізу

А. Аксесуари, необхідні для взяття крові (не включені до комплекту пробірки РАХgene для крові на ДНК)

1. Голка для взяття крові, наприклад Голка для взяття крові BD Vacutainer® Eclipse™ або Голка для взяття крові BD Vacutainer Eclipse Signal™. Дивіться «Інформацію для замовлення».
2. Щоб гарантувати належне функціонування, необхідно використовувати тримач голки BD Vacutainer. Дивіться «Інформацію для замовлення».
3. Етикетки для позитивної ідентифікації донора проби, якщо потрібно.
4. Спиртовий тампон для очищення місця взяття крові.
5. Суха стерильна марля.
6. Джгут
7. Контейнер для збирання використаних голок або комплектів «голка/тримач».

(продовження)

В. Процедура взяття проби



Загальні інструкції

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВЕНЕПУНКЦІЇ І ПРИ ПОВОДЖЕННІ З ПРОБІРКАМИ ДЛЯ ВЗЯТТЯ КРОВІ КОРИСТУЙТЕСЯ РУКАВИЧКАМИ, ЩОБ ЗВЕСТИ ДО МІНІМУМУ РИЗИК КОНТАКТУВАННЯ.

1. Помістіть голку в тримач. Переконайтеся, що голка міцно закріплена, щоб запобігти її вийманню під час застосування.
2. Помістіть пробірку в тримач. Примітка: Не протикайте затичку.
3. Оберіть місце для проведення венепункції.
4. Накладіть джгут. Підготуйте місце венепункції з використанням відповідного антисептика. **НЕ ПАЛЬПУЙТЕ ДІЛЯНКУ ВЕНЕПУНКЦІЇ ПІСЛЯ ЇЇ ПРОТИРАННЯ.**
5. Рука пацієнта має бути спрямована вниз.
6. Зніміть ковпачок голки. Виконайте венепункцію так, щоб під час її виконання РУКА БУЛА СПРЯМОВАНА ВНИЗ, А ЗАТИЧКА ПРОБІРКИ — ДОГОРИ.
7. При проколюванні затички утримуйте пробірки у тримачі у центральному положенні, щоб запобігти боковому проколу і, як наслідок, — передчасній втраті вакууму. Наштовхніть пробірку на голку, протикаючи діафрагму затички.
8. ЗНІМІТЬ ДЖГУТ, ЯК ТІЛЬКИ У ПРОБІРЦІ З'ЯВИТЬСЯ КРОВ. НЕ ДОЗВОЛЯЙТЕ ВМІСТУ ПРОБІРКИ КОНТАКТУВАТИ З ЗАТИЧКОЮ АБО КІНЦЕМ ГОЛКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ.

Примітка: Іноді кров може витікати з муфти голки. Дотримуйтесь універсальних запобіжних заходів, щоб звести до мінімуму ризик контактування. Якщо кров не надходить до пробірки, або якщо кров припинила надходити до того, як було отримано достатню для проби кількість, рекомендується виконати такі кроки для успішного завершення взяття проби:

- a. Проштовхуйте пробірку вперед, доки затичка пробірки не проколеться. За потреби утримуйте її на місці для забезпечення надходження необхідної кількості крові за допомогою вакууму.
6. Впевніться у правильності розташування голки у вені.
 9. Коли пробірка наповниться до вказаного на ній об'єму і кров припинить надходити, зніміть її з тримача.
 10. Переверніть пробірку 8 разів.
 11. Вийміть голку з вени, після чого притисніть місце проколу сухим стерильним тампоном до припинення кровотечі.
 12. Після згортання крові можна за бажанням накласти пов'язку.
 13. Після проведення венепункції на верхівці затички може міститися залишкова кров. При поводженні з пробірками дотримуйтесь відповідних заходів, щоб запобігти контакту з цією кров'ю.
 14. Утилізуйте голку і тримач у відповідності до правил та інструкцій, прийнятих у Вашому закладі.
 15. Видаліть наповнені пробірки РАХgene для крові на ДНК за умов кімнатної температури (18–25°C). Інформацію щодо стабільності ДНК у пробах крові за умов кімнатної температури, а також при 2–8°C, або –20°C, дивіться у розділі "Робочі характеристики".

Якщо пробірку бажано зберігати при температурі –70°C / –80°C, дивіться Процедуру заморожування і розморожування проб крові у Пробірках РАХgene для крові на ДНК.

(продовження)

Щоб запобігти можливому зворотному току крові, слід застосовувати такі методи:

- Руку донора спрямуйте донизу.
- Тримайте пробірку затичкою догори.
- Вивільніть джгут, щойно кров починає витікати у пробірку.
- Дбайте про те, щоб під час венепункції добавки у пробірці не торкалися пробки або кінця голки.

C. Процедура заморожування і розморожування проб крові, відібраних у пробірці PAXgene для крові на ДНК

- Поставте пробірку PAXgene для крові на ДНК вертикально у дротяний штатив. **Не заморожуйте пробірки вертикально у кюветі з пінополістиролу, оскільки це може спричинити розтріскування пробірок.**
- Пробірки PAXgene® для крові на ДНК можна зберігати при температурі -20°C і нижче. Якщо пробірки необхідно витримувати при температурі нижче за -20°C , заморозьте їх спочатку при -20°C протягом 24 годин, потім перемістите їх до морозильної камери з температурою -70°C або -80°C .
- Розморозуйте пробірки PAXgene® для крові на ДНК у дротяному штативі при температурі $18-25^{\circ}\text{C}$ протягом приблизно двох годин. **Не розморозуйте пробірки PAXgene для крові на ДНК при температурах вище 25°C .**
- Обережно переверніть 10 разів розморозені пробірки PAXgene для крові на ДНК.

Примітка: Заморожені пробірки PAXgene для крові на ДНК легко розбиваються від удару. Щоб зменшити ризик розбиття під час транспортування, з замороженими пробірками треба поводитися так само, як зі скляними пробірками. Користувачі повинні проводити валідацію свого власного протоколу заморожування та транспортування пробірок PAXgene для крові на ДНК.

D. Процедура підготовки проби до аналізу


Проби крові мають бути оброблені згідно з інструкцією, яка надається з набором для підготовки проб ДНК. Приклади можна знайти у розділі «Інформація для замовлення».

V. Робочі характеристики

Після того, як кров потрапляє у пробірку, ДНК залишається стабільною протягом 14 днів за температури $18-25^{\circ}\text{C}$ (Малюнок 1). Досліди стабільності ДНК показали, що кров можна зберігати у пробірці протягом 14 днів за температури $18-25^{\circ}\text{C}$, 28 днів за температури $2-8^{\circ}\text{C}$, 3 доби за температури 35°C , а також щонайменше 6 місяців за температури -20°C , з концентрацією ДНК на рівні $\geq 12,5$ нг/мкл та чистотою ДНК (A_{260}/A_{280}) на рівні 1,7–1,9.

Найновіші дані щодо стабільності заморожених проб можна знайти на сайті: www.PreAnalytiX.com.

Стабільність ДНК у пробах крові при температурі $18-25^{\circ}\text{C}$

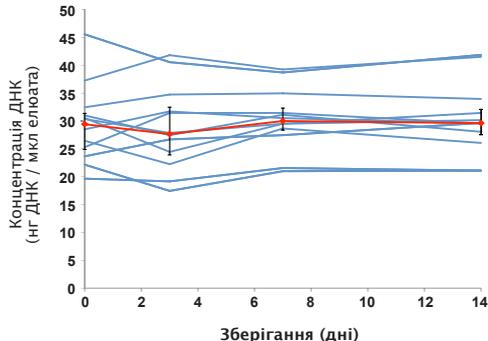

Малюнок 1

Кров, взяту від 12 дорослих донорів, які дали на це згоду, зберігали за умов $18-25^{\circ}\text{C}$ протягом вказаної кількості днів, після чого проводили повне очищення ДНК. Кров збирали у пробірки PAXgene для крові на ДНК, зберігали у цих самих пробірках, після чого проводили повне очищення ДНК з застосуванням набору QIAGEN® QIASymphony® DSP DNA Mini Kit за допомогою автоматизованого приладу QIAGEN QIASymphony.

(продовження)

VI. Обмеження

1. Кількість відібраної крові повинна бути 2,5 мл на пробірку PAXgene для крові на ДНК, але цей об'єм може змінюватися залежно від висоти над рівнем моря, температури навколишнього середовища, барометричного тиску, давності виготовлення пробірки, венозного тиску і техніки заповнення.

VII. Запобіжні заходи

1. Застосовуйте універсальні запобіжні заходи. Застосовуйте рукавички, спеціальний одяг, захист для очей, інше засоби особистого захисту і системи інженерного контролю для захисту від розбризкування крові, протікання крові та потенційного контакту з патогенами, що передаються з кров'ю.
2. Працюючи з біологічними пробами та гострими предметами, які входять до наборів для взяття крові, дотримуйтеся вимог внутрішніх положень і процедур вашого медичного закладу. Звертайтеся до лікаря у випадку будь-якого впливу біологічних проб (наприклад, через пошкодження проколом), оскільки вони можуть передати вірусний гепатит, ВІЛ (СНІД) або інші інфекційні хвороби.


Використовуйте вбудований захисний голки, якщо він входить до комплекту для взяття крові. Компанія PreAnalytiX не рекомендує знов надавати ковпачок на використану голку. Проте внутрішні положення і процедури вашої установи, можливо, відрізняються, тому потрібно завжди дотримуватися їх.

3. видаляйте всі пробірки для відбору крові в контейнери «Біологічна безпека», схвалені для утилізації таких матеріалів.
4. Не використовуйте повторно пробірки PAXgene для крові на ДНК.
5. Не використовуйте Пробірки PAXgene для крові на ДНК після дати закінчення терміну придатності, що надрукована на етикетці пробірки.
6. Надто висока швидкість центрифугування (понад 10 000 RCF) може спричинити поломку Пробірки PAXgene для крові на ДНК, контактування з кров'ю і нанесення шкоди здоров'ю.
7. Не переносьте пробу із шприца до пробірки.

VIII. Зберігання


1. Зберігайте невикористані пробірки PAXgene для крові на ДНК при температурі від 18°C до 25°C. Дозволяються обмежені в часі відхилення температури до 40°C. Не використовуйте пробірки, якщо термін їх придатності закінчився.

IX. Інструкції для зняття кришки BD Hemogard



1. Затисніть пробірку PAXgene для крові на ДНК однією рукою, помістивши великий палець під кришку BD Hemogard. (Щоб забезпечити додаткову стабільність, поставте руку на тверду поверхню). Іншою рукою відкручуйте кришку BD Hemogard, одночасно підштовхуючи її догори великим пальцем іншої руки, ПОКИ НЕ ВІДЧУЄТЕ, ЩО ЇЇ МОЖНА ЗНЯТИ БЕЗ ЗУСИЛЬ.
2. Перед тим як підняти кришку, приберіть великий палець. НЕ використовуйте великий палець для зіштовхування кришки з пробірки. Якщо пробірка містить кров, існує загроза контактування. Щоб запобігти пошкодженню під час зняття кришки, важливо прибрати від пробірки великий палець, яким кришку підштовхували догори, щойно ви відчуєте, що кришку BD Hemogard можна зняти без зусиль.
3. Зніміть кришку з пробірки. У тому малоймовірному випадку, коли пластикова муфта відокремлюється від гумової пробки, НЕ ЗБИРАЙТЕ КРИШКУ ЗНОВ. Обережно зніміть гумову затичку з пробірки.

X. Інструкції для повторного вставлення кришки BD Hemogard



1. Помістіть кришку на пробірку.
2. Прокручуйте і міцно притискайте донизу, поки затичка повністю не ввійде у пробірку. Повне повторне вставлення затички необхідно для того, щоб кришка надійно трималася на пробірці під час поводження з нею.

(продовження)

Технічна допомога

Якщо у вас є питання відносно пробірки PAXgene для крові на ДНК, зверніться до однієї зі служб технічного обслуговування компанії BD, перелік яких знаходиться у розділі, присвяченому технічному обслуговуванню.

Інформація для замовлення

Продукція PAXgene

Пробірка PAXgene для крові на ДНК / 761165

Вміст: 1000 пробірок для взяття крові.

Продукція BD*

Голка для взяття крові BD Vacutainer Eclipse / 368609 CE

Вміст: Голка 21G 1¼" дюйма, 0,8 мм x 32 мм, 48 у коробці, 480 у ящику

Голка для взяття крові BD Vacutainer Eclipse з приєднаним тримачем / 368650

Вміст: Голка 21G 1¼" дюймів, 0,8 мм x 32 мм, 100 одиниць у ящику

Голка для взяття крові BD Vacutainer Eclipse Signal / 368835, з сертифікатом CE.

Вміст: Голка 21G 1¼" дюйма, 0,8 мм x 32 мм, 50 у коробці, 400 у ящику

Одноразовий тримач BD Vacutainer / 364815

Вміст: Тримачі діаметром 13 мм і 16 мм лише у ящиках по 1000 одиниць у кожному ящику.

* Ці каталожні номери представляють типову продукцію, яка може бути використана з пробірною PAXgene для крові на ДНК.

Щоб замовити Аксесуари BD для взяття крові:

Зверніться на сайт: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

- Виберіть країну
- Прокрутіть донизу до Діагностичних систем BD – Преаналітичні системи
- Наберіть номер

Продукція QIAGEN*

Набір для ДНК QIAGEN QIASymphony DSP / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)

Вміст: Картридж для реагента, штатив для фермента, кришка, яку можна прокалювати, буфер АТЕ, багаторазовий набір для герметизації

Набір для ДНК QIAGEN QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit / 61104 (50)

Вміст: Центрифужні міні-колонки QIAamp, пробірки для проб, буфер AL, буфер ATL, буфер AW1, буфер AW2, буфер AE, протеаза QIAGEN, розчинник для протеази

Набір QIAGEN Gentra® Puregene® Blood Kit / 158422 (3 мл) / 158445 (30 мл) / 158467 (120 мл) / 158389 (1000 мл)

Вміст: Розчин для лізису еритроцитів, розчин для лізису клітин, розчин для осадження білків, розчин для гідратації ДНК, розчин РНКази

* Ці каталожні номери представляють типові набори для підготовки проб ДНК, які можуть бути використані з пробірною PAXgene для взяття крові на ДНК.

Щоб замовити набори QIAGEN для підготовки проб ДНК:

Зверніться на сайт: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

Пробірки PAXgene для крові на ДНК виробляються у Великій Британії компанією BD для PreAnalytiX GmbH. PAXgene and PreAnalytiX є торговельними марками PreAnalytiX GmbH; QIAGEN, QIASymphony, QIAamp, Gentra і Puregene є торговельними марками QIAGEN NV; Styrgofoam є торговельною маркою компанії The Dow Chemical Company; всі інші торговельні марки є власністю Veston, Dickinson and Company.

(продовження)

BD – Обслуговування клієнтів

Аргентина, Уругвай і Парагвай

Замовлення: 011.4551.7100

Адреса електронної пошти: crc_argentina@bd.com

Австралія

Замовлення: 1.800.656. 100

Факс: 1.800.656.110

Адреса електронної пошти: bd_anz@bd.com

Австрія

Замовлення: 43.1.7063660

Факс: 43.1.7063660-11

Бельгія

Замовлення: 32.53.720.556

Факс: 32.53.720.549

Бразилія

Замовлення: 0800.055.5654

Адреса електронної пошти:

consultoria_vacutainer@bd.com

Канада

Замовлення: 800.268.5430

Факс: 800.565.0897

Адреса електронної пошти: custsvccan@bd.com

Данія

Замовлення: 45.43.43.45.66

Факс: 45.43.96.56.76

Адреса електронної пошти: bdcs_dk@europe.bd.com

Східна Європа

Замовлення: 48.22.651.75.88

Факс: 48.22.651.75.89

Фінляндія

Замовлення: 358.9.88.70.780

Факс: 358.9.88.70.7816

Адреса електронної пошти:

bdorder_finland@europe.bd.com

Франція

Замовлення: 33.476.689496

Факс: 33.476.683693

Адреса електронної пошти:

BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

Німеччина

Замовлення: 49.6221305553

Факс: 49.6221305379

Італія

Замовлення: 39.02.48.240.500

Факс: 39.02.48.240.344

Технічні питання: 39.02.48.240.264

Адреса електронної пошти:

ordini_medicale@europe.bd.com

Близький та Середній Схід і Африка (EMA)

Замовлення: 971.4.3379525

Факс: 971.4.03379551

Адреса електронної пошти: EMA_PAS@bd.com

Нідерланди

Замовлення: 31.20.6545.716

Факс: 31.20.5829.421

Адреса електронної пошти:

vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

Нова Зеландія

Замовлення: 0800.572.468

Факс: 0800.572.469

Адреса електронної пошти:

bd_anz@bd.com

Норвегія:

Замовлення: 47.73.59.12.00

Факс: 47.73.59.12.01

Іспанія

Замовлення: 34.902.27.17.27

Факс: 34.91.848.81.04

Адреса електронної пошти:

servicio_de_clientes@bd.com

Швеція

Замовлення: 46.8.775.51.60

Факс 46: 8.775.51.95

Адреса електронної пошти:

bdorder_sweden@europe.bd.com

Швейцарія

Замовлення: 41.61.4852222

Замовлення: 41.61.4852200

Велика Британія

Замовлення: 44.1.865.781.666

Факс: 44.1.865.717.313

Адреса електронної пошти:

bduk_customerservice@europe.bd.com

США

Замовлення: 888.237.2762

Факс: 800.847.2220

Технічні питання: 800.631.0174

Адреса електронної пошти:

www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – Обслуговування клієнтів

Австралія

Замовлення: 03.9840.9800

Факс: 03.9840.9888

Технічні питання: 1.800.243.066

Австрія

Замовлення: 0800/28.10.10

Факс: 0800/28.10.19

Технічні питання: 0800/28.10.11

Бельгія

Замовлення: 0800.79612

Факс: 0800.79611

Технічні питання: 0800.79556

Канада

Замовлення: 800.572.9613

Факс: 800.713.5951

Технічні питання: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Китай

Замовлення: 0086.21.3865.3865

Факс: 0086.21.3865.3965

Технічні питання: 800.988.0325 / 800.988.0327

Данія

Замовлення: 80.885945

Факс: 80.885944

Технічні питання: 80.885942

Фінляндія

Замовлення: 0800.914416

Факс: 0800.914415

Технічні питання: 0800.914413

Франція

Замовлення: 01.60.920.926

Факс: 01.60.920.925

Технічні питання: 01.60.920.930

Пропозиції: 01.60.920.928

Німеччина

Замовлення: 02103.29.12000

Факс: 02103.29.22000

Технічні питання: 02103.29.12400

Гонконг

Замовлення: 800.933.965

Факс: 800.930.439

Технічні питання: 800.930.425

Ірландія

Замовлення: 1800.555.049

Факс: 1800.555.048

Технічні питання: 1800.555.061

Італія

Замовлення: 02.33430411

Факс: 02.33430426

Технічні питання: 800.787980

Японія

Телефон: 03.5547.0811

Факс: 03.5547.0818

Технічні питання: 03.5547.0811

Корея (Південна)

Замовлення: 1544.7145

Факс: 1544.7146

Технічні питання: 1544.7145

Люксембург

Замовлення: 8002.2076

Факс: 8002.2073

Технічні питання: 8002.2067

Нідерланди

Замовлення: 0800.0229592

Факс: 0800.0229593

Технічні питання: 0800.0229602

Норвегія

Замовлення: 800.18859

Факс: 800.18817

Технічні питання: 800.18712

Сінгапур

Замовлення: 65.67775366

Факс: 65.67785177

Технічні питання: 65.67775366

Іспанія

Замовлення: 91.630.7050

Факс: 91.630.5145

Технічні питання: 91.630.7050

Швеція

Замовлення: 020.790282

Факс: 020.790582

Технічні питання: 020.798328

Швейцарія

Замовлення: 055.254.22.11

Факс: 055.254.22.13

Технічні питання: 055.254.22.12

Велика Британія

Замовлення: 01293.422.911

Факс: 01293.422.922

Технічні питання: 01293.422.999

США

Замовлення: 800.426.8157

Факс: 800.718.2056

Технічні питання: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

血液DNA管

ZH - 中文

I. 用途

PAXgene 血液 DNA 管用于采集、抗凝、稳定、输送和存储一种制备高质量 DNA 的静脉全血样本，以便在需要 DNA 的分子诊断测试方法中使用。

一般来说，对于分子诊断试验，这些设备的性能特征尚不确定。因此使用者必须确认这些产品用于特定的分子诊断试验。

产品特点

PAXgene 血液 DNA 管 • 2.5 ml • 13 x 75 mm • K₂EDTA 附加剂
761165 • Plus • BD Hemogard™ • 100 管/货架箱 • 1,000 管/盒子

II. 小结与说明

PAXgene 血液 DNA 管为在封闭真空系统中采集全血以提取基因组 DNA 提供了一种方法。按照一个标准的放血协议，血液被采集到一个含有 K₂EDTA 附加剂的真空管中。通过使用手动或自动化方法，例如盐析沉淀物、磁珠或二氧化硅膜技术，可以完全提取出 DNA。

III. 警告

试管内容物对皮肤有刺激性。


- 吸入后，请将暴露于危害的人员转移到空气新鲜的地方。
- 皮肤接触过后，请立即用大量肥皂水冲洗皮肤至少 15 分钟。
- 眼睛接触过后，请立即用大量清水冲洗至少 15 分钟。
- 吞下后，请立即大量饮水。寻求医疗救助。

IV. 标本采集和分析的准备工作

所需采血附件（不包含在 PAXgene® 血液 DNA 管中）

1. 诸如 BD Vacutainer® Eclipse™ 采血针或 BD Vacutainer Eclipse Signal™ 采血针之类的采血针。参见“订购信息”。
2. 必须使用 BD Vacutainer 持针器，以确保功能正常。参见“订购信息”。
3. 阳性献血者样品识别标签，如要求
4. 用于清洁穿刺部位的酒精棉签
5. 干燥无菌的纱布
6. 压血带
7. 放置使用过的采血针或针/固定器的采血针处理容器

B. 标本采集程序



概括说明

为将危害降到最低，请在静脉穿刺期间以及在处理采血管时戴上手套。

1. 将采血针装入固定器中。确保采血针牢牢固定，以防其在使用期间脱线(untthread)。
2. 将试管插入固定器。注意：切勿刺穿塞子。
3. 选择静脉穿刺部位。
4. 应用压血带。用适当的抗菌剂准备好静脉穿刺部位。清洁之后，不要触诊静脉穿刺部位。
5. 将患者的手臂向下放置。
6. 取下针帽。进行静脉穿刺时，手臂向下，使管塞处于最高位置。
7. 当穿刺塞子时，为防止边侧刺入和造成真空的过早损失，请将试管置于固定器中央。将试管推到采血针上，穿刺塞子隔膜。
8. 一旦试管中出现血液，应立即取下压血带。在采血期间，切勿让试管的内容物接触到塞子或采血针的末端。

注意：血液可能偶尔会从针套中漏出来。实施全面防护措施以将危害降到最低。如果在采集足量的样本之前，没有血液流入到试管内或血液停止流入，则建议采用以下步骤来圆满完成采血工作：

- a. 将试管朝前推，直到试管塞被穿透。必要时，固定位置以确保完成真空抽取。
- b. 确认采血针在静脉中的准确位置。
9. 当支管被填充到指定量且血流停止时，将其从固定器上取下来。
10. 倒置 8 次。
11. 拔出刺入静脉的采血针，用干燥的消毒棉签压住穿刺部位，直到出血停止。
12. 一旦血液凝结，可在需要时使用绷带。
13. 静脉穿刺之后，塞子的顶部可能留有残余的血液。处理试管时，请采取恰当的保护措施，以免接触血液。
14. 根据您设施中的政策和指南来处理采血针和固定器。
15. 将充满PAXgene血液DNA管在室温（18-25° C）下存储。参见在室温（18-25° C）、2-8° C或-20° C下，在血样中的DNA的稳定性的性能特点。

若需要 70° C / -80° C 的存储温度，请参见“PAXgene 血液 DNA 管内标本的冷冻和解冻程序”以获取详细信息。

应使用以下技术以防止可能出现的血液回流：

- a. 将供样者的手臂向下放置。
- b. 使管塞位于最高位置。
- c. 一旦血液开始流入试管，应松开压血带。
- d. 确保试管的附加剂在静脉穿刺期间不会接触到塞子或采血针的末端。

C. PAXgene 血液 DNA 管内所收集标本的冷冻和解冻程序

1. 使 PAXgene 血液 DNA 管竖直放置于金属丝管架内。请勿冷冻直立放置在泡沫聚苯乙烯Styrofoam™ 托盘中的试管，因为这样可能会使试管破裂。
2. PAXgene 血液 DNA 管可存储于 -20° C 或更低的温度。若试管要存储于低于 -20° C 的温度，先在 -20° C 冷冻 24 小时，然后再将其转移到 -70° C 或 -80° C。
3. 让 PAXgene 血液 DNA 管在金属丝管架内于室温下（18-25° C）解冻两个小时左右。请勿在 25° C 以上的温度解冻 PAXgene 血液 DNA 管。
4. 小心倒置解冻后的 PAXgene 血液 DNA 管 10 次。

注意：一旦受到影响，冻结的 PAXgene 血液 DNA 管就容易破裂。为降低在运输期间破裂的风险，就请按照处理玻璃管的方式来处理冷冻的试管。使用者应验证其 PAXgene 血液 DNA 管的冷冻和运输协议。

D. 分析标本制备程序

血样必须根据与样品制备套件一起提供的说明进行处理。示例详见于“订购信息”。

V. 性能特点

在血液加注入试管后，在 18° C 到 25° C 情况下DNA保持稳定长达 14 天（图 1）。基于DNA稳定性研究，在DNA浓度12.5 ng/ul 及DNA纯度（A260/A280）1.7-1.9情况下，在 18° C至25° C时，血液可在试管中保存14天，在 2° C至8° C时可保存28天，35° C 时可保存3天，或在-20° C，时至少可保存6个月。

如需冷冻标本的稳定性的最新数据，请访问 www.PreAnalytiX.com。

18-25° C 时血样内 DNA 的稳定性

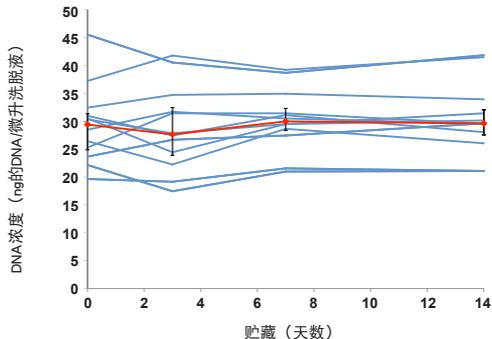


图 1

抽取 12 名已同意的成人献血者的血液，在 18 - 25° C 条件下存储上所指示的天数，之后进行总 DNA 纯化。用 PAXgene 血液 DNA 管来采集和存储血液，使用 QIAGEN QIAAsymphony 自动化仪器上的 QIAGEN® QIAAsymphony® DSP DNA Mini 套件来纯化总 DNA。

VI. 限制性

1. 每支 PAXgene 血液 DNA 管的抽血量应为 2.5 mL，但这一容积可能因海拔、室温、大气压、管龄、静脉压及加注技术而异。

VII. 防护措施

1. 实施全面防护措施。利用手套、防护服、护目用具、其他个人防护设备和工程控制来预防血液溅出、血液渗漏和接触血源性病原体。
2. 根据您设施中的政策和程序来处理所有生物样本和采血装置的尖利器具。万一接触生物样品（例如：穿刺受伤），就请寻求正确的医疗救助，因为生物样品可能会传播病毒性肝炎、艾滋病病毒（AIDS）或其他传染性疾病。


使用内置采血针保护器（如果采血设备带有）。PreAnalytiX 并不建议将用过的采血针重新装入针帽内。您设施中的政策和程序可能会不同，但都必须遵守。

3. 丢弃批准处理的生物危害容器中的所有用于采血的尖利器具。
4. 切勿重复使用 PAXgene 血液 DNA 管。
5. 切勿在试管标签上印有的过期日期之后使用 PAXgene 血液 DNA 管。
6. 过高的离心分离速度（超过 10,000 RCF）可能会造成 PAXgene 血液 DNA 管破裂、接触血液以及可能的伤害。
7. 切勿用注射器将样本输送到试管中。

VIII. 存储

1. 将未用过的 PAXgene 血液 DNA 管存储于 18° C 到 25° C 的条件下。允许温度最高偏移到 40° C。若试管过期，请勿使用。

IX. 取下 BD Hemogard™ 盖的说明。




1. 一只手握住 PAXgene 血液 DNA 管，将大拇指置于 BD Hemogard 盖之下。（欲增加稳定性，请将手臂放在固体表面上）。用另一只手拧紧 BD Hemogard 盖，同时拇指向上推，直到管塞松开。

（接上一页）

2. 向上拉起管盖之前，请将拇指移开。切勿用拇指将管盖推开。如果试管含有血液，就会存在接触风险。为防止在去盖期间受到伤害，一旦 BD Hemogard 盖松开，务必使向上推管盖的拇指不要接触管盖。
3. 向上拉开管盖。万一塑料管帽与橡胶塞子分开，请不要重新组装管盖。小心地取下试管的橡胶塞。

X. 取下 BD Hemogard™ 盖的说明



1. 更换管上方的管盖。
2. 用力拧紧并向下推，直到塞子被充分固定。在处理期间，为使管盖牢牢固定在试管上，需要完全插入塞子。

技术支持

如果您对 PAXgene 血液 DNA 管有任何疑问，请与 BD 列于 BD 一 客户服务部分的 BD 技术服务部门联系。
订购信息

PAXgene 产品

PAXgene 血液 DNA 管 / 761165
内容物: 1,000 支采血管。

BD 公司产品*

BD Vacutainer Eclipse 采血针 / 368609 CE
内容物: 21G 1/4" 英寸采血针, 0.8 mm x 32 mm, 48/盒, 480/箱

BD Vacutainer Eclipse 采血针, 带前附固定器 / 368650
内容物: 21G 1/4" 英寸采血针, 0.8 mm x 32 mm, 100/箱

BD Vacutainer Eclipse Signal 采血针 / 368835 CE
内容物: 21G 1/4" 英寸采血针, 0.8 mm x 32 mm, 50/盒, 400/箱

BD Vacutainer 一次性固定器 / 364815
内容物: 只适用于 13 mm 和 16 mm 直径 1000/箱

* 这些目录编号表示可以与 PAXgene 血液 DNA 管一起使用的代表性产品。

欲订购 BD 采血附件:

请访问: <http://www.bd.com/support/contact/international.asp>

- 选择国家 • 向下滚屏以查看 BD Diagnostics - Preanalytical Systems (BD 诊断 - 分析前处理系统) • 拨号

QIAGEN 产品*

QIAGEN QIASymphony DSP DNA 套件 / 937255 Midi (96) / 937236 Mini (192)
内容物: 试剂盒、酶支架、穿孔盖、buffer ATE、再用密封套装

QIAGEN QIAamp® DSP DNA 套件 / 61104 Mini Blood Kit (50)
内容物: QIAamp Mini 离心柱、采集管、buffer AL、buffer ATL、buffer AW1、buffer AW2、buffer AE、QIAGEN 蛋白酶

QIAGEN Genra® Puregene Blood Kit / 158422 (3 ml) / 158445 (30 ml) / 158467 (120 ml) / 158389 (1000 ml)
内容物: RBC 裂解溶液、细胞裂解溶液、蛋白沉淀液、DNA 水化溶液, RNase A 溶液

* 这些目录编号表示可以与 PAXgene 血液 DNA 管一起使用的代表性 DNA 制备套件。

欲订购 QIAGEN DNA 制备套件:

请访问: <http://www.qiagen.com/Products/Ordering-Information/>

PAXgene 血液 DNA 管由 BD 公司在英国为 PreAnalytiX GmbH 公司制造。PAXgene 和 PreAnalytiX 为 PreAnalytiX GmbH 公司的商标; QIAGEN、QIASymphony、QIAamp、Genra 和 Puregene 为 QIAGEN NV 公司的商标; Styrofoam 为陶氏化学公司的商标; 所有其他商标均归 Becton、Dickinson 和 Company 所有。

(接上一页)

BD - 客户服务

阿根廷、乌拉圭和巴拉圭

订购: 011.4551.7100
电子邮件: crc_argentina@bd.com

澳大利亚

订购: 1.800.656.100
传真: 1.800.656.110
电子邮件: bd_anz@bd.com

奥地利

订购: 43.1.7063660
传真: 43.1.7063660-11

比利时

订购: 32.53.720.556
传真: 32.53.720.549

巴西

订购: 0800.055.5654
电子邮件: consultoria_vacutainer@bd.com

加拿大

订购: 800.268.5430
传真: 800.565.0897
电子邮件: custsvccan@bd.com

丹麦

订购: 45.43.43.45.66
传真: 45.43.96.56.76
电子邮件: bdcs_dk@europe.bd.com

东欧

订购: 48.22.651.75.88
传真: 48.22.651.75.89

芬兰

订购: 358.9.88.70.780
传真: 358.9.88.70.7816
电子邮件: bdorder_finland@europe.bd.com

法国

订购: 33.476.689496
传真: 33.476.683693
电子邮件: BD_Vacutainer_France@europe.bd.com

德国

订购: 49.6221305553
传真: 49.6221305379

意大利

订购: 39.02.48.240.500
传真: 39.02.48.240.344
技术部: 39.02.48.240.264
电子邮件: ordini_medicale@europe.bd.com

中东和非洲(EMA)

订购: 971.4.3379525
传真: 971.4.03379551
电子邮件: EMA_PAS@bd.com

荷兰

订购: 31.20.6545.716
传真: 31.20.5829.421
电子邮件: vacutainer_systems_bnl@europe.bd.com

新西兰

订购: 0800.572.468
传真: 0800.572.469
电子邮件: bd_anz@bd.com

挪威:

订购: 47.73.59.12.00
传真: 47.73.59.12.01

西班牙

订购: 34.902.27.17.27
传真: 34.91.848.81.04
电子邮件: servicio_de_clientes@bd.com

瑞典

订购: 46.8.775.51.60
传真: 46.8.775.51.95
电子邮件: bdorder_sweden@europe.bd.com

瑞士

订购: 41.61.4852222
订购: 41.61.4852200

英国

订购: 44.1.865.781.666
传真: 44.1.865.717.313
电子邮件: bduk_customerservice@europe.bd.com

美国

订购: 888.237.2762
传真: 800.847.2220
技术部: 800.631.0174
电子邮件: www.bd.com/vacutainer/contact/

QIAGEN – 客户服务

澳大利亚

订购: 03.9840.9800
传真: 03.9840.9888
技术部: 1.800.243.066

奥地利

订购: 0800/28.10.10
传真: 0800/28.10.19
技术部: 0800/28.10.11

比利时

订购: 0800.79612
传真: 0800.79611
技术部: 0800.79556

加拿大

订购: 800.572.9613
传真: 800.713.5951
技术部: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

中国

订购: 0086.21.3865.3865
传真: 0086.21.3865.3965
技术部: 800.988.0325 / 800.988.0327

丹麦

订购: 80.885945
传真: 80.885944
技术部: 80.885942

芬兰

订购: 0800.914416
传真: 0800.914415
技术部: 0800.914413

法国

订购: 01.60.920.926
传真: 01.60.920.925
技术部: 01.60.920.930
报价: 01.60.920.928

德国

订购: 02103.29.12000
传真: 02103.29.22000
技术部: 02103.29.12400

香港

订购: 800.933.965
传真: 800.930.439
技术部: 800.930.425

爱尔兰

订购: 1800.555.049
传真: 1800.555.048
技术部: 1800.555.061

意大利

订购: 02.33430411
传真: 02.33430426
技术部: 800.787980

日本

订购电话: 03.5547.0811
传真: 03.5547.0818
技术部: 03.5547.0811

韩国

订购: 1544.7145
传真: 1544.7146
技术部: 1544.7145

卢森堡

订购: 8002.2076
传真: 8002.2073
技术部: 8002.2067

荷兰

订购: 0800.0229592
传真: 0800.0229593
技术部: 0800.0229602

挪威

订购: 800.18859
传真: 800.18817
技术部: 800.18712

新加坡

订购: 65.67775366
传真: 65.67785177
技术部: 65.67775366

西班牙

订购: 91.630.7050
传真: 91.630.5145
技术部: 91.630.7050

瑞典

订购: 020.790282
传真: 020.790582
技术部: 020.798328

瑞士

订购: 055.254.22.11
传真: 055.254.22.13
技术部: 055.254.22.12

英国

订购: 01293.422.911
传真: 01293.422.922
技术部: 01293.422.999

美国

订购: 800.426.8157
传真: 800.718.2056
技术部: 800.DNA.PREP
(800.362.7737)

Symbol and Mark Key

 Batch Code

 Catalogue Number

 Do Not Reuse

 In Vitro Diagnostic Medical Device

 Keep Away from Sunlight

 Manufacturer

 Method of Sterilization Using Irradiation

 Temperature Limitation

 Use By



EN Recyclable

BG Подлежи на рециклиране

CS Recyklovatelné

DA Til genbrug

DE Wiederverwertbar

EL Ανακυκλώσιμο

ES Reciclable

ET Taaskasutatav

FI Kierrätettävä

FR Recyclable

HR Može se reciklirati

HU Újrahasznosítható

IS Endurvinnanlegt

IT Riciclabile

JA リサイクル可能

KK Ҷайта өңдеуге болады

KO 재활용 가능

LT Galima perdirbti

LV Atkārtoti pārstrādājams

NL Recyclebaar

NO Resirkulerbar

PL Nadaję się do recyklingu

PT Reciclável

RO Reciclabil

RU Подлежит вторичной переработке

SK Recyklovateľná

SL Možnost recikliranja

SV Återvinningsbar

TR Geri Dönüşümlü

UK Придатне для вторинної переробки

ZH 可回收



EN This End Up

BG С този край нагоре

CS Tímto koncem nahoru

DA Denne side op

DE Diese Seite nach oben

EL Αυτή η πλευρά πάνω

ES Este extremo hacia arriba

ET See ots üleval

FI Tämä puoli ylöspäin

FR Haut

HR Ovaj kraj gore

HU Ezzel a végével felfelé

IS Þessi endi snúi upp

IT Questo lato in alto

JA 天地無用

KK Аяқталады

KO 이 곳을 위로

LT Šita puse aukštyti

LV Šo galu uz augšu

NL Deze zijde boven

NO Denne side opp

PL Tym końcem do góry

PT Este lado para cima

RO Cu partea aceeașă în sus

RU Этим концом вверх

SK Tento koniec nahor

SL Ta stran navzgor

SV Denna sida upp

TR Bu Uç Yukarı

UK Вверх

ZH 此端向上



EN Fragile, Handle With Care

BG Чупливо, работете внимателно

CS Křehké, manipulujte opatrně

DA Skrbelig, skal behandles forsigtigt

DE Zerbrechlich; vorsichtig handhaben

EL Εύθραυστο - Χειριστείτε το προσεκτικά

ES Frágil, manipular con precaución

ET Kergesti purunev, käsitsege ettevaatlikult

FI Särkyvä, käsittelyä varten

FR Fragile ; à manipuler avec précaution

HR Lomljivo, rukovati s oprezom

HU Törékeny, fokozott óvatossággal kezelje

IS Brothætt, meðhöndlið með gát

IT Fragile, maneggiare con cura

JA 割れ物注意

KK Сынғыш, абайлаңыз

KO 깨지기 쉬움, 취급 주의

LT Trapus, elgtis atsargiai

LV Trausls, apieties uzmanīgi

NL Breekbaar, voorzichtig hanteren

NO Skjørt, håndteres forsiktig

Kruche, postępować z ostrożnością

PT Frágil, manusear com cuidado

RO Fragil. A se manipula cu grijă

RU Хрупкое, обращаться с осторожностью

SK Krehké, manipulovať opatrne

SL Lomljivo, ravnanje previdno

SV Ömtålig, hanteras varsamt

TR Kırılgan, Dikkatli Tutun

UK Крихке, поводитись з обережністю

ZH 易碎品, 小心轻放